



Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
 Uniwersytecki Szpital Kliniczny
 im. Wojskowej Akademii Medycznej
 Uniwersytetu Medycznego w Łodzi
 Centralny Szpital Weteranów

Łódź, dnia 09.07.2024 r.

**Wszyscy uczestnicy postępowania,
 którzy pobrali SWZ**

Dotyczy: przetargu nieograniczonego 99/PN/ZP/D/2024 –dostawy sprzętu jednorazowego

W związku z nadesłanymi pytaniami do SP ZOZ Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego im. WAM Uniwersytetu Medycznego w Łodzi – Centralnego Szpitala Weteranów, dotyczącymi SIWZ, na podstawie art. 135 ust. 2 i ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2023 r., poz. 1605 – j.t. ze zm.) Zamawiający udziela następujących odpowiedzi:

Pytanie nr 1

Prosimy o potwierdzenie, że zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/745 z dnia 5 kwietnia 2017 r. w sprawie wyrobów medycznych (Medical Devices Regulation) MDR, art. 14, pkt 3 Zamawiający wymaga aby dostawy do jego jednostki były realizowane zgodnie z warunkami określonymi przez producenta?

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ

Pytanie nr 2

Prosimy o potwierdzenie, że zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 27 października 2022 r. w sprawie podstawowych warunków prowadzenia apteki, § 13.1 pkt. g, Zamawiający kontroluje warunki, w jakich odbywał się transport wyrobów medycznych, tj. sprawdza m.in. temperaturę przestrzeni ładunkowej pojazdu, którym wykonano dostawę? W przypadku negatywnej odpowiedzi prosimy o wyjaśnienie dlaczego Zamawiający nie stosuje się do obowiązujących przepisów prawa.

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ

Pytanie nr 3

Prosimy o wyjaśnienie, czy w świetle obowiązujących przepisów prawa, tj. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/745 z dnia 5 kwietnia 2017 r. w sprawie wyrobów medycznych (Medical Devices Regulation) MDR oraz Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 27 października 2022 r. w sprawie podstawowych warunków prowadzenia apteki, Zamawiający wymaga realizacji dostaw wyłącznie środkami transportu posiadającymi możliwość dokumentacji temperatury z przestrzeni ładunkowej?

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ

Pytanie nr 4

Czy zamawiający dopuści w pakiecie 4, pozycji 1 miskę o wymiarach 300x300x92mm (+/- 5 mm)?

Odpowiedź: Zamawiający dopuści.



Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Uniwersytecki Szpital Kliniczny
im. Wojskowej Akademii Medycznej
Uniwersytetu Medycznego w Łodzi
Centralny Szpital Weteranów

Pytanie nr 5

Czy zamawiający dopuści w pakiecie 4, pozycji 2 kaczkę j.u. o pojemności 900 ml?

Odpowiedź: Zamawiający dopuści

Pytanie nr 6

Czy zamawiający w pakiecie 6 pozycji 1 – 8 odstąpi od wymogi jednokrotnego zamknięcia?

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 7

Czy zamawiający w pakiecie 33, pozycji 1, dopuści czepek chirurgiczny wiązany na troki, przepuszczający powietrze, nieprzezroczysty, rozmiar uniwersalny, opakowanie handlowe a'100 szt?

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 8

Czy zamawiający dopuści w pakiecie 41, pozycji 1sterylną wodę do inhalacji o pojemności 350 ml, wolną od pirogenów, zapobiegająca namnażaniu bakterii, doskonale dopasowana do każdej sytuacji, w której istnieje zapotrzebowanie na nawilżanie gazów oddechowych, od doraźnej tlenoterapii przez maskę twarzową i kaniule nosowe poczynając, po zaintubowanych pacjentów wentylowanych mechanicznie. W komplecie adapter, wbudowany port do połączenia z drenem do tlenu nazwa producenta na etykiecie z wodą, 4 dodatkowe okrągłe porty na bokach butelki (po 2 porty na boku), nazwa producenta na etykiecie z wodą, system dyfuzorów na dnie butelki.

Pytanie nr 9

Czy zamawiający dopuści w pakiecie 41, pozycji 2 sterylną wodę ze sterylnym adapterem o pojemności 500 ml wolna od pirogenów, zapobiegająca namnażaniu bakterii, doskonale dopasowana do każdej sytuacji, w której istnieje zapotrzebowanie na nawilżanie gazów oddechowych, od doraźnej tlenoterapii przez maskę twarzową i kaniule nosowe poczynając, po zaintubowanych pacjentów wentylowanych mechanicznie. wbudowany port do połączenia z drenem do tlenu nazwa producenta na etykiecie z wodą a także wytłoczona na dnie butelki, dwustronna skala pomiarowa naniesiona na pojemnik co 50ml do 650ml? Pozostałe zgodnie z SWZ.

Odpowiedź do pytania 8 i 9

Zamawiający dopuści pod warunkiem:

- 1) Zachowania wymogu posiadania sterylnego adaptera;
- 2) Zachowania wymogu wydajności nawilżania min. 4,55 ml/h przy przepływie 5 L/min

Pytanie nr 10

DOT. PAKIETU 41: Czy Zamawiający wymaga aby w pojedynczym opakowaniu każdej wody znajdowała się instrukcja użytkowania?

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ

Pytanie nr 11

pakiet nr 6:

Z uwagi, że wszystkie dostępne na rynku pojemniki na odpady medyczne nie podlegają rejestracji jako wyrób medyczny na podstawie ustawy o wyrobach medycznych z dnia 07.04.2022 r. (Dz.U. 2022 poz. 974), prosimy Zamawiającego, o



Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Uniwersytecki Szpital Kliniczny
im. Wojskowej Akademii Medycznej
Uniwersytetu Medycznego w Łodzi
Centralny Szpital Weteranów

dopuszczenie dla pakietu nr 6 pojemników nie zarejestrowanych jako wyrób medyczny, nie posiadających znaku CE i deklaracji zgodności oraz o stawce VAT w wysokości 23%.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza

Pytanie nr 12

pakiet nr 6, pozycje 3-7:

Czy Zamawiający wymaga, w trosce o bezpieczeństwo personelu, aby pojemniki o pojemności 5L i 10L posiadały otwór wrzutowy o średnicy minimum 100 mm?

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ

Pytanie nr 13

pakiet 3 poz 1.

Ile warstw podkładu medycznego 50x50 zamawiający wymaga ?

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ Zamawiający nie określił ilości warstw podkładu 50x50.

Pytanie nr 14

Dotyczy pakietu nr 38

W związku z tym, że aplikatory do podawania Leku Lidocain Egis aer. nie są ani produktem leczniczym ani wyrobem medycznym, a środkiem zaopatrzenia technicznego służącym do podawania leku Lidocaina aer. zwracamy się z prośbą o zgodę aby w formularzu cenowym w polach: Numer deklaracji zgodności, klasa wyrobu medycznego oraz kod EAN wpisać „nie dotyczy”.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza

Pytanie nr 15

Dotyczy Pakietu nr 43.

Czy Zamawiający dopuści stetoskop, którego głowica jest wykonana ze stali nierdzewnej o średnicy 44 mm? Pozostałe parametry wg. opisu

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza

Pytanie nr 16

Pakiet nr. 3 poz.1

Czy Zamawiający dopuści zaproponowanie podkładu medycznego w rolce w rozmiarze 50 cm x 80 m

z przeliczeniem ilości rolek oraz z zaokrągleniem do pełnych rolek?

Tj. $2700 \cdot 50m = 135000 / 80m = 1687,5$ rolek ~ 1688 rolek.

*ilości min. Wykorzystanie 1688 rolek

*zamawiana ilość: 5625 rolek

*prawo opcji: 2250 rolek

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza

Pytanie nr 17

Pakiet 41 :

Czy Zamawiający w pozycji 1 dopuści zamknięty system do nawilżania o pojemności 350 ml napełniony sterylną wodą do terapii oddechowej i zawierający mikrodyfuzory . Produkt wolny od DEHP, PVC, lateksu, konserwantów i niepirogenny. W zestawie czysta głowica-adapter łącząca reduktor (przepływomierz) z pojemnikiem (pakowana osobno). Woda spełnia normę sterylności USP 71 . Wyjałowiony przy użyciu techniki obróbki aseptycznej .



Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Uniwersytecki Szpital Kliniczny
im. Wojskowej Akademii Medycznej
Uniwersytetu Medycznego w Łodzi
Centralny Szpital Weteranów

Czy Zamawiający w pozycji 2 dopuści zamknięty system do nawilżania o pojemności 550 ml napełniony sterylną wodą do terapii oddechowej i zawierający mikrodyfuzory . Produkt wolny od DEHP, PVC, lateksu, konserwantów i niepirogenny. W zestawie czysta głowica-adapter łącząca reduktor (przepływomierz) z pojemnikiem (pakowana osobno). Woda spełnia normę sterylności USP 71 . Wyjałowiony przy użyciu techniki obróbki aseptycznej .

Czy Zamawiający w pozycji 1 dopuści zamknięty system do nawilżania o pojemności 450 ml napełniony wodą do terapii inhalacyjnej umożliwiający prowadzenie terapii przez 35 dni (poświadczona zapisem na opakowaniu stabilność wody i oświadczenie Producenta) sterylizowany radiacyjnie. W zestawie głowica-adapter łącząca reduktor (przepływomierz) z pojemnikiem (pakowana osobno). Jakość wody spełniająca normę USP 43 . Pojemnik wyposażony w dyfuzory znajdujące się w podstawie pojemnika : Ilość otworów dyfuzora ≥ 14 , średnica otworu $\geq 0,2$ mm . Dyfuzory umożliwiają przepływ tlenu przez całą objętość wody .

Czy Zamawiający w pozycji 2 dopuści zamknięty system do nawilżania o pojemności 500 ml napełniony wodą do terapii inhalacyjnej umożliwiający prowadzenie terapii przez 35 dni (poświadczona zapisem na opakowaniu stabilność wody i oświadczenie Producenta) sterylizowany radiacyjnie. W zestawie głowica-adapter łącząca reduktor (przepływomierz) z pojemnikiem (pakowana osobno). Jakość wody spełniająca normę USP 43 . Pojemnik wyposażony w dyfuzory znajdujące się w podstawie pojemnika : Ilość otworów dyfuzora ≥ 14 , średnica otworu $\geq 0,2$ mm . Dyfuzory umożliwiają przepływ tlenu przez całą objętość wody .

Odpowiedź do pytania 17 do pozycji 1 i 2 pakietu 41

Zamawiający dopuści pod warunkiem:

- 1) Zachowania wymogu posiadania sterylnego adaptera;
- 2) Zachowania wymogu wydajności nawilżania min. 4,55 ml/h przy przepływie 5 L/min

Pytanie nr 18

Czy w celu miarkowania kar umownych Zamawiający dokona modyfikacji postanowień projektu przyszłej umowy w zakresie zapisów § 7:

1. Zamawiający może naliczyć Wykonawcy kary umowne w razie zwłoki w dostarczeniu lub wydaniu zamówionego towaru z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w wysokości 0,5% wartości netto niedostarczonego lub niewydanego towaru za każdy dzień zwłoki.
2. Zamawiający może naliczyć Wykonawcy kary umowne w razie zwłoki w dostarczeniu lub wydaniu reklamowanego towaru z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w wysokości 0,5% wartości netto niedostarczonego lub niewydanego towaru za każdy dzień zwłoki.
8. Zamawiający może naliczyć Wykonawcy kary umowne w przypadku niewykonania przeglądu technicznego przedmiotu użyczenia zgodnie z zaleceniami producenta przedmiotu użyczenia – 500 zł za każdy przypadek – o ile dotyczy.
9. Wykonawca jest zobowiązany do zapłaty na rzecz Zamawiającego kary umownej z tytułu niewykonania obowiązku określonego w § 9 ust 2, w wysokości 50,00 zł za każdy dzień zwłoki w odniesieniu do każdej deklaracji, Jednocześnie Zamawiający zastrzega, że w razie, gdyby kara umowna nie pokryła poniesionej przez Zamawiającego z w/w tytułu szkody (w szczególności nałożonych na Zamawiającego przez uprawnione organy lub podmioty kar), będzie on uprawniony do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych.
12. Wykonawca w przypadku braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego Podwykonawcy z tytułu zmiany wysokości wynagrodzenia Wykonawcy, o której mowa w § 11 ust. 3 pkt f umowy zobowiązany jest do zapłaty kary umownej w wysokości 250 zł za każdy stwierdzony przypadek. Wykonawca zobowiązany jest przedstawić Zamawiającemu wraz z fakturą VAT potwierdzenie dokonania płatności na rzecz Podwykonawcy z uwzględnieniem dokonanej zmiany wynagrodzenia Podwykonawcy, o ile dotyczy.

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ

Pytanie nr 19

dotyczy pakietu 39

1. Czy etykiety mogą zostać dostarczone na arkuszach? Będą wycinane laserem co bardzo ułatwia odklejanie od podłoża.
2. czy kolor np czarny oznacza, że etykieta ma być w jednolitym kolorze czarnym, bez dodatkowego nadruku? Jeżeli nie czy możemy otrzymać do wglądu przykładowy wzór?
3. czy etykiety na próbki mają być na papierze samoprzylepnym?



Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Uniwersytecki Szpital Kliniczny
im. Wojskowej Akademii Medycznej
Uniwersytetu Medycznego w Łodzi
Centralny Szpital Weteranów

4. etykieta termiczna biała (pkt 11), bez nadruku?

Odpowiedź:

Pak. 39, poz. 1-10 - Zamawiający wymaga etykiet papierowych (półpołysk, grubość min. 69µm) samoprzylepnych z unikatowym kodem kreskowym do badań laboratoryjnych. Rodzaj kodu kreskowego - Code 128c. Przykładowa konstrukcja kodu - AAAA BBBBB N, gdzie AAAA - seria zmienna o 1 co 100 000 numerów, BBBBB - numeracja w zakresie 00000-99999, N - zmienna 0-9 (np. Blok3 N=0,1,2). Kolor czarny - białe tło, czarny nadruk. Kolor żółty - żółte tło, czarny nadruk. Etykiety w formie arkuszy. Kompatybilne z systemem iCentrum firmy Marcel używanym przez Zamawiającego (wymagane oświadczenie Wykonawcy).

W załączeniu zmodyfikowany załącznik nr 2 do SWZ-formularz asortymentowo-cenowy

Pytanie nr 20

Dotyczy wzoru umowy § 7

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisu dotyczącego wysokości kar umownych na:

1. Zamawiający może naliczyć Wykonawcy kary umowne w razie zwłoki w dostarczeniu lub wydaniu zamówionego towaru z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w wysokości 0,5% wartości netto niedostarczonego lub niewydanego towaru za każdy dzień zwłoki.

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ

Pytanie nr 21

Czy Zamawiający w Pakiecie 21 poz. 8 dopuści możliwość zaofiarowania drutów Kirschnera o średnicy 1,0 mm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuści

Pytanie nr 22

Czy Zamawiający w Pakiecie 21 poz. 10 dopuści możliwość zaofiarowania drutów Kirschnera o średnicy 3,0 mm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuści

Pytanie nr 24

Dotyczy Pakiet 18:

Prosimy o doprecyzowanie jakie parametry ma uwzględniać test wykrywający narkotyki oraz leki.

Odpowiedź: Test wykrywający 12 substancji:

- OPI2000
- MDMA500
- MTD300
- BZO300
- AMP1000
- MET1000
- K250
- FYL20
- THC50
- BUP10
- MEP100
- CAT150

Pytanie nr 25

Dotyczy Pakiet 18:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaofiarowanie wyrobów medycznych które nie posiadają kodu EAN na opakowaniach gdyż nie ma takich wymogów prawnych.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę



Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Uniwersytecki Szpital Kliniczny
im. Wojskowej Akademii Medycznej
Uniwersytetu Medycznego w Łodzi
Centralny Szpital Weteranów

Pytanie nr 26

Pakiet 3, poz. 1

Czy zamawiający dopuści rolki 60 cm x 79,8 m, perforacja co 38 cm?

Czy zamawiający dopuści rolki 60 cm x 65,36 m, perforacja co 38 cm?

Czy zamawiający dopuści podkład o wymiarach 50 cm x 45,9 m, perforacja co 34 cm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuści

Czy jeżeli zamawiający dopuści inną długość, to czy z przeliczeniem za rolkę z zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań?

Odpowiedź: Tak, zamawiający dopuści z przeliczeniem

Pytanie nr 27

Pakiet 3, poz. 2

Czy zamawiający dopuści podkład o szer. 50 cm, perforacji co 50 cm, posiadający 40 mb długości?

Odpowiedź: Zamawiający dopuści

Czy jeżeli zamawiający dopuści inną długość, to czy z przeliczeniem za rolkę z zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań?

Odpowiedź: Tak, zamawiający dopuści z przeliczeniem

Pytanie nr 28

Pakiet 11

Czy zamawiający dopuszcza lusterko medyczne?

Odpowiedź: Zgodnie SWZ

Pytanie nr 29

Pakiet 33

Czy zamawiający dopuści czepek typu furażerka, z lamówką około 8 mm, przechodzącą z tyłu w troki, wiązany na troki, niesterylny, wykonany z włókniny polipropylenowej, o gramaturze 25 g/m², z warstwą pochłaniającą pot (50 g/m²) przedniej części o wymiarach 40 mm x 30 cm – z włókniny typu spunlance, troki o dł. ponad 20 cm każdy, głębokość czepka ok. 13 cm, denko o wymiarach ok. 20 cm x 12,5 cm, w kolorze niebieskim, rozmiar uniwersalny?

Odpowiedź: Zgodnie SWZ

Pytanie nr 30

Pakiet 33

Czy zamawiający dopuści wycenę za opakowanie 100 szt. z przeliczeniem ilości i zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań?

Odpowiedź: Zamawiający dopuści z przeliczeniem

Pytanie nr 30

dotyczy pakietu 18

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na składanie oferty na poszczególne pozycję lub zgodzi się wydzielić z pakietu 18 poz. 1 do osobnego pakietu? Pozostałe pozycje to testy immunochromatograficzne, które stanowią osobną grupę produktową. Asortyment z pozostałych pozycji znacząco ograniczy konkurencję. Wydzielenie pozycji lub wyrażenie zgodę na składanie ofert na poszczególne pozycje zwiększy konkurencyjność pakietów, a co za tym idzie pozwoli uzyskać niższą cenę?

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ



Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Uniwersytecki Szpital Kliniczny
im. Wojskowej Akademii Medycznej
Uniwersytetu Medycznego w Łodzi
Centralny Szpital Weteranów

Pytanie nr 31

Pakiet nr 13, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści równoważną rurkę intubacyjną kształtową ustno-nosową, zbrojoną, wykonaną z medycznego PCV, z mankietem niskociśnieniowym typu Murphy, rozmiary: 6; 6,5; 7; 7,5; 8?

Odpowiedź: Zamawiający dopuści

Pytanie nr 32

Pakiet nr 22, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie równoważną jednorazową szczoteczkę do zębów wykonaną z polipropylenu z możliwością odsysania. Z jednej strony pokryta miękkim włosiem, z drugiej gąbką. Łączna długość 18cm ($\pm 0,5$ cm), długość części czyszczącej 2,5cm ($\pm 0,2$ cm). Otwór odsysający zarówno od strony włosa jak i w przestrzeni pomiędzy gąbką i włosiem. Łącznik do kontrolowanego odsysania ścięty pod kątem 45° dla wygodnej manipulacji. Zarejestrowane jako wyrób medyczny klasy IIa. Pakowana pojedynczo w opakowania foliowe, opakowanie zbiorcze a'50szt.

+

Jednorazowy aplikator gąbkowy do nawilżania jamy ustnej. Długość całkowita 15,5cm ($\pm 0,5$ cm), długość części gąbkowej 2,5cm ($\pm 0,2$ cm). Uchwyt wykonany z poliestru, gąbka wykonana z polipropylenu. Zarejestrowane jako wyrób medyczny klasy I. Pakowany pojedynczo w opakowania foliowe, opakowanie zbiorcze a'50szt.?

Odpowiedź: Zamawiający dopuści powyższy opis jako równoważny

Pytanie nr 33

Pakiet nr 22, pozycja 2

Czy Zamawiający dopuści równoważną dwuwarstwową, jednorazową myjkę do mycia ciała w formie prostokątnej rękawicy nasączona obustronnie środkami myjącymi o PH 5,5 ($\pm 0,5$), wykonana w 100% z włókien poliestrowych. Obie warstwy myjki nie podfoliowane. Rozmiar 15cm x 22cm (± 2 cm), gramatura min. 60g/m². Produkowana zgodnie z wymaganiami ISO 9001:2015. Czystość mikrobiologiczna potwierdzona badaniami nie starszymi niż 2020 rok na brak zawartości Pseudomonas aeruginosa, Candida albicans oraz Escherichia coli. Opakowanie jednostkowe a'12 sztuk z graficzną instrukcją stosowania oraz składem. Produkt pozbawiony latexu. Opakowanie foliowe?

Odpowiedź: Zamawiający dopuści powyższy opis jako równoważny

Pytanie nr 34

Pakiet 4 Pozycja 2 Czy Zamawiający dopuści kaczki o pojemności 875ml?

Odpowiedź: Zamawiający dopuści

Pytanie nr 35

Pakiet 4 Pozycja 4 Czy Zamawiający dopuści nerki jednorazowe o pojemności 900ml?

Odpowiedź: Zamawiający dopuści

Pytanie nr 36

Pakiet 6 Pozycja 4 Czy Zamawiający dopuści pojemnik o pojemności 5l bez rączki?


Odpowiedź: Zamawiający dopuści

Pytanie nr 37

Pakiet 33 Pozycja 1 Czy Zamawiający dopuści czepek przedłużony stanowiący zabezpieczenie dla osób z długimi włosami. Część tylna wydłużona, wykończona gumką. Wykonany w całości z perforowanej włókniny wiskozowej o gramaturze 25g/m² zapewniającej doskonałą oddychalność i komfort noszenia?



Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Uniwersytecki Szpital Kliniczny
im. Wojskowej Akademii Medycznej
Uniwersytetu Medycznego w Łodzi
Centralny Szpital Weteranów

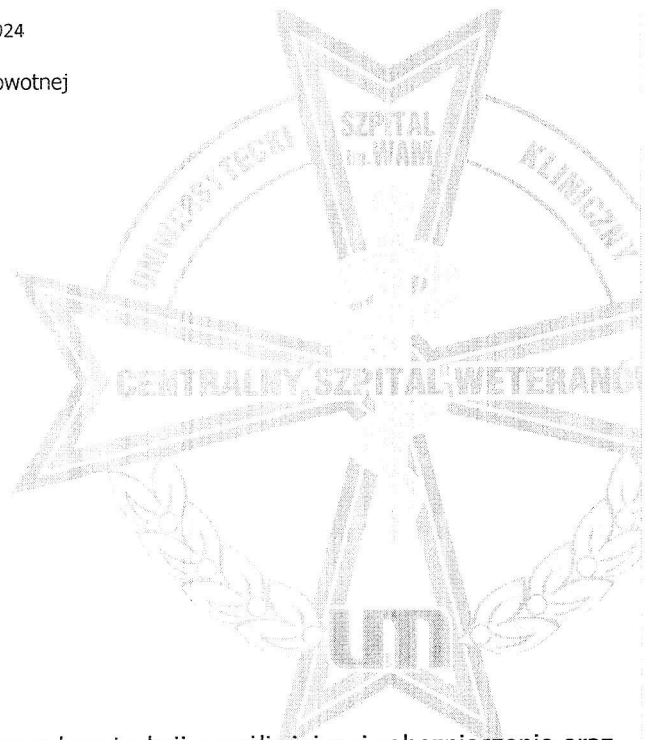

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ

Pytanie nr 38

Pakiet 33 Pozycja 1 Czy Zamawiający dopuści czepek medyczny o konstrukcji umożliwiającej zabezpieczenie oraz szyi, wykonany z włókniny polipropylenowej 25g/m², z możliwością zawiązania na końcu?



Odpowiedź: Zamawiający dopuści

Pytanie nr 39

Pakiet 33 Pozycja 1 Czy Zamawiający dopuści podanie ceny za opakowanie a'100 szt z przeliczeniem zamawianych ilości?

Odpowiedź: Zamawiający dopuści

Pytanie nr 40

Pak 16 poz. 2

Prosimy o dopuszczenie zamkniętego systemu do nieinwazyjnego pomiaru ciśnienia śródbrzusznego metodą manometryczną obejmujący: 20 ml dren manometryczny wyposażony w filtr biologiczny, umieszczony pomiędzy cewnikiem foley, a zestawem do godzinowej zbiórki moczu, zapewniający właściwe odpowietrzenie. Zastawka antyzwrotna wbudowana w łącznik do cewnika foley zapobiega cofaniu się moczu z zestawu do godzinowej zbiórki moczu do linii pomiarowej. Zintegrowany zacisk drenu pozwalający na wyrównanie ciśnień i precyzyjny odczyt wartości ciśnienia śródbrzusznego, bezigłowy port do pobierania próbek, linia pomiarowa wyskalowana w mm Hg, czas użycia do 7 dni.

Odpowiedź: Zamawiający dopuści powyższy opis jako równoważny

Na podstawie art. 137 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2023 r., poz. 1605, j.t. ze zm.) Zamawiający **zmienia treść Specyfikacji Warunków Zamówienia** w zakresie :

- modyfikacji Pakietu 39, pozycje 1-10 w Załączniku nr 2 do SWZ-Formularzu asortymentowo-cenowym

Na podstawie art. 137 ust. 2 PZP **zmodyfikowany załącznik nr 2 do SWZ udostępnia na stronie internetowej prowadzonego postępowania.**



Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Uniwersytecki Szpital Kliniczny
im. Wojskowej Akademii Medycznej
Uniwersytetu Medycznego w Łodzi
Centralny Szpital Weteranów

Na podstawie art. 137 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r., poz. 1710, j.t. ze zm.) Zamawiający przedłuża termin składania i otwarcia ofert:


- **Nowy termin składania ofert: 18.07.2024 r. godz. 08:30**
- **Nowy termin otwarcia ofert: 18.07.2024 r. godz. 09:00**
- **Nowy termin związania ofertą: 15.10.2024 r.**

Działając w oparciu o art. 137 ust. 4 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2023 r., poz. 1605, j.t. ze zm.) Zamawiający w dniu 08.07.2024 r. przekazał Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej sprostowanie, ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji.

Zamawiający zwraca się z prośbą, aby w przypadku dopuszczenia parametrów / zapisów innych niż opisane w SWZ zaznaczyć, iż parametr /zapisy zostały dopuszczone w drodze udzielonych wyjaśnień treści SWZ.

Z poważaniem

Kierownik Działu Zamówień Publicznych
Uniwersytecki Szpital Kliniczny
im. WAM - CSW


mgr Anna Pietrzyk

