



*Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Międzychodzie  
ul. Szpitalna 10, 64 - 400 Międzychód*

NIP: 595-13-40-382      REGON: 000310249      KRS: 0000005301  
Sekretariat: tel./fax 95 748 27 11      Centrala: tel. 95 748 20 11  
e-mail: spzozmiedzychod@spzoz-miedzychod.com.pl      e-mail: 3000310@zoz.org.pl  
[www.spzoz-miedzychod.com.pl](http://www.spzoz-miedzychod.com.pl)

AG/ZP-13/2024

Międzychód 20.05.2024r.

## **WYJAŚNIENIA TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA**

dotyczy postępowania na:  
dostawę odczynników oraz akcesoriów, wraz z dzierżawą analizatora

SPZOZ Międzychód informuje, iż w związku z otrzymanymi zapytaniem do przedmiotowego postępowania przetargowego - działając na podstawie art. 284 i art. 286 ustawy z dnia 11 września 2019r. - Prawo Zamówień Publicznych wyjaśnia co następuje:

### **Pytania do załącznika nr 4**

#### **Pytanie nr 1**

Pkt 4 - Czy Zamawiający dopuści odczynnik o metodyce równoważnej do metody BRAHMS, wykazujący b. wysoką korelację wyników z metodą referencyjną? Jednocześnie informujemy, że Wykonawca posiada dokumenty potwierdzające wcześniejsze stwierdzenie.

**Odpowiedź: Tak.**

#### **Pytanie nr 2**

Pkt 6 – Czy Zamawiający dopuści rozwiązanie, w którym krzywa kalibracyjna zapisana jest metodą RFID, również automatycznie zaczytywaną przez analizator?

**Odpowiedź: Tak.**

#### **Pytanie nr 3**

Pkt 7 – Czy Zamawiający dopuści analizator wyposażony w sondy do pipetowania odczynnika i próbek wykonane z tytanu i powlekane teflonem z wykorzystaniem mycia wewnętrznego i zewnętrznego, co minimalizuje ryzyko kontaminacji, jak również znacząco wpływa na zmniejszenie kosztów elementów zużywalnych, takich jak jednorazowe końcówki oraz jednocześnie ogranicza produkcję plastikowych odpadów?

**Odpowiedź: Tak.**

#### **Pytanie nr 4**

Pkt 16 – Czy Zamawiający dopuści analizator z szybkością oznaczania Troponiny do 22 min?

**Odpowiedź: Nie.**

#### **Pytanie nr 5**

Pkt 17 – Czy Zamawiający podając objętość 50uL do wykonania oznaczenia ma na myśli objętość martwą plus 50uL? Jeżeli nie, to czy Zamawiający dopuści analizator o objętości martwej równej 100uL?

**Odpowiedź: Tak, ma na myśli objętość martwą plus 50uL.**

#### **Pytanie nr 6**

Pkt 18 – Czy Zamawiający dopuści analizator, gdzie najdłużej trwające oznaczenie HBSag wynosi 54 min 54s?

**Odpowiedź: Tak.**

#### **Pytanie nr 7**

Pkt 19 – Czy Zamawiający dopuści odczynniki TSH, FT3, FT4 posiadające określone przez producenta specyficzne wartości jedynie dla populacji osób dorosłych?

**Odpowiedź: Nie.**

#### **Pytanie nr 8**

Pkt 20 – Czy Zamawiający dopuści odczynnik do oznaczeń  $\beta$ HCG posiadający oficjalne wskazania producenta do monitorowania ciąży?

**Odpowiedź: Tak.**


### Pytanie nr 9

Pkt 21 – Czy Zamawiający dopuści test Troponiny wysokoczułej bez 1-godzinego algorytmu diagnostyki zawału serca?

**Odpowiedź: Nie.**

### Pytanie nr 10

Oferowane analizatory oraz systemy wymagają do pracy stałego połączenia z internetem. Jest to związane z aktualizacją licencji oprogramowania, pobieraniem danych o odczytnikach, kontrolach, kalibratorach, serwisem zdalnym oraz połączeniem z LIS. Czy zamawiający udostępni w swoich zasobach dostęp do sieci lokalnej w celu zapewnienia integracji z LIS oraz dostępu do internetu? Wymagane jest połączenie z poniższymi serwerami na spacyfikowanych portach. Poniżej schemat połączeń rozwiązań diagnostycznych (analizatorów).

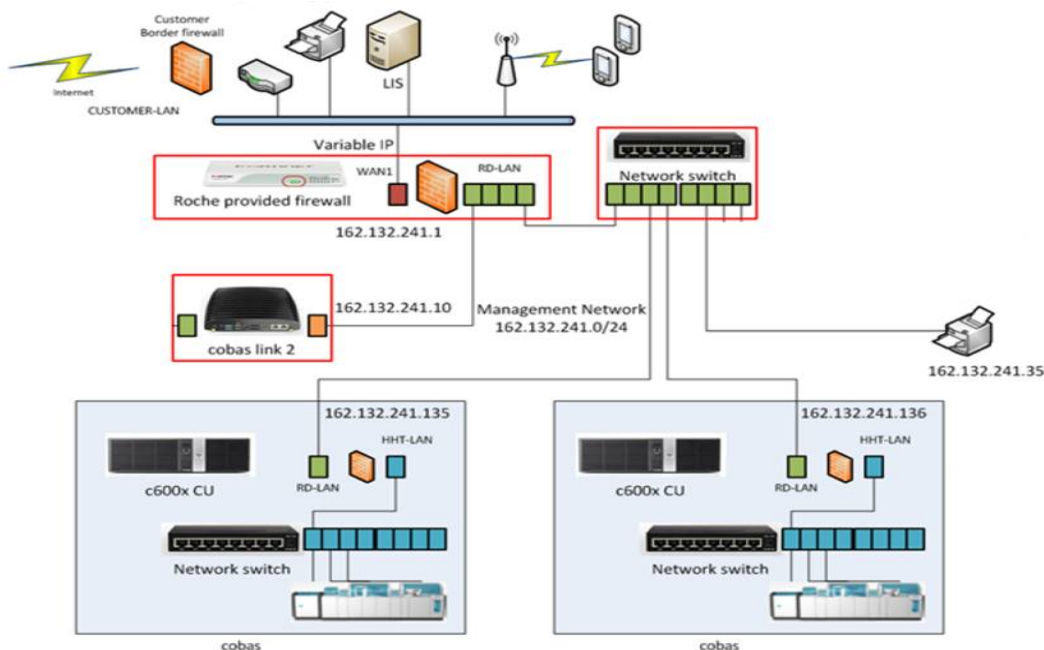

URL	IP	Port	Typ	Description
*.navify.com	193.58.155.0/24	443	CloudFlare	Main connections enabling Remote Service
*.navify.com	193.228.103.0/24	433 (514/541)	CloudFlare	Current/future setup using Cloudflare
remoteservice.roche.com	62.209.44.11	443	Direct	Dedicated connections enabling Remote Support
remoteservice-gas1.roche.com	62.209.44.21	443	Direct	Dedicated connections enabling Remote Support
remoteservice-gas2.roche.com	62.209.44.22	443	Direct	Dedicated connections enabling Remote Support
remoteservice-gas3.roche.com	209.202.167.19	443	Direct	Dedicated connections enabling Remote Support
remoteservice-gas4.roche.com	209.202.167.20	443	Direct	Dedicated connections enabling Remote Support
remoteservice-gas5.roche.com	120.136.45.231	443	Direct	Dedicated connections enabling Remote Support
remoteservice-gas6.roche.com	120.136.45.230	443	Direct	Dedicated connections enabling Remote Support
remoteservice-gas15.roche.com	35.76.193.4	443	Direct	Dedicated connections enabling Remote Support
remoteservice-gas16.roche.com	52.193.219.53	443	Direct	Dedicated connections enabling Remote Support
rln-cm-*.dia.roche.com	52.178.37.238	514 / 541	Direct	Dedicated connections enabling FortiGate management
teleservice.roche.com	196.3.50.39	443 / 80	HTTP	Dedicated connection to TSN
remoteservice-dr.roche.com	209.202.167.21	443	Direct	Axeda Disaster Recovery

**Odpowiedź: Tak, Zamawiający udostępni.**

**Pytanie nr 11**

Załącznik nr 4 do SWZ, pkt 7: Czy Zamawiający dopuści analizator, gdzie dozowanie materiału badanego dokonywane jest za pomocą jednorazowych końcówek, a dozowanie odczynników za pomocą igły odczynnikowej, zefektywnym systemem płukania zabezpieczającym przed błędem przeniesienia?

**Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuści.**

**Pytanie nr 12**

Załącznik nr 4 do SWZ, pkt 12: Prosimy o uściślenie i wyjaśnienie czy Zamawiający wymaga, aby podana wydajność była zachowana dla wszystkich oferowanych w postępowaniu parametrów, niezależnie od typu reakcji jedno- lub dwustopniowej?

**Odpowiedź: Nie dla wszystkich.**

**Pytanie nr 13**

Załącznik nr 4 do SWZ, pkt 25: Czy zamawiający dopuści dla części parametrów konfekcjonowanie opakowań handlowych po 200 i/lub 300 ozn.? Jednocześnie prosimy o potwierdzenie, iż Wykonawca wypełniając formularz asotymentowo-cenowy może usunąć wartości podane przez Zamawiającego w kolumnie J i podać oferowaną przez Wykonawcę ilość opakowań, adekwatną do podanej ilości badań uwzględniając konfekcjonowanie opakowań handlowych

**Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuści dla części parametrów konfekcjonowanie opakowań handlowych po 200 i/lub 300 oznaczeń. Jednocześnie Wykonawca wypełniając formularz asotymentowo-cenowy może usunąć wartości podane przez Zamawiającego w kolumnie J i podać oferowaną przez Wykonawcę ilość opakowań, adekwatną do podanej ilości badań uwzględniając konfekcjonowanie opakowań handlowych.**

**Pytanie nr 14**

Załącznik nr 4 do SWZ, pkt 29: Czy Zamawiający wyrazi zgodę aby dostęp do ulotek metodycznych odczynników w jęz. polskim realizowany był poprzez stronę internetową <https://navifyportal.pl/moduly/elabdoc?> Pozwoli to Zamawiającemu na otrzymanie najbardziej aktualnych wersji dokumentów. Ze względów ekologicznych wersje papierowe nie są już dołączane do opakowań odczynnikowych.

**Odpowiedź: Tak, Zamawiający wyraża zgodę.**

**Pytanie nr 15**

Załącznik nr 4 do SWZ, pkt 38: Czy Zamawiający wyrazi zgodę aby jeden z oferowanych odczynników posiadał gwarantowaną trwałość po otwarciu 31 dni?

**Odpowiedź: Tak, Zamawiający wyraża zgodę.**

**Pytanie nr 16**

Załącznik nr 4 do SWZ, pkt 31: Czy Zamawiający zgodzi się zmienić zapis o czasie przyjazdu serwisu "do 12 godzin od momentu kontaktu z serwisem (pn - pt-)" na: "do 24 godzin od momentu kontaktu z serwisem (pn - pt)"

**Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.**

**Pytanie nr 17**

Załącznik nr 4 do SWZ, pkt 32: "W przypadku niemożności naprawy analizatora Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć na własny koszt nowy analizator o cechach nie gorszych od oferowanego w postępowaniu przetargowym."

**Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.**

**Pytanie nr 18**

Czy Zamawiający zgodzi się usunąć zapis, a w przypadku przedłużającej się awarii wyrazi zgodę na wykonanie badań w innym laboratorium na koszt Wykonawcy?

**Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.**

## **zał. nr 5 projektowane postanowienie umowy dostawy**

### **Pytanie nr 19**

par. 3 ust. 1-2 , par. 5 ust. 2 i 4 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na składanie zamówień oraz na zgłaszanie reklamacji odczynników przez aplikację Wykonawcy (strona internetowa)?

Uzasadnienie: Składanie zamówień, zgłaszanie reklamacji odczynników przez aplikację Wykonawcy umożliwi Zamawiającemu przeglądanie historii wpisów, śledzenie statusu zgłoszeń i wysyłki zamówień.

**Odpowiedź: Składanie zamówień przez Zamawiającego odbywać się będzie e-mail lub fax, natomiast zgłaszanie reklamacji odczynników poprzez aplikację Wykonawcy**

### **Pytanie nr 20**

par. 3 ust.3 Czy Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację tego postanowienia poprzez dodanie w jego treści, że Zamawiający może skorzystać z prawa do zakupu interwencyjnego „po bezskutecznym upływie przynajmniej 5- dniowego dodatkowego terminu wyznaczonego Wykonawcy do realizacji zobowiązania”?

**Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.**

### **Pytanie nr 21**

par. 3 ust. 5 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę niniejszego postanowienia tak, aby skorzystanie z zakupu interwencyjnego / wykonania zastępczego wykluczało zastosowanie kar umownych?

**Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.**

### **Pytanie nr 22**

par. 3 ust. 6 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę słowa „bezpłatny” na „w ramach wynagrodzenia”?

**Odpowiedź: Tak, Zamawiający wyrazi zgodę.**

### **Pytanie nr 23**

par. 3 ust. 11 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na poinformowanie o niezgodności Przedmiotu zamówienia z dokumentem dostawy, dostawach mających widoczne oznaki uszkodzenia lub przypadku stwierdzenia, że transport odbywał się w niewłaściwej temperaturze niż to zakładają wymagania wyłącznie drogą elektroniczną (email/strona internetowa)?

**Odpowiedź: Tak, Zamawiający wyrazi zgodę.**

### **Pytanie nr 24**

par. 3 ust. 12 Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby termin ważności przedmiotu umowy wynosił minimum 6 miesięcy od dnia dostawy?

Uzasadnienie:

Proponowany termin ważności wydaje się być wymaganiem zbyt wygórowanym.

**Odpowiedź: Tak, Zamawiający wyraża zgodę.**

### **Pytanie nr 25**

par. 3 ust. 15 Zwracamy się z prośbą o usunięcie niniejszego postanowienia umowy. W przypadku braku zgody zwracamy się o modyfikację poprzez wskazanie ""Wykonawca ponosi odpowiedzialność za jakość dostarczonego Przedmiotu Zamówienia. W przypadku stwierdzenia jego wady przed lub w trakcie użytkowania Przedmiotu Zamówienia, Wykonawca zobowiązany jest do naprawy Przedmiotu Zamówienia lub dostarczenia Przedmiotu Zamówienia wolnego od wad."

**Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.**

### **Pytanie nr 26**

par. 3 ust. 16 i par 6 ust. 1 lit c Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie na końcu postanowienia fragmentu „po uprzednim wezwaniu dodatkowym i wyznaczeniu Wykonawcy dodatkowego terminu co najmniej 5 dni roboczych.”? Odstąpienie, nawet częściowe, może skutkować po stronie Zamawiającego potrzebą zmiany wykonawcy. Jednocześnie procedura naprawcza może skutecznie zapobiegać tego rodzaju przypadkom, umożliwiając dokończenie współpracy stron.

**Odpowiedź: Tak, Zamawiający wyrazi zgodę.**

### **Pytanie nr 27**

par. 4 ust. 8 Czy Zamawiający wyraża zgodę na przesyłanie faktur drogą elektroniczną i mógłby podać adres mailowy, na który można fakturę w tej formie wysłać?

**Odpowiedź: Tak, Zamawiający wyrazi zgodę. Adres e-mail będzie wpisany w umowę.**

**Pytanie nr 28**

par. 6 ust. 1 lit B Czy Zamawiający wyraża zgodę na dodanie "do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody"?  
Ewentualnie dodanie: „wyłączona jest odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu utraconych korzyści”?

**Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.**

**Pytanie nr 29**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zamianę słowa "dni" na "dni robocze"?

**Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.**

**Pytanie nr 30**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na modyfikację - zmianę słowa „opóźnienia” na „zwłoki”?

Uzasadnienie: Zgodnie z art. 433 pkt 1 PZP postanowienia umowy nie mogą przewidywać odpowiedzialności wykonawcy za opóźnienie, chyba że jest to uzasadnione okolicznościami lub zakresem zamówienia.

**Odpowiedź: Tak, Zamawiający wyrazi zgodę.**

**Pytanie nr 31**

par. 6 ust. 1 lit. C-D Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę przesłanki naliczenia kary umownej za odstąpienie „z przyczyn zawinionych przez Wykonawcę”?

Uzasadnienie:

Zgodnie z art. 471 k.c. dłużnik odpowiada za nienależyte wykonanie umowy jeżeli wynika ono z przyczyn za które ponosi odpowiedzialność. Przyczyny niezależne od Zamawiającego obejmują także okoliczności za które dłużnik nie odpowiada.

**Odpowiedź: Jest to w zapisie umowy – z winy Wykonawcy.**

**Pytanie nr 32**

par. 6 ust. 3 Czy Zamawiający wyraża zgodę na dodanie "do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody"?  
Ewentualnie dodanie: „wyłączona jest odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu utraconych korzyści”?

**Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.**

**Pytanie nr 33**

par. 9 ust. 6 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę niniejszego postanowienia na "Wynagrodzenie, o którym mowa w par. 2 ust. 1, może się zmienić w wyniku zastosowania wszystkich Waloryzacji o maksymalnie 50% pierwotnej wartości Umowy."

Uzasadnienie: W przypadku umowy, która może być zawarta w wyniku tego postępowania przetargowego, waloryzacja wynagrodzenia będzie w praktyce niemożliwa z uwagi na to, że jej warunki wstępne nie mogą zaistnieć lub będzie miała pomijalną wartość. Takie sformułowanie postanowień powoduje, że mają one pozorny charakter, a zatem ich umieszczenie stanowi obejście normy wynikającej z art. 439 Prawa zamówień publicznych, która wymaga zamieszczenia skutecznych postanowień waloryzacyjnych.

**Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.**

**Pytanie nr 34**

par.11 ust. 5 Czy Zamawiający wyraża zgodę na zawarcie umowy w formie elektronicznej przy wykorzystaniu kwalifikowanego podpisu elektronicznego przez Wykonawcę?

**Odpowiedź: Tak, Zamawiający wyraża zgodę.**

**zał. nr 6 projektowane postanowienie umowy najmu****Pytanie nr 35**

par. 2 ust. 2 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zamianę słowa "dni" na "dni robocze"?

**Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.**

**Pytanie nr 36**

par. 2 ust. 5 Zwracamy się z prośbą o usunięcie niniejszego postanowienia umowy. W przypadku braku zgody zwracamy się o modyfikację i zmianę na " W przypadku stwierdzenia wad podczas odbioru jak i po uruchomieniu Przedmiotu najmu Wynajmujący zobowiązany jest do pokrycia wszelkich roszczeń Najemcy do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody"? Ponadto czy Zamawiający wyrazi zgodę na to, by obowiązek wymiany dotyczył wyłącznie wadliwego elementu, a nie całego aparatu? Naprawy aparatury w ciągłym użytkowaniu są normalnym zjawiskiem, a w związku z tym, w pierwszej kolejności Wykonawca powinien mieć zapewnioną możliwość przywrócenia sprawności sprzętu. Pozostawienie tak restrykcyjnych, niestandardowych zapisów, jak proponowane obecnie przez Zamawiającego będzie wiązało się z ponoszeniem przez Wykonawcę

nieproporcjonalnie dużego ryzyka finansowego, które będzie musiało zostać uwzględnione w cenie oferty, co wpłynie na koszt zamówienia.

**Odpowiedź: Zamawiający zmienia zapis na: „włącznie z ewentualną wymianą urządzenia na nowy”.**

**Pytanie nr 37**

par. 2 ust. 6 i 8 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę słowa „bezpłatny” na „w ramach czynszu dzierżawnego”?

**Odpowiedź: Tak, Zamawiający wyrazi zgodę.**

**Pytanie nr 38**

par. 2 ust. 7 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zgłaszanie awarii aparatu przez aplikację Wykonawcy (strona internetowa)? Uzasadnienie: zgłaszanie awarii aparatu przez aplikację Wykonawca umożliwi Zamawiającemu przeglądanie historii wpisów, śledzenie statusu zgłoszeń i wysyłki zamówień.

**Odpowiedź: Tak, Zamawiający wyrazi zgodę na zgłaszanie awarii aparatu przez aplikację Wykonawcy.**

**Pytanie nr 39**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zamianę słowa "godzin" na "godzin w dni robocze"?

**Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.**

**Pytanie nr 40**

par.2 ust. 10 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na to, by obowiązek wymiany dotyczył wyłącznie wadliwego elementu, a nie całego aparatu? Naprawy aparatury w ciągłym użytkowaniu są normalnym zjawiskiem, a w związku z tym, w pierwszej kolejności Wykonawca powinien mieć zapewnioną możliwość przywrócenia sprawności sprzętu. Pozostawienie tak restrykcyjnych, niestandardowych zapisów, jak proponowane obecnie przez Zamawiającego będzie wiązało się z ponoszeniem przez Wykonawcę nieproporcjonalnie dużego ryzyka finansowego, które będzie musiało zostać uwzględnione w cenie oferty, co wpłynie na koszt zamówienia.

**Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.**

**Pytanie nr 41**

par. 7 Czy Zamawiający jako administrator danych osobowych, które mogą znajdować się na aparatach będących przedmiotem zamówienia i do których w związku z prawidłową realizacją obowiązków wynikających z umowy o udzielenie zamówienia publicznego, tj. przyłączenie do sieci, dokonywanie przeglądów, świadczenie usług serwisowych może mieć dostęp Wykonawca, wyrazi zgodę na zawarcie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych? Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych zawarta została by z Wykonawcą jako procesorem wg załączonego wzoru

**Odpowiedź: Tak, Zamawiający wyrazi zgodę.**

*Dokument został podpisany przez Dyrektora SPZOZ Międzychód – Bartosza Grobelnego*

Dyrektor SPZOZ Międzychód

/-/ Bartosz Grobelny