

## FORMULARZ OFERTOWY Nr 79/D/PRZ22

Dane dotyczące Wykonawcy

Nazwa: Dutchmed PL Sp. z o.o.

Siedziba: ul. Szajnochy 14, 85-738 Bydgoszcz

Województwo: Kujawsko – Pomorskie

Nr telefonu/faks: 52 345 31 15, 605567239

nr NIP: 554-023-08-29 nr REGON: 00693775900000

Osoba do kontaktu z Zamawiającym / stanowisko: Magdalena Guzik, koordynator sprzedaży.

numer telefonu: 605 567 239 adres e-mail: [magda@dutchmed.pl](mailto:magda@dutchmed.pl)

Zobowiązania wykonawcy

Nawiązując do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym na dostawę drobnego sprzętu medycznego w tym głównie sprzętu medycznego jednorazowego użytku, (Znak sprawy Te 2300-11/2022), oferujemy wykonanie zamówienia za następującą cenę:

Zadanie nr 54

Cena brutto 52 370,28 zł

Działając w imieniu Wykonawcy oświadczam, że:

1. Zapoznaliśmy się ze specyfikacją warunków zamówienia i nie wnosimy do niej zastrzeżeń oraz, że zdobyliśmy konieczne informacje do przygotowania oferty.
2. Oferowane ceny zawierają wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia i Zamawiający nie poniesie żadnych dodatkowych kosztów związaną z realizacją zamówienia.
3. Oferowane przez nas wyroby spełniają wymogi określone w specyfikacji warunków zamówienia oraz posiadają atesty, zezwolenia, świadectwa rejestracji, certyfikaty wymagane przez polskie prawo, na podstawie, których mogą być wprowadzone do obrotu i stosowania w placówkach ochrony zdrowia w RP.
4. Wszystkie oferowane wyroby medyczne posiadają – odpowiednio do ich klasy – aktualne certyfikaty jednostki notyfikowanej i/lub deklaracje zgodności i wpisy do rejestru wyrobów medycznych.
5. Zobowiązujemy się dostarczyć Zamawiającemu dokumenty, o których mowa w pkt. 3 i 4 na jego wezwanie.
6. Pozostajemy związani niniejszą ofertą przez okres wskazany w specyfikacji warunków zamówienia.
7. W przypadku wybrania naszej oferty zobowiązujemy się do zawrzeć z Zamawiającym umowę na warunkach określonych w specyfikacji warunków zamówienia, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.
8. Oświadczam, że zamierzam powierzyć następującym podwykonawcy/om wykonanie następujących części zamówienia:  
**nie dotyczy**

(należy wskazać części zamówienia, których wykonanie Wykonawca zamierza powierzyć oraz nazwy firm podwykonawców - o ile są znane).

9. Wybór niniejszej oferty ~~będzie~~ /nie będzie (niewłaściwie skreślić) prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami ustawy o podatku od towarów i usług. Wskazujemy nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do powstania powyższego obowiązku podatkowego ..... oraz wartość tego towaru lub usługi bez kwoty podatku wynoszącą .....
- (brak wskazania rozumiany będzie przez Zamawiającego jako informacja o tym, że wybór oferty nie będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego powyższego obowiązku podatkowego).

10. Oświadczam że należymy do grupy ~~mikro / małych / średnich przedsiębiorstw / dużych przedsiębiorstw~~ (niepotrzebne skreślić)  
(zaznaczyć właściwe)
11. Pod groźbą odpowiedzialności karnej oświadczam, że załączone do oferty dokumenty opisują stan prawny i faktyczny, aktualny na dzień otwarcia ofert.
12. Wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.

Pełnomocnik w przypadku składania oferty wspólnej – **nie dotyczy**

Nazwisko, imię .....

Stanowisko .....

Telefon.....Fax.....

Na potwierdzenie spełnienia wymagań do oferty załączam:

1. Oświadczenie dotyczące przesłanek wykluczenia.
2. Opis przedmiotu zamówienia.
3. Formularz cenowy.
4. JEDZ.
5. Pełnomocnictwo.

Zastrzeżenie wykonawcy

Niżej wymienione dokumenty składające się na ofertę nie mogą być ogólnie udostępnione: **nie dotyczy**.

Inne informacje wykonawcy: **nie dotyczy**.

Bydgoszcz, dnia 24.06.2022 r.

## OŚWIADCZENIE WYKONAWCY

o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz.U. poz. 835) oraz art. 5k rozporządzenia Rady (UE) 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r. dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz. Urz. UE nr L 229 z 31.7.2014)

.....  
(pełna nazwa i adres Wykonawcy)

Oświadczam, że Wykonawca w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego przez Pleszewskie Centrum Medyczne w Pleszewie Sp. z o.o. pn. „Dostawa drobnego sprzętu medycznego w tym głównie sprzętu medycznego jednorazowego użytku” (Nr postępowania: Te2300-11/2022

1. **podlega / nie podlega**\* wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego;
2. **podlega / nie podlega**\* wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 5k rozporządzenia Rady (UE) 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r. dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie.

\* niepotrzebne skreślić

**Oświadczenie dotyczące podwykonawcy, na którego przypada ponad 10% wartości zamówienia: nie dotyczy**  
UWAGA: wypełnić tylko w przypadku podwykonawcy (niebędącego podmiotem udostępniającym zasoby), na którego przypada ponad 10% wartości zamówienia. W przypadku więcej niż jednego podwykonawcy, na którego zdolnościach lub sytuacji wykonawca nie polega, a na którego przypada ponad 10% wartości zamówienia, należy zastosować tyle razy, ile jest to konieczne.

Oświadczam, że w stosunku do następującego podmiotu, będącego podwykonawcą, na którego przypada ponad 10% wartości zamówienia:

.....  
(podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)

**zachodzą / nie zachodzą**\* podstawy wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia przewidziane w art. 5k rozporządzenia Rady (UE) 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r. dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie.

**Oświadczenie dotyczące dostawcy, na którego przypada ponad 10% wartości zamówienia: nie dotyczy**  
UWAGA: wypełnić tylko w przypadku dostawcy, na którego przypada ponad 10% wartości zamówienia. W przypadku więcej niż jednego dostawcy, na którego przypada ponad 10% wartości zamówienia, należy zastosować tyle razy, ile jest to konieczne.

Oświadczam, że w stosunku do następującego podmiotu, będącego dostawcą, na którego przypada ponad 10% wartości zamówienia:

.....  
(podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)

**zachodzą / nie zachodzą\*** podstawy wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia przewidziane w art. 5k rozporządzenia Rady (UE) 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r. dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie.

*\* niepotrzebne skreślić*

**Oświadczenie dotyczące podanych informacji:**

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia Zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

*Uwaga:*

*W przypadku złożenia oferty przez podmioty występujące wspólnie, wymagane oświadczenie winno być złożone przez każdy podmiot.*


Bydgoszcz, dnia 24.06.2022 r.

### Opis przedmiotu zamówienia

#### Zadanie 54

Poz. 1 Układ oddechowy przeznaczony do aparatu do nieinwazyjnego wspomaganie oddychania metodą wysokich przepływów Precision Flow z wbudowanym systemem nawilżania gazów oddechowych zabezpieczający przed transportem bakterii i grzybów, zawiera:

- kasetę nawilżającą z automatycznym pobieraniem wody,
- membranowy parownik medyczny z włóknami o średnicy 0,005 mikrona,
- przewód doprowadzający gazy oddechowe do pacjenta o długości 210 cm, wyposażony w płaszcz wodny (rura w rurze) zapewniający eliminację skraplania się pary wodnej w układzie pacjenta.



Trójkanałowa konstrukcja przewodu pacjenta doprowadzającego gazy oddechowe obejmuje:

- wewnętrzny kanał (przez który przepływa ogrzany i nawilżony gaz oddechowy),
- dwa zewnętrzne kanały (przez które przepływa w układzie zamkniętym ogrzana woda

utrzymująca temperaturę gazów oddechowych i minimalizująca kondensację pary wodnej).

Układ dedykowany jest dla przepływów w zakresie 1-8 L/min., współpracuje z aparatem wyposażonym w systemem automatycznego ograniczenia zakresu przepływów, uniemożliwiający nastawę powyżej opisanego progu przepływu. Czas użycia oferowanego układu wynosi min. 30 dni u jednego pacjenta.

**Producent: Vapotherm Inc., nr kat. PF-DPC-LOW**

### Poz. 2, 3, 4 Kaniula nosowa




- umożliwia znaczny przeciek przy nozdrzu, co zwiększa strumień dwutlenku węgla z jamy nosowo-gardłowej; ułatwia działanie w systemie otwartym,
- generuje niewielkie poziomy PEP,
- dostępne rozmiary:
  - poz. 2 - dla wcześniaków, śr. 1,5 mm, przepływ max. 8 L/min., niebieska, nr kat. MN1100A
  - poz. 3 - dla noworodków, śr. 1,5 mm, przepływ max. 8 L/min., granatowa, nr kat. MN1100B
  - poz. 4 niemowlęca do pojedynczego nozdrza, śr. 1,5 mm, przepływ max. 8 L/min., zielona, nr kat. SOLO1300



**Producent: Vapotherm Inc.**

### Poz. 5, 6 Kaniula nosowa ProSoft



- umożliwia znaczny przeciek przy nozdrzu, co zwiększa strumień dwutlenku węgla z jamy nosowo-gardłowej; ułatwia działanie w systemie otwartym,
- generuje niewielkie poziomy PEP,
- posiada miękkie końcówki donosowe oraz suwak do regulacji obwodu,
- przeznaczona do stosowania w okresie 30 dni,
- dostępne rozmiary:
  - dla wcześniaków, przepływ max. 8 L/min., niebieska, nr kat. ProSoft-PRE
  - dla noworodków, przepływ max. 8 L/min., granatowa, nr kat. ProSoft-NEO


**Producent: Vapotherm Inc.**

### **Poz. 7 Układ oddechowy do aparatu do resuscytacji noworodka Neopuff**

Układ oddechowy do resuscytacji noworodka kompatybilny z aparatem Neopuff, rury z zabezpieczeniem przeciwdrobnoustrojowym opartym na działaniu jonów srebra, przepływ w zakresie 0,5 – 15 L/min. Zestaw mikrobiologicznie czysty, zapakowany w opakowanie foliowe, z widoczną i czytelną datą ważności, j. uż.

#### **W skład zestawu wchodzi:**

- ramię wdechowe niepodgrzewane, przekrój 10 mm, min. dł. 1,2 m, Ø wew. 10 mm
- zastawka PEEP z łącznikiem 22M/15F z zabezpieczeniem przed przypadkowym odkręceniem pokrętła regulatora ciśnienia końcowo-wydechowego oraz z podwójnie obrotową regulacją położenia przy zastawce, z systemem „klik” przeciwdziałającym przypadkowej zmianie ustawień,
- produkt wykonany jest z PCV, nie zawiera lateksu,
- zatyczka uszczelniająca,
- łączniki umożliwiające dopasowanie do aparatu Resuscitare, Panda, Giraffe Star




**Producent: Armstrong Medical Ltd., nr kat. AMVC1871/165**

**Poz. 8** Układ oddechowy do resuscytacji noworodka kompatybilny z aparatem Neopuff, rury z zabezpieczeniem przeciwdrobnoustrojowym opartym na działaniu jonów srebra, przepływ w zakresie 0,5 – 15 L/min. Zestaw mikrobiologicznie czysty, zapakowany w opakowanie foliowe, z widoczną i czytelną datą ważności, j. uż.

#### **W skład zestawu wchodzi:**

- ramię wdechowe niepodgrzewane, przekrój 10 mm, min. dł. 1,2 m, Ø wew. 10 mm
- zastawka PEEP z łącznikiem 22M/15F z zabezpieczeniem przed przypadkowym odkręceniem pokrętła regulatora ciśnienia końcowo-wydechowego oraz z podwójnie obrotową regulacją położenia przy zastawce, z systemem „klik” przeciwdziałającym przypadkowej zmianie ustawień,
- produkt wykonany jest z PCV, nie zawiera lateksu,
- zatyczka uszczelniająca,
- maska twarzowa,

- łączniki umożliwiające dopasowanie do aparatu Resuscitare, Panda, Giraffe Star



**Producent: Armstrong Medical Ltd.,**

**Poz. 8 nr kat. AMVC1871/165, AMFM4105 – maska rozm. 0**

**Poz. 9 nr kat. AMVC1871/165, AMFM4115 – maska rozm. 1**

**Poz. 10 Mankiety NIBP dla noworodków:**

- z właściwymi konektorami do połączeń z większością systemów monitorujących
- nadruki w poszczególnych kolorach identyfikują rozmiar pacjenta
- jednorazowego użytku
- pozbawione lateksu
- z 20 cm drenem



**Producent: Unimed, 1781S, 1782S, 1783S**

**Poz. 11 Maska nosowa łącząca generator z noworodkiem**

Maska jest miękka i bardzo delikatna dla skóry noworodka, wykonana z silikonu. Jej kształt umożliwia właściwe dopasowanie do anatomii twarzy. Dostępne są cztery rozmiary oznaczone kolorami.

Do ustalenia prawidłowego rozmiaru maski służy miarka.

Zalety stosowania maski nosowej:

- wywiera niewielki ucisk na skórę,
- ma małą przestrzeń martwą,
- zapewnia skuteczną eliminację CO<sub>2</sub>, a więc także wentylację,
- umożliwia karmienie dziecka bez przerywania wentylacji,
- pozwala kontrolować stan i drożność nosa.





Maski nosowe	
p. 11. 1.1 AMNM1000S	Maska nosowa mała S, czerwona
p. 11. 1.2 AMNM1000M	Maska nosowa średnia M, niebieska
p. 11. 1.3 AMNM1000L	Maska nosowa duża L, fioletowa
p. 11. 1.4 AMNM1000XL	Maska nosowa b. duża XL, żółta

**Producent: Armstrong Medical Ltd.**

**Poz. 11. 2 Mocowanie/Czapeczka do zamocowania generatora**

Czapeczka wykonana jest z bawełny, posiada trzy zapięcia na rzepy do mocowania węży, można rozwiązać bez zdejmowania uzyskując dostęp do ciemiączka, z miarką.

Wielkość oznaczona kolorem w sposób trwały.



Czapeczka		Kolor	Długość cm	Szerokość cm	Obwód głowy
IHBW000/10	Rozmiar 000	Biały	16	8,5	16-18 cm
IHBGY00/10	Rozmiar 00	Szary	16	9,5	18-20 cm
IHBPK0/10	Rozmiar 0	Różowy	16	10,5	20-22 cm
IHBBR1/10	Rozmiar 1	Brązowy	17	11,5	22-24 cm
IHBYE2/10	Rozmiar 2	Żółty	18	12,5	24-26 cm
IHBBL3/10	Rozmiar 3	Niebieski	19	13,5	26-28 cm
IHBGO4/10	Rozmiar 4	Złoty	20	14,5	28-30 cm
IHBGR5/10	Rozmiar 5	Zielony	21	15,5	30-32 cm
IHBBU6/10	Rozmiar 6	Burgund	22	16,5	32-34 cm
IHBOR7/10	Rozmiar 7	Pomarańczowy	23	17,5	34-36 cm
IHBDG8/10	Rozmiar 8	Ciemny zielony	24	18,5	36-38 cm
IHBNA9/10	Rozmiar 9	Granatowy	25	19,5	38-40 cm

**Producent: Inspiration Healthcare Ltd.**

**Czapeczkę można stosować zamiennie z mocowaniem paskowym w postaci czepca do terapii wymiennych**

**Czepiec do terapii wymiennych do zamocowania generatora/kaniuli nosowej**

Czepiec jest przeznaczony do stosowania w nieinwazyjnym wspomaganie oddechu (NIV) i umożliwia zamocowanie generatora w mocowaniu kołyskowym za pomocą dwóch krótkich dwustronnych rzepów oraz w terapii tlenowej wysokimi przepływami (HFOT) i umożliwia zamocowanie kaniuli nosowej za pomocą dwóch długich rzepów (posiadających dodatkowo warstwę klejącą).


**Podstawowe zalety czepca do terapii wymiennych to:**

- ✓ wykonany z miękkiego materiału kompozytowego Fabrifoam® (chroniony patentem) o właściwościach odpornych na rozciąganie i deformację, zapewniającego przepuszczalność powietrza, ograniczającego przesuwanie główki pacjenta dzięki wewnętrznej porowatej warstwie, a także o właściwościach wyciszających hałas pochodzący z otoczenia oraz zabezpieczających przed utratą ciepła i utrzymujących komfort termiczny, posiadający pętelki do zamocowania rzepów na części zewnętrznej,

- ✓ daje możliwość uzyskania bezpośredniego dostępu do ciemniaczka i naczyń pacjenta bez wpływu na stabilność i funkcje utrzymujące, konstrukcja w postaci opaski owijanej wokół główki,
- ✓ posiada perforację w części płatu potylicznego,
- ✓ dzięki konstrukcji w postaci opaski można regulować czepec do aktualnego obwodu głowy małego pacjenta w zależności od potrzeb – w przypadku obrzęku lub ustąpienia obrzęku bądź u pacjenta długo wentylowanego w miarę wzrostu dziecka bez konieczności zmiany rozmiaru, zabezpieczając tym samym przed deformacją główki,
- ✓ posiada rzepy do mocowania (po dwa osobne dla NIV i HFOT), które umożliwiają umiejscowienie interfejsu NIV lub HFOT w różnych pozycjach, co stanowi zabezpieczenie przed jednostajnym uciskiem i umożliwia dostosowanie do kształtu głowy,
- ✓ część pokrywająca małżowiny uszne daje możliwość łatwej inspekcji stanu skóry i/lub higienizacji części zausznej, bez konieczności zdejmowania czepeca,
- ✓ wielkość oznaczona kolorem w sposób trwały,
- ✓ wyposażony w miarkę do ustalenia właściwego rozmiaru czepeca.

Dostępne rozmiary:

- obwód głowy do 24 cm, rozm. XXS, nr kat. AMBT100/XXS
- obwód głowy 24-28 cm, rozm. XS, nr kat. AMBT100/XS
- obwód głowy 28-31 cm, rozm. S, nr kat. AMBT100/S
- obwód głowy 31-34cm, rozm. M, nr kat. AMBT100/M
- obwód głowy 34-38 cm, rozm. L, nr kat. AMBT100/L
- obwód głowy 38-42 cm, rozm. XL, nr kat. AMBT100/XL




**Producent: Armstrong Medical Ltd.**

**Poz. 12 Układ oddechowy noworodkowy z generatorem IF, jednorazowego użytku (mikrobiologicznie czysty), z zabezpieczeniem przeciwdrobnoustrojowym opartym na działaniu jonów srebra przystosowany do czepca do terapii wymiennych oraz czapeczki**

W skład zestawu wchodzi:

- odcinek wdechowy: podgrzewany dł. 1,2 m, niepodgrzewany dł. 0,3m, Ø wew. 10 mm,
- odcinek łączący nawilżacz z respiratorem dł. 0,6 m,
- odcinek do pomiaru ciśnienia dł. 2,1 m,
- klipsy (4 szt.)
- zestaw generatora, w komplecie znajdują się:
  - generator IF z elastycznymi i miękkimi paskami mocującymi z pętelkami do zaczepienia rzepów z jednej strony, zakończone zwężanymi, usztywnianymi i karbowanymi końcówkami, które ułatwiają montaż generatora do czapeczki,
  - kołyska wykonana z elastycznego tworzywa w kształcie litery T, umożliwia stabilne umiejscowienie generatora na czepcu za pomocą rzepu oraz zmianę kąta nachylenia generatora i utworzenie tzw. garbu lub niecki w celu uzyskania szczelności systemu,
  - końcówka donosowa o zróżnicowanej grubości ramion donosowych w rozm. S, M, L (3 szt.),
  - odcinek wydechowy niepodgrzewany z perforacją w postaci regularnych otworów zabezpieczających przed okluzją, umiejscowionych na wierzchołkach karbowan, na całej długości odcinka,
  - linia wdechowa i pomiaru ciśnienia ze złączką dwudrożną,
  - miarka.



**Producent: Armstrong Medical Ltd., nr kat. AMCP1409/049**

**Poz. 13 Filtr bakteryjno-wirusowy**

Filtr eliminuje dźwięki emitowane w trakcie terapii.

Zakładany na rurę wydechową odchodzącą od generatora.


Ma właściwości bakteriobójcze, wirusobójcze i wyciszające.



**Producent: Pharma Systems AB, AMBF7050**

### **Poz. 14 Czujnik brzuszny oddechów**

Brzuszny czujnik oddechów, do użytku z przetwornikiem, umożliwia monitorowanie bezdechu i wspomaganie wyzwalania w trybie BiPhasic. Pracuje na zasadzie kapsuły Gresby. Wyposażony jest w membranę do prowadzenia pomiarów oddechów pacjenta i przyklepic ułatwiający zamocowanie czujnika na stałe. Zakończony z jednej strony łącznikiem do interfejsu brzuszego czujnika oddechów. Długość drenu 1 m.




**Producent: Viomedex Ltd., nr kat. VX010**

### **Poz. 15 Komora nawilżacza o konstrukcji zapobiegającej nadmiernemu zbieraniu się kondensatu w obwodzie oddechowym**

#### Cechy charakterystyczne:

- automatyczna regulacja poziomu wody,
- pływak konwekcyjny,
- dren do wody dł. 1,2 m,
- zacisk na drenie do wody,
- uniwersalna,
- czas napełniania < 60 sek.,
- mikrobiologicznie czysta,
- jednorazowego użytku.

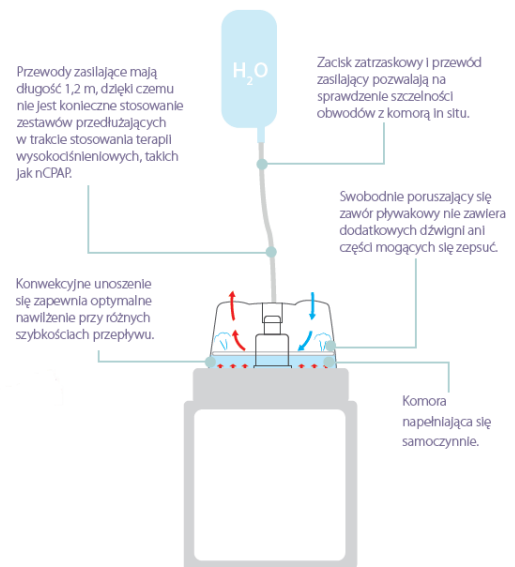

**Producent: Armstrong Medical Ltd., nr kat. AMHC1142**

### **Poz. 16-18 Smoczek uszczelniający**

Smoczek uszczelniający do nCPAP Infant Flow, do stymulacji odruchu ssania dla wcześniaków o wadze poniżej 1750g, z systemem aktywnego odpowietrzania:

- jednorazowego użytku,
- sterylny,
- anatomiczny-profilowany,
- wykonany z ekologicznego lateksu,

- posiada zintegrowaną, wyprofilowaną tarczkę, zapobiegającą odleżynom w okolicy warg, nosa i brody, z otworami w tarczce umożliwiającymi wprowadzenie sondy,
- dostępny w 2 kolorach: niebieski, różowy



**Producent: Mapa GmbH, nr kat. 107 029**

**Poz. 19-21 Końcówka nosowa łącząca generator z noworodkiem**

Końcówka jest miękka i bardzo delikatna dla skóry noworodka, część umieszczana w nozdrzach pacjenta o budowie rozszerzonej cylindrycznie na końcach w celu utrzymania szczelności, ze zróżnicowaną grubością ściany na całej długości części umieszczanej w nozdrzach - rozszerzenie jest cieńsze niż nasada, co skutkuje dokładnym dopasowaniem do fizjologicznej budowy nozdrza pacjenta i niezapadaniem pod wpływem ruchu, wykonana z silikonu. Dostępne są cztery rozmiary oznaczone kolorami. Do ustalenia prawidłowego rozmiaru końcówki służy miarka.

Końcówka donosowa	
AMNP2000XS	Końcówka nosowa b. mała XS, zielona,
AMNP2000S	Końcówka nosowa mała S, czerwona
AMNP2000M	Końcówka nosowa średnia M, niebieska
AMNP2000L	Końcówka nosowa duża L, fioletowa



**Producent: Armstrong Medical Ltd.**