

FORMULARZ OFERTOWY

Dane dotyczące Wykonawcy

Nazwa

Olympus Polska Sp. z o.o.

Siedziba **ul. Wynalazek 1, 02-677 Warszawa**

Województwo Mazowieckie

Nr telefonu/faks 22 366-00-77 / 22 366-00-49

nr NIP 522-165-17-38 nr REGON 012330343

Osoba do kontaktu z Zamawiającym / stanowisko: Rafał Wójcicki / Starszy Specjalista ds. Zamówień Publicznych

numer telefonu: 22 366-00-77 adres e-mail: przetargi.medical@olympus-europa.com

Zobowiązania wykonawcy

Nawiązując do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym na dostawę drobnego sprzętu medycznego w tym głównie sprzętu medycznego jednorazowego użytku, (Znak sprawy Te 2300-11/2022), oferujemy wykonanie zamówienia za następującą cenę:

Zadanie nr 58

Cena brutto: **39 796,92 zł**

Zadanie nr 66

Cena brutto: **219 024,00 zł**

(wstawić odpowiednią ilość zadań)

Działając w imieniu Wykonawcy oświadczam, że:

1. Zapoznaliśmy się ze specyfikacją warunków zamówienia i nie wnosimy do niej zastrzeżeń oraz, że zdobyliśmy konieczne informacje do przygotowania oferty.
2. Oferowane ceny zawierają wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia i Zamawiający nie poniesie żadnych dodatkowych kosztów związaną z realizacją zamówienia.
3. Oferowane przez nas wyroby spełniają wymogi określone w specyfikacji warunków zamówienia oraz posiadają atesty, zezwolenia, świadectwa rejestracji, certyfikaty wymagane przez polskie prawo, na podstawie, których mogą być wprowadzone do obrotu i stosowania w placówkach ochrony zdrowia w RP.
4. Wszystkie oferowane wyroby medyczne posiadają – odpowiednio do ich klasy – aktualne certyfikaty jednostki notyfikowanej i/lub deklaracje zgodności i wpisy do rejestru wyrobów medycznych.
5. Zobowiązujemy się dostarczyć Zamawiającemu dokumenty, o których mowa w pkt. 3 i 4 na jego wezwanie.
6. Pozostajemy związani niniejszą ofertą przez okres wskazany w specyfikacji warunków zamówienia.
7. W przypadku wybrania naszej oferty zobowiązujemy się do zawrzeć z Zamawiającym umowę na warunkach określonych w specyfikacji warunków zamówienia, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.
8. Oświadczam, że zamierzam powierzyć następującym podwykonawcy/om wykonanie następujących części zamówienia:

.....NIE DOTYCZY.....

(należy wskazać części zamówienia, których wykonanie Wykonawca zamierza powierzyć oraz nazwy firm podwykonawców - o ile są znane).

9. Wybór niniejszej oferty ~~będzie~~ /nie będzie (niewłaściwe skreślić) prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami ustawy o podatku od towarów i usług. Wskazujemy nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do powstania powyższego obowiązku podatkowegooraz wartość tego towaru lub usługi bez kwoty podatku wynoszącą
- (brak wskazania rozumiany będzie przez Zamawiającego jako informacja o tym, że wybór oferty nie będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego powyższego obowiązku podatkowego).
10. Oświadczam że należymy do grupy ~~mikro / małych / średnich przedsiębiorstw / dużych przedsiębiorstw~~ (niepotrzebne skreślić)
(zaznaczyć właściwe)
11. Pod groźbą odpowiedzialności karnej oświadczam, że załączone do oferty dokumenty opisują stan prawny i faktyczny, aktualny na dzień otwarcia ofert.
12. Wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.

Pełnomocnik w przypadku składania oferty wspólnej NIE DOTYCZY

Nazwisko, imię

Stanowisko

Telefon.....Fax.....

Na potwierdzenie spełnienia wymagań do oferty załączam:

- Formularze cenowe;
- Oświadczenie JEDZ;
- Oświadczenie, zgodne z załącznikiem nr 4 do SWZ;
- Materiały informacyjne producenta dot. oferowanych wyrobów;
- Odpis z KRS;
- Pełnomocnictwo (oddzielny plik pdf.)

Zastrzeżenie wykonawcy

Niżej wymienione dokumenty składające się na ofertę nie mogą być ogólnie udostępnione:

.....

.....

Inne informacje wykonawcy:

.....

Formularz cenowy - Zadanie nr 58

Lp.	Nazwa produktu	J.m.	Ilość	Producent i nr katalogowy	Wielkość opakowania handlowego (szt.)	Ilość opakowań handlowych	Cena jedn. netto	VAT (%)	Wartość brutto
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Ładowany aplikator klipsów do wielokrotnego klipsowania u jednego pacjenta ;jednorazowe narzędzie z funkcją rotacji do zakładania klipsów na krwawiące naczynia i szypuły polipów ; ciągną do osadzania klipsa zakończone stożkiem , współpracuje ze sterylnymi klipsami serii HX -610 w kartridżach ; maksymalna średnica części wprowadzającej 2,75mm, dł.narzędzia2300mm, minimalna średnica kanału roboczego 2,8mm ; opakowanie – 10szt	szt.	30	Olympus Medical Systems Corp. / N5432930 (nazwa: HX-810UR)	10	3,00	1 569,00 zł	8%	5 083,56 zł
2	Klipsy jednorazowe, długie ,do klipsownicy HX-110LR/QR/UR oraz HX-810LR/QR/UR,długość ramion klipsa 9mm, kąt zagięcia ramion 90 stopni; możliwość stosowania rezonansu magnetycznego/MR/ ;40sz . W opakowaniu.	szt.	80	Olympus Medical Systems Corp. / N6012730 (nazwa: HX-610-090L)	40	2,00	2 206,00 zł	8%	4 764,96 zł
3	Klipsy jednorazowe krótkie,do klipsownicy HX-110LR/QR/UR oraz HX-810LR/QR/UR,długość ramion klipsa 6 ; 7,5mm, kąt zagięcia ramion 90 stopni; możliwość stosowania rezonansu magnetycznego/MR/ ;40sz . W opakowaniu	szt.	80	Olympus Medical Systems Corp. / Do wyboru przez Zamawiającego: N6012330 (nazwa: HX-610-090), N6012530 (nazwa: HX-610-090S)	40	2,00	2 206,00 zł	8%	4 764,96 zł
4	Jednorazowy zestaw do wprowadzania protez 8,5 Fr typu one - action,,długość narzędzia 1900mm , posiada haczyk C ,posiada pokrętło umożliwiające zablokowanie odległości między cewnikiem prowadzącym a końcówką dystalną protezy ; minimalna średnica kanału roboczego 3,2 mm; maksymalna średnica prowadnicy 0,035"	szt.	50	Olympus Medical Systems Corp. / N4535630 (nazwa: MAJ-1819)	1	50,00	231,00 zł	8%	12 474,00 zł

5	Jednorazowe narzędzie służące do zapobiegania lub opanowania krwawienia po usunięciu uszypułowanych polipów; narzędzie składa się wstępnie zmontowanych uchwyty, osłonki, rurki osłonowej i odłączonej pętli nylonowej; długość narzędzia 2300 mm; średnica pętli 30mm; maksymalna średnica części wprowadzanej do endoskopu 2,6 mm; minimalna średnica kanału roboczego endoskopu 2,8 mm; zapakowane sterylne pakiety, gotowych do użycia narzędzi	szt.	40	Olympus Medical Systems Corp. / N5382130 (nazwa: HX-400U-30)	5	8,00	1 471,00 zł	8%	12 709,44 zł
Wartość razem									39 796,92 zł

W kolumnie nr 3 podano jednostkę miary w jakiej określono zapotrzebowanie (Ilość kol 4)

W kolumnie nr 4 podano przewidywane zapotrzebowanie na okres obowiązywania umowy

W kolumnie nr 5 wymagane jest podanie producenta i nr katalogowego oferowanego asortymentu

W kolumnie nr 6 Wykonawca podaje wielkość oferowanego opakowania handlowego (zgodnie z rejestracją)

W kolumnie nr 7 Wykonawca podaje ilość oferowanych opakowań handlowych (wymienionych w kol. Nr 6) koniecznych do wykonania zamówienia. Wielkość tą należy zaokrąglić do drugiego miejsca po przecinku

W kolumnie nr 8 Wykonawca podaje cenę jednostkową netto oferowanego opakowania handlowego

Wartość brutto (kolumna 10) = kolumna nr 7 x kolumna nr 8 + ... % VAT

Wartość razem = suma wszystkich pozycji brutto (Cena oferty)

Przez opakowanie handlowe Zamawiający rozumie najmniejsze opakowanie (zgodne z rejestracją) jakie będzie mógł zamówić.

Cena netto opakowania handlowego podana w formularzu będzie podstawą do wystawienia faktury przez Wykonawcę.

Formularz cenowy zad 66 -Sprzęt kompatybilny do aparatu elektrochirurgicznego OLYMPUS

Lp.	Nazwa produktu	J.m.	Ilość	Producent i nr katalogowy	Wielkość opakowania handlowego (szt.)	Ilość opakowań handlowych konieczna do wykonania zamówienia	Cena jedn. netto opakowania handlowego	VAT (%)	Wartość brutto
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	TD-TB400 przetwornik Thunderbeat. Wielorazowy, autoklawowalny, hybrydowy przetwornik ultradźwiękowo- bipolarny, kompatybilny z generatorem Olympus USG-400. Wtyczka oznaczona dla lepszej widoczności cyfrą '1'. Trzpień z gwintem wewnętrznym. Przetwornik współdziałający z narzędziami Olympus Thunderbeat.	szt.	2	Olympus Medical Systems Corp. / N3808760 (nazwa: TD-TB400)	1	2,00	9 000,00 zł	8%	19 440,00 zł
2	Narzędzie Thunderbeat do zabiegów otwartych, integrujące energię bipolarną i ultradźwiękową, umożliwiające jednoczesne cięcie i zamykanie naczyń krwionośnych do 7 mm włącznie, pęczków tkanki oraz naczyń limfatycznych. Wyposażone w 2 przyciski aktywujące: Seal & Cut oraz Seal. Dł. robocza 20 cm, śr. trzonu 9,7 mm. Zakrzywione, wydłużone, precyzyjne bransze o dł. 20 mm. Uchwyt narzędzia pistoletowy, uchwyt na palce prowadzące zamknięty. Trzon obrotowy 360 st. Narzędzie sterylne, jednorazowego użytku, do 5 szt. w opakowaniu. W komplecie uchwyt mocujący do przetwornika oraz klucz dynamometryczny.	szt.	60	Olympus Medical Systems Corp. / N4505530 (nazwa: TB-0920OE)	5	12,00	8 800,00 zł	8%	114 048,00 zł
3	Narzędzie Thunderbeat Type S, do zabiegów laparoskopowych, integrujące energię bipolarną i ultradźwiękową, umożliwiające jednoczesne cięcie i zamykanie naczyń krwionośnych do 7 mm włącznie. Wyposażone w 2 przyciski aktywujące: Seal & Cut - aktywujące symultanicznie energię bipolarną oraz ultradźwiękową do cięcia i koagulacji, oraz Seal - aktywujący zaawansowaną energię bipolarną do koagulacji. Dł. robocza 35 cm, śr. trzonu 5 mm. Zakrzywione, precyzyjne bransze o dł. 16 mm. Uchwyt narzędzia pistoletowy, uchwyt na palce prowadzące zamknięty. Trzon obrotowy 360 st. Narzędzie sterylne, jednorazowego użytku, do 5 szt. w opakowaniu. W komplecie uchwyt mocujący do przetwornika oraz klucz dynamometryczny.	szt.	30	Olympus Medical Systems Corp. / EGTB-0535FCS (nazwa: TB-0535FCS)	5	6,00	8 800,00 zł	8%	57 024,00 zł

4	Narzędzie Thunderbeat Type S, do zabiegów laparoskopowych, integrujące energię bipolarną i ultradźwiękową, umożliwiające jednoczesne cięcie i zamykanie naczyń krwionośnych do 7 mm włącznie. Wyposażone w 2 przyciski aktywujące: Seal & Cut - aktywujące symultanicznie energię bipolarną oraz ultradźwiękową do cięcia i koagulacji, oraz Seal - aktywujący zaawansowaną energię bipolarną do koagulacji. Dł. robocza 45 cm, śr. trzonu 5 mm. Zakrzywione, precyzyjne bransze o dł. 16 mm. Uchwyt narzędzia pistoletowy, uchwyt na palce prowadzące zamknięty. Trzon obrotowy 360 st. Narzędzie sterylne, jednorazowego użytku, do 5 szt. w opakowaniu. W komplecie uchwyt mocujący do przetwornika oraz klucz dynamometryczny.	szt.	5	Olympus Medical Systems Corp. / EGTB-0545FCS (nazwa: TB-0545FCS)	5	1,00	8 800,00 zł	8%	9 504,00 zł
5	Narzędzie Thunderbeat Open Fine Jaw, precyzyjne do zabiegów otwartych, integrujące energię bipolarną i ultradźwiękową, umożliwiające jednoczesne cięcie i zamykanie naczyń krwionośnych do 7 mm włącznie, pęczków tkanki oraz naczyń limfatycznych. Wyposażone w 2 przyciski aktywujące: Seal & Cut oraz Seal. Dł. robocza 9 cm. Bransze w kształcie Peana. Jedna bransza ruchoma. Uchwyt narzędzia nożycowy. Narzędzie sterylne, jednorazowego użytku, do 5 szt. w opakowaniu. W komplecie uchwyt mocujący do przetwornika oraz klucz dynamometryczny.	szt.	10	Olympus Medical Systems Corp. / N4505730 (nazwa: TB-0009OF)	5	2,00	8 800,00 zł	8%	19 008,00 zł
Wartość razem									219 024,00 zł

W kolumnie nr 3 podano jednostkę miary w jakiej określono zapotrzebowanie (Ilość kol 4)

W kolumnie nr 4 podano przewidywane zapotrzebowanie na okres obowiązywania umowy

W kolumnie nr 5 wymagane jest podanie producenta i nr katalogowego oferowanego asortymentu

W kolumnie nr 6 Wykonawca podaje wielkość oferowanego opakowania handlowego (zgodnie z rejestracją)

W kolumnie nr 7 Wykonawca podaje ilość oferowanych opakowań handlowych (wymienionych w kol. Nr 6) koniecznych do wykonania zamówienia. Wielkość tą należy zaokrąglić do drugiego miejsca po przecinku

W kolumnie nr 8 Wykonawca podaje cenę jednostkową netto oferowanego opakowania handlowego

Wartość brutto (kolumna10) = kolumna nr 7 x kolumna nr 8+ ... % VAT

Wartość razem = suma wszystkich pozycji brutto (Cena oferty)

Przez opakowanie handlowe Zamawiający rozumie najmniejsze opakowanie (zgodne z rejestracją) jakie będzie mógł zamówić.

Cena netto opakowania handlowego podana w formularzu będzie podstawą do wystawienia faktury przez Wykonawcę.

Jednolity europejski dokument zamówienia (ESPD)

Część I: Informacje dotyczące postępowania o udzielenie zamówienia oraz instytucji zamawiającej lub podmiotu zamawiającego

Informacje na temat publikacji

Numer ogłoszenia w Dz.U. S:

2022/S 101-279133

Krajowy dziennik urzędowy

-

W przypadku gdy zaproszenie do ubiegania się o zamówienie nie zostało opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej bądź gdy jego publikacja w Dzienniku Urzędowym nie jest wymagana, wówczas instytucja zamawiająca lub podmiot zamawiający musi podać informacje umożliwiające jednoznaczne zidentyfikowanie postępowania o udzielenie zamówienia (np. adres publikacyjny na poziomie krajowym).

Tożsamość zamawiającego

Oficjalna nazwa:

Pleszewskie Centrum Medyczne w Pleszewie Sp. z o. o.

Państwo:

Polska

Informacje na temat postępowania o udzielenie zamówienia

Rodzaj procedury

Procedura otwarta

Tytuł:

Dostawa drobnego sprzętu medycznego w tym głównie sprzętu medycznego jednorazowego użytku

Krótki opis:

1) Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa drobnego sprzętu medycznego w tym głównie sprzętu jednorazowego użytku, oraz papieru do rejestratorów. 2) Zestawienie i ilości zamawianych artykułów podane są w załączonych do specyfikacji warunków zamówienia "Formularzach cenowych". 3)

Oferowany przedmiot zamówienia musi posiadać atesty, zezwolenia, świadectwa rejestracji, certyfikaty wymagane przez polskie prawo, na podstawie, których może być wprowadzony do obrotu i stosowania w placówkach ochrony zdrowia w RP 4) Zamówienie obejmuje dostarczanie towaru zgodnie z przesyłanymi Wykonawcy zamówieniami. Towar dostarczany będzie na ryzyko i koszt Wykonawcy bezpośrednio w miejsce wskazane przez personel apteki szpitalnej.

Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucję zamawiającą lub podmiot zamawiający (jeżeli dotyczy):

Te2300-11/2022

Część II: Informacje dotyczące wykonawcy

A: Informacje na temat wykonawcy

Nazwa:

Olympus Polska Sp. z o.o.

Ulica i numer:

ul. Wynalazek 1

Kod pocztowy:

02-677

Miejscowość:

Warszawa

Państwo:

Polska

Adres internetowy (adres www) (jeżeli dotyczy):

www.olympus.pl

E-mail:

przetargi.medical@olympus-europa.com

Telefon:

223660077

Osoba(-y) wyznaczona(-e) do kontaktów:

Rafał Wójcicki

Numer VAT (jeżeli dotyczy):

PL 522-165-17-38

Jeżeli numer VAT nie ma zastosowania, proszę podać inny krajowy numer identyfikacyjny, jeżeli jest wymagany i ma zastosowanie.

-

Czy wykonawca jest mikroprzedsiębiorstwem bądź małym lub średnim przedsiębiorstwem?

Tak

Nie

Jedynie w przypadku, gdy zamówienie jest zastrzeżone: Czy wykonawca jest zakładem pracy chronionej, „przedsiębiorstwem społecznym” lub czy będzie realizował zamówienie w ramach programów zatrudnienia chronionego?

Tak

Nie

W stosownych przypadkach, czy wykonawca jest wpisany do urzędowego wykazu zatwierdzonych wykonawców lub posiada równoważne zaświadczenie (np. w ramach krajowego systemu (wstępnego) kwalifikowania)?

Tak

Nie

- Proszę dodatkowo uzupełnić brakujące informacje w części IV w sekcjach A, B, C lub D, w zależności od przypadku, WYŁĄCZNIE jeżeli jest to wymagane w danym ogłoszeniu lub dokumentach zamówienia

e) Czy wykonawca będzie w stanie przedstawić zaświadczenie odnoszące się do płatności składek na ubezpieczenie społeczne i podatków lub przedstawić informacje, które umożliwią instytucji zamawiającej lub podmiotowi zamawiającemu uzyskanie tego zaświadczenia bezpośrednio za pomocą bezpłatnej krajowej bazy danych w dowolnym państwie członkowskim?

Tak

Nie

Jeżeli odnośna dokumentacja jest dostępna w formie elektronicznej, proszę wskazać:

-

Czy wykonawca bierze udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia wspólnie z innymi wykonawcami?

Tak

Nie

W stosownych przypadkach, wskazanie części zamówienia, w odniesieniu do której (których) wykonawca zamierza złożyć ofertę:

Pakiet 58 i 66

B: Informacje na temat przedstawicieli wykonawcy #1

- W stosownych przypadkach proszę podać imię i nazwisko (imiona i nazwiska) oraz adres(-y) osoby (osób) upoważnionej(-ych) do reprezentowania wykonawcy na potrzeby niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia:

Imię

Rafał

Nazwisko

Wójcicki

Data urodzenia

-

Miejsce urodzenia

-

Ulica i numer:

ul. Wynalazek 1

Kod pocztowy:

02-677

Miejscowość:

Warszawa

Państwo:

Polska

E-mail:

przetargi.medical@olympus-europa.com

Telefon:

223660077

Stanowisko/Działający(-a) jako:

Starszy Specjalista ds. Zamówień Publicznych

W razie potrzeby proszę podać szczegółowe informacje dotyczące przedstawicielstwa (jego form, zakresu, celu itd.):

Pełnomocnictwo do reprezentowania spółki w niniejszym postępowaniu.

C: Informacje na temat polegania na zdolności innych podmiotów

Czy wykonawca polega na zdolności innych podmiotów w celu spełnienia kryteriów kwalifikacji określonych poniżej w części IV oraz (ewentualnych) kryteriów i zasad określonych poniżej w części V?

Tak

Nie

D: Informacje dotyczące podwykonawców, na których zdolności wykonawca nie polega

- (Sekcja, którą należy wypełnić jedynie w przypadku, gdy instytucja zamawiająca lub podmiot zamawiający wprost tego zażąda.)

Czy wykonawca zamierza zlecić osobom trzecim podwykonawstwo jakiegokolwiek części zamówienia?

Tak

Nie

- Jeżeli instytucja zamawiająca lub podmiot zamawiający wyraźnie żąda przedstawienia tych informacji, dodatkowo oprócz informacji wymaganych w części I, proszę przedstawić – dla każdego podwykonawcy (każdej kategorii podwykonawców), których to dotyczy – informacje wymagane w niniejszej części sekcja A i B oraz w części III.

Część III: Podstawy wykluczenia

A: Podstawy związane z wyrokami skazującymi za przestępstwo

W art. 57 ust. 1 dyrektywy 2014/24/UE określono następujące powody wykluczenia

udział w organizacji przestępczej

Czy w stosunku do samego wykonawcy bądź jakiegokolwiek osoby będącej członkiem organów administracyjnych, zarządzających lub nadzorczych wykonawcy, lub posiadającej w przedsiębiorstwie wykonawcy uprawnienia do reprezentowania, uprawnienia decyzyjne lub kontrolne, wydany został prawomocny wyrok za udział w organizacji przestępczej, orzeczeniem sprzed najwyżej pięciu lat lub w którym okres wykluczenia określony bezpośrednio w wyroku nadal obowiązuje? Zgodnie z definicją zawartą w art. 2 decyzji ramowej Rady 2008/841/WSiSW z dnia 24 października 2008 r. w sprawie zwalczania przestępczości zorganizowanej (Dz.U. L 300 z 11.11.2008, s. 42).

Proszę podać odpowiedź

Tak

Nie

Czy informacje te mogą zostać bezpłatnie uzyskane przez instytucje z bazy danych państwa członkowskiego UE?

Tak

Nie

korupcja

Czy w stosunku do samego wykonawcy bądź jakiegokolwiek osoby będącej członkiem organów administracyjnych, zarządzających lub nadzorczych wykonawcy, lub posiadającej w przedsiębiorstwie wykonawcy uprawnienia do reprezentowania, uprawnienia decyzyjne lub kontrolne, wydany został prawomocny wyrok za korupcję, orzeczeniem sprzed najwyżej pięciu lat lub w którym okres wykluczenia określony bezpośrednio w wyroku nadal obowiązuje? Zgodnie z definicją zawartą w art. 3 Konwencji w sprawie zwalczania korupcji urzędników Wspólnot Europejskich i urzędników państw członkowskich Unii Europejskiej (Dz.U. C 195 z 25.6.1997, s. 1) i w art. 2 ust. 1 decyzji ramowej Rady 2003/568/WSiSW z dnia 22 lipca 2003 r. w sprawie zwalczania korupcji w sektorze prywatnym (Dz.U. L 192 z 31.7.2003, s. 54). Ta podstawa wykluczenia obejmuje również korupcję zdefiniowaną w prawie krajowym instytucji zamawiającej (podmiotu zamawiającego) lub wykonawcy.

Proszę podać odpowiedź

Tak

Nie

Czy informacje te mogą zostać bezpłatnie uzyskane przez instytucje z bazy danych państwa członkowskiego UE?

Tak

Nie

nadużycie finansowe

Czy w stosunku do samego wykonawcy bądź jakiegokolwiek osoby będącej członkiem organów administracyjnych, zarządzających lub nadzorczych wykonawcy, lub posiadającej w przedsiębiorstwie wykonawcy uprawnienia do reprezentowania, uprawnienia decyzyjne lub kontrolne, wydany został prawomocny wyrok za nadużycie finansowe, orzeczeniem sprzed najwyżej pięciu lat lub w którym okres wykluczenia określony bezpośrednio w wyroku

nadal obowiązuje? W rozumieniu art. 1 Konwencji w sprawie ochrony interesów finansowych Wspólnot Europejskich (Dz.U. C 316 z 27.11.1995, s. 48).

Proszę podać odpowiedź

Tak

Nie

Czy informacje te mogą zostać bezpłatnie uzyskane przez instytucje z bazy danych państwa członkowskiego UE?

Tak

Nie

przestępstwa terrorystyczne lub przestępstwa związane z działalnością terrorystyczną

Czy w stosunku do samego wykonawcy bądź jakiegokolwiek osoby będącej członkiem organów administracyjnych, zarządzających lub nadzorczych wykonawcy, lub posiadającej w przedsiębiorstwie wykonawcy uprawnienia do reprezentowania, uprawnienia decyzyjne lub kontrolne, wydany został prawomocny wyrok za przestępstwa terrorystyczne lub przestępstwa związane z działalnością terrorystyczną, orzeczeniem sprzed najwyżej pięciu lat lub w którym okres wykluczenia określony bezpośrednio w wyroku nadal obowiązuje? Zgodnie z definicją zawartą w art. 1 i 3 decyzji ramowej Rady z dnia 13 czerwca 2002 r. w sprawie zwalczania terroryzmu (Dz.U. L 164 z 22.6.2002, s. 3). Ta podstawa wykluczenia obejmuje również podżeganie do popełnienia przestępstwa, pomocnictwo, współsprawstwo lub usiłowanie popełnienia przestępstwa, o których to czynach mowa w art. 4 tejże decyzji ramowej.

Proszę podać odpowiedź

Tak

Nie

Czy informacje te mogą zostać bezpłatnie uzyskane przez instytucje z bazy danych państwa członkowskiego UE?

Tak

Nie

pranie pieniędzy lub finansowanie terroryzmu

Czy w stosunku do samego wykonawcy bądź jakiegokolwiek osoby będącej członkiem organów administracyjnych, zarządzających lub nadzorczych wykonawcy, lub posiadającej w przedsiębiorstwie wykonawcy uprawnienia do reprezentowania, uprawnienia decyzyjne lub kontrolne, wydany został

prawomocny wyrok za pranie pieniędzy lub finansowanie terroryzmu, orzeczeniem sprzed najwyżej pięciu lat lub w którym okres wykluczenia określony bezpośrednio w wyroku nadal obowiązuje? Zgodnie z definicją zawartą w art. 1 dyrektywy 2005/60/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 października 2005 r. w sprawie przeciwdziałania korzystaniu z systemu finansowego w celu prania pieniędzy oraz finansowania terroryzmu (Dz.U. L 309 z 25.11.2005, s. 15).

Proszę podać odpowiedź

Tak

Nie

Czy informacje te mogą zostać bezpłatnie uzyskane przez instytucje z bazy danych państwa członkowskiego UE?

Tak

Nie

praca dzieci i inne formy handlu ludźmi

Czy w stosunku do samego wykonawcy bądź jakiegokolwiek osoby będącej członkiem organów administracyjnych, zarządzających lub nadzorczych wykonawcy, lub posiadającej w przedsiębiorstwie wykonawcy uprawnienia do reprezentowania, uprawnienia decyzyjne lub kontrolne, wydany został prawomocny wyrok za pracę dzieci i inne formy handlu ludźmi, orzeczeniem sprzed najwyżej pięciu lat lub w którym okres wykluczenia określony bezpośrednio w wyroku nadal obowiązuje? Zgodnie z definicją zawartą w art. 2 dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/36/UE z dnia 5 kwietnia 2011 r. w sprawie zapobiegania handlowi ludźmi i zwalczania tego procederu oraz ochrony ofiar, zastępującej decyzję ramową Rady 2002/629/WSiSW (Dz.U. L 101 z 15.4.2011, s. 1).

Proszę podać odpowiedź

Tak

Nie

Czy informacje te mogą zostać bezpłatnie uzyskane przez instytucje z bazy danych państwa członkowskiego UE?

Tak

Nie

B: Podstawy związane z płatnością podatków lub składek na ubezpieczenie społeczne

W art. 57 ust. 2 dyrektywy 2014/24/UE określono następujące powody wykluczenia

płatność podatków

Czy wykonawca dopuścił się naruszenia swoich obowiązków dotyczących płatności podatków, zarówno w państwie, w którym ma siedzibę, jak i w państwie członkowskim instytucji zamawiającej lub podmiotu zamawiającego, jeżeli jest ono inne niż państwo siedziby?

Proszę podać odpowiedź

Tak

Nie

Czy informacje te mogą zostać bezpłatnie uzyskane przez instytucje z bazy danych państwa członkowskiego UE?

Tak

Nie

płatność składek na ubezpieczenie społeczne

Czy wykonawca dopuścił się naruszenia swoich obowiązków dotyczących płatności składek na ubezpieczenie społeczne, zarówno w państwie, w którym ma siedzibę, jak i w państwie członkowskim instytucji zamawiającej lub podmiotu zamawiającego, jeżeli jest ono inne niż państwo siedziby?

Proszę podać odpowiedź

Tak

Nie

Czy informacje te mogą zostać bezpłatnie uzyskane przez instytucje z bazy danych państwa członkowskiego UE?

Tak

Nie

C: Podstawy związane z niewypłacalnością, konfliktem interesów lub wykroczeniami zawodowymi

W art. 57 ust. 4 dyrektywy 2014/24/UE określono następujące powody wykluczenia

upadłość

Czy wykonawca znajduje się w stanie upadłości?

Proszę podać odpowiedź

Tak

Nie

Czy informacje te mogą zostać bezpłatnie uzyskane przez instytucje z bazy danych państwa członkowskiego UE?

Tak

Nie

niewypłacalność

Czy wykonawca jest objęty postępowaniem upadłościowym lub likwidacyjnym?

Proszę podać odpowiedź

Tak

Nie

Czy informacje te mogą zostać bezpłatnie uzyskane przez instytucje z bazy danych państwa członkowskiego UE?

Tak

Nie

układ z wierzycielami

Czy wykonawca zawarł układ z wierzycielami?

Proszę podać odpowiedź

Tak

Nie

Czy informacje te mogą zostać bezpłatnie uzyskane przez instytucje z bazy danych państwa członkowskiego UE?

Tak

Nie

inna sytuacja podobna do upadłości wynikająca z prawa krajowego

Czy wykonawca znajduje się w innej sytuacji podobnej do upadłości wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w krajowych przepisach ustawowych i wykonawczych?

Proszę podać odpowiedź

Tak

Nie

Czy informacje te mogą zostać bezpłatnie uzyskane przez instytucje z bazy danych państwa członkowskiego UE?

Tak

Nie

aktywami zarządza likwidator

Czy aktywami wykonawcy zarządza likwidator lub sąd?

Proszę podać odpowiedź

Tak

Nie

Czy informacje te mogą zostać bezpłatnie uzyskane przez instytucje z bazy danych państwa członkowskiego UE?

Tak

Nie

działalność gospodarcza jest zawieszona

Czy działalność gospodarcza wykonawcy jest zawieszona?

Proszę podać odpowiedź

Tak

Nie

Czy informacje te mogą zostać bezpłatnie uzyskane przez instytucje z bazy danych państwa członkowskiego UE?

Tak

Nie

Część IV: Kryteria kwalifikacji

α: Ogólne oświadczenie dotyczące wszystkich kryteriów kwalifikacji

W odniesieniu do kryteriów kwalifikacji wykonawca oświadcza, że

Spełnia wszystkie wymagane kryteria kwalifikacji.

Proszę podać odpowiedź

Tak

Nie

Zakończ

Część VI: Oświadczenia końcowe

Wykonawca oficjalnie oświadcza, że informacje podane powyżej w częściach II-V są dokładne i prawidłowe oraz że zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji poważnego wprowadzenia w błąd.

Wykonawca oficjalnie oświadcza, że jest w stanie, na żądanie i bez zwłoki, przedstawić zaświadczenia i inne rodzaje dowodów w formie dokumentów, z wyjątkiem przypadków, w których:

- a) instytucja zamawiająca lub podmiot zamawiający ma możliwość uzyskania odpowiednich dokumentów potwierdzających bezpośrednio za pomocą bezpłatnej krajowej bazy danych w dowolnym państwie członkowskim (pod warunkiem że wykonawca przekazał niezbędne informacje (adres internetowy, dane wydającego urzędu lub organu, dokładne dane referencyjne dokumentacji) umożliwiające instytucji zamawiającej lub podmiotowi zamawiającemu tę czynność; w razie potrzeby musi temu towarzyszyć odpowiednia zgoda na uzyskanie takiego dostępu), lub
- b) najpóźniej od dnia 18 października 2018 r. (w zależności od wdrożenia w danym kraju artykułu 59 ust. 5 akapit drugi dyrektywy 2014/24/UE), instytucja zamawiająca lub podmiot zamawiający już posiada odpowiednią dokumentację.

Wykonawca oficjalnie wyraża zgodę na to, aby instytucja zamawiająca lub podmiot zamawiający określone w części I uzyskał(-a)(-o) dostęp do dokumentów potwierdzających informacje, które zostały przedstawione w części III i IV niniejszego jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia na potrzeby postępowanie o udzielenie zamówienia określonego w części I.

Data, miejscowość oraz – jeżeli jest to wymagane lub konieczne – podpis(-y):

data

27-06-2022

Miejsce

Warszawa

Podpis

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY

o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz.U. poz. 835) oraz art. 5k rozporządzenia Rady (UE) 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r. dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz. Urz. UE nr L 229 z 31.7.2014)

Olympus Polska Sp. z o.o.
ul. Wynalazek 1, 02-677 Warszawa
(pełna nazwa i adres Wykonawcy)

Oświadczam, że Wykonawca w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego przez Lotnicze Pogotowie Ratunkowe pn. „Dostawa drobnego sprzętu medycznego w tym głównie sprzętu medycznego jednorazowego użytku” (Nr postępowania: Te2300-11/2022

1. ~~podlega~~ / **nie podlega*** wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego;
2. ~~podlega~~ / **nie podlega*** wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 5k rozporządzenia Rady (UE) 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r. dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie.

* *niepotrzebne skreślić*

Oświadczenie dotyczące podwykonawcy, na którego przypada ponad 10% wartości zamówienia:

UWAGA: wypełnić tylko w przypadku podwykonawcy (niebędącego podmiotem udostępniającym zasoby), na którego przypada ponad 10% wartości zamówienia. W przypadku więcej niż jednego podwykonawcy, na którego zdolnościach lub sytuacji wykonawca nie polega, a na którego przypada ponad 10% wartości zamówienia, należy zastosować tyle razy, ile jest to konieczne.

Oświadczam, że w stosunku do następującego podmiotu, będącego podwykonawcą, na którego przypada ponad 10% wartości zamówienia:

.....**NIE DOTYCZY**.....
(podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)

zachodzą / nie zachodzą* podstawy wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia przewidziane w art. 5k rozporządzenia Rady (UE) 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r. dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie.

Oświadczenie dotyczące dostawcy, na którego przypada ponad 10% wartości zamówienia:

UWAGA: wypełnić tylko w przypadku dostawcy, na którego przypada ponad 10% wartości zamówienia. W przypadku więcej niż jednego dostawcy, na którego przypada ponad 10% wartości zamówienia, należy zastosować tyle razy, ile jest to konieczne.

Oświadczam, że w stosunku do następującego podmiotu, będącego dostawcą, na którego przypada ponad 10% wartości zamówienia:

Olympus Europa SE & Co. KG / Niemiecki rejestr przedsiębiorców nr HRA 116518
(podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)

zachodzą/ nie zachodzą* podstawy wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia przewidziane w art. 5k rozporządzenia Rady (UE) 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r. dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie.

** niepotrzebne skreślić*

Oświadczenie dotyczące podanych informacji:

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia Zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

Uwaga:

W przypadku złożenia oferty przez podmioty występujące wspólnie, wymagane oświadczenie winno być złożone przez każdy podmiot.

Dokument powinien być podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy.

TAMOWANIE KRWAWIENIA

EZ Clip

Jednorazowy aplikator




- Brak konieczności przeprowadzania dekontaminacji po użyciu
- Ekonomiczna klipsownica jednorazowego użytku umożliwia wielokrotne zakładanie klipsów
- Szybkie i łatwe ponowne ładowanie klipsów (mechanizm typu push-pull)
- Ponowne ładowanie klipsów w ramach jednego przypadku klinicznego
- Funkcja rotacji ułatwiająca dostęp do docelowych tkanek
- Zgodność ze wszystkimi rodzajami klipsów EZ Clip (z serii HX-610)
- Trzy długości robocze do wyboru



Nazwa artykułu	Nr artykułu	Ilość	Min. średnica kanału roboczego	Długość robocza	Do użycia z	Obszar zastosowań
HX-810LR	N5432730	10	● 2,8 mm	1650 mm	Seria HX-610	
HX-810QR	N5432830	10	● 2,8 mm	1950 mm	Seria HX-610	
HX-810UR	N5432930	10	● 2,8 mm	2300 mm	Seria HX-610	

EZ Clip

Aplikator wielorazowy



- Nadaje się do sterylizacji w autoklawie
- Ekonomiczna klipsownica wielorazowego użytku umożliwia wielokrotne zakładanie klipsów
- Szybkie i łatwe ponowne ładowanie klipsów (mechanizm typu push-pull)
- Ponowne ładowanie klipsów w ramach jednego przypadku klinicznego
- Funkcja rotacji ułatwiająca dostęp do docelowych tkanek
- Zgodność ze wszystkimi rodzajami klipsów EZ Clip (z serii HX-610)
- Trzy długości robocze do wyboru



Nazwa artykułu	Nr artykułu	Ilość	Min. średnica kanału roboczego	Długość robocza	Do użycia z	Obszar zastosowań
HX-110LR	N1085230	1	● 2,8 mm	1650 mm		
HX-110QR	N1085330	1	● 2,8 mm	1950 mm		
HX-110UR	N1085430	1	● 2,8 mm	2300 mm		

10 Parametry techniczne

W tabelach znajdujących się na kolejnych stronach wyszczególniono zgodne endoskopy firmy Olympus. Część nowych endoskopów dostępnych po wprowadzeniu aplikatora klipsów i klipsa na rynek również może być stosowana w zestawie. W celu uzyskania dalszych szczegółowych informacji należy skontaktować się z firmą Olympus.


OSTRZEŻENIE

- Z aplikatora klipsów i klipsa można korzystać wyłącznie w zestawieniu z produktami zalecanymi przez firmę Olympus. W przeciwnym razie może dojść do obrażeń ciała pacjenta lub operatora, nieprawidłowego działania lub uszkodzenia sprzętu.
- Nie używać przyrządu z endoskopem Olympus SIF. W zależności od położenia endoskopu w ciele pacjenta, suwak może być przyciśnięty tak, że prawidłowe przeprowadzenie klipsowania będzie niemożliwe i/lub odłączenie klipsa od aplikatora będzie utrudnione.
- Nie używać przyrządu z endoskopem wyposażonym w elewator kleszczyków. W przypadku stosowania przyrządu w endoskopie dwukanałowym nie należy wprowadzać przyrządu do kanału z elewator kleszczyków. Po uniesieniu elewatora kleszczyków suwak może zostać przyciśnięty, co może spowodować nieprawidłowe działanie klipsa i/lub utrudnić odłączenie klipsa od aplikatora.

10.1 Otoczenie

Środowisko robocze	Temperatura otoczenia	10–40°C
	Wilgotność względna	30 – 85%
	Ciśnienie atmosferyczne	700–1060 hPa
Standardowe warunki przechowywania (np. w szpitalu)	Temperatura otoczenia	5–40°C
	Wilgotność względna	10 – 95%
	Ciśnienie atmosferyczne	700–1060 hPa
Warunki transportu (parametry transportu i krótkoterminowego przechowywania)	Temperatura otoczenia	–40 do +70°C
	Wilgotność względna	10 – 95%
	Ciśnienie atmosferyczne	700–1060 hPa

10.2 Parametry techniczne


Model	HX-810LR	HX-810QR	HX-810UR
Kształt części dystalnej części wprowadzanej			
Maksymalna średnica części wprowadzanej (mm)	ø 2,75		
Długość robocza (mm)	1650	1950	2300

EZ Clip

Klipsy do jednorazowego oraz wielorazowego aplikatora



- Szybkie i wydajne mechaniczne tamowanie krwawienia
- Osiem rodzajów klipsów EZ Clip do różnych zastosowań
- Sterylne klipsy w kartridżach
- Szczęki o kątach 90° i 135°
- Krótka końcówka
- Kartridże oznaczone kolorami umożliwiające łatwą identyfikację klipsów
- Do stosowania z wielorazowymi i jednorazowymi aplikatorami klipsów
- Dodatkowe zastosowania, w tym zamykanie ubytków śluzówki, oznaczanie i kotwiczenie



Nazwa artykułu	Nr artykułu	Ilość	Długość ramienia klipsa	Kolor kartridża	Kąt zagięcia ramion	Cechy	Obszar zastosowań
HX-610-135XS	N6012930	24	Wyjątkowo krótki, ok.4 mm	Szary	135°	Do krwawiących owrzodzeń	
HX-610-135S	N6012630	40	Krótki, ok.6 mm	Zielony	135°	Do silniejszego klipsowania/ mniejszej powierzchni; hemostaza bardziej sztywnych zmian	
HX-610-135	N6012430	40	Dł. standardowa, ok.7,5 mm	Różowy	135°	Do patologicznie zmienionej śluzówki, głębokich zmian o charakterze owrzodzeń, tkanki nowotworowej	
HX-610-135L	N6012830	40	Długi, ok.9 mm	Fioletowy	135°	Szerokie rozwarcie klipsa, do klipsowania po zabiegach EMR i polipektomii w przypadku polipów o dużej szypułce, do podejścia stycznego	
HX-610-090S	N6012530	40	Krótki, ok.6 mm	Biały	90°	Do oznaczania	
HX-610-090	N6012330	40	Dł. standardowa, ok.7,5 mm	Żółty	90°	Do zdrowej, elastycznej śluzówki, zespołu Mallory'ego-Weissa, otwartych naczyń, niewielkich perforacji i oznaczania	
HX-610-090L	N6012730	40	Długi, ok.9 mm	Niebieski	90°	Do zdrowej, elastycznej śluzówki, dużych zmian chorobowych, dużych gruczolakowatych szypulek przed i po	
HX-610-090SC	N6015630	24	Krótki, ok.6 mm	Biały	90°	Specjalne klipsy do oznaczania: kolorowa część dystalna; po 8 klipsów białych, czerwonych i żółtych w każdym opakowaniu	

ZABIEGI W OBRĘBIE DRÓG ŻÓŁCIOWYCH I TRZUSTKI



Jednorazowe zestawy do wprowadzania stentów oraz pojedyncze plastikowe stenty do przewodów żółciowych i trzustkowych

Stenty do zastosowań w obrębie trzustki i dróg żółciowych dostępne są w wielu różnych kształtach i rozmiarach:

- Optymalne połączenie elastyczności i sztywności
- Różne rozmiary w skali French
- Dostępne modele o różnej konstrukcji

Wyjątkowa dwuwarstwowa budowa z niezwykle gładką powierzchnią wewnętrzną oraz bardziej sztywną powierzchnią zewnętrzną:

- Ograniczone gromadzenie się żółci
- Płynne wprowadzanie
- Lepsza drożność

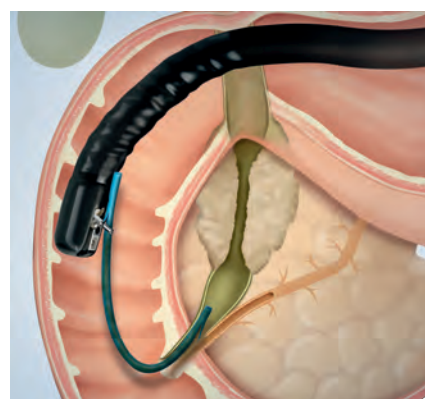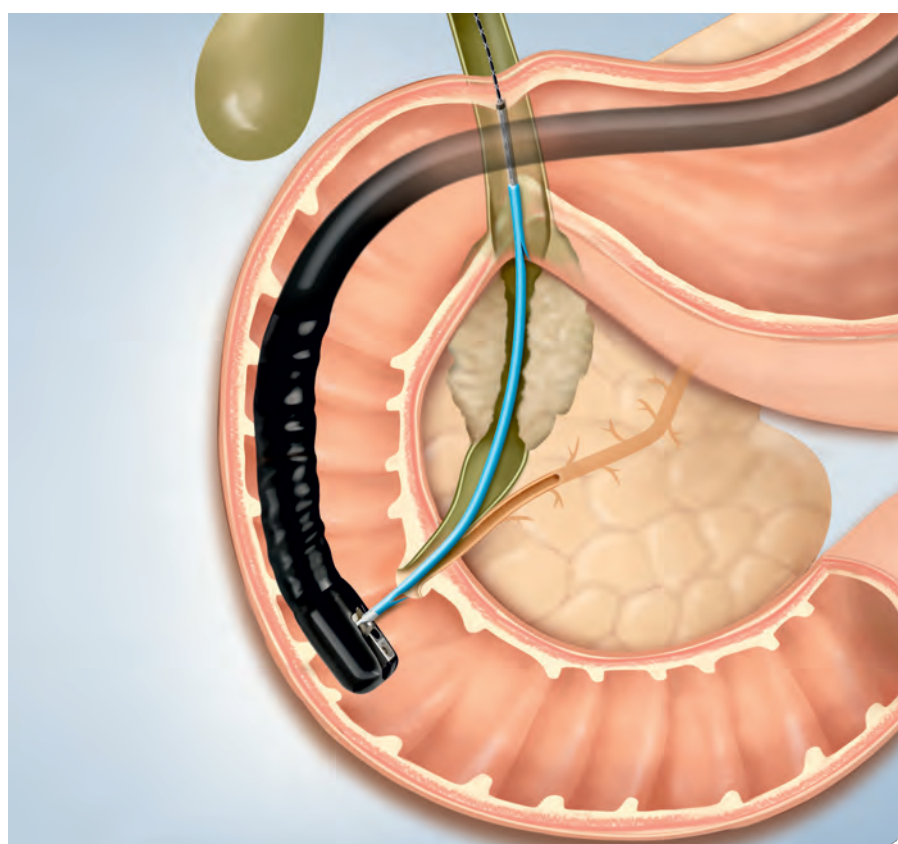


QuickPlace V

Biliary Stent

Jednorazowy zestaw do wprowadzania stentów 7 Fr.



- Sterylnie zapakowany – gotowy do użycia
- Cewnik popychający



Nazwa artykułu	Nr artykułu	Ilość	Min. średnica kanału roboczego	Długość robocza	Kompatybilny przewodnik	Rozmiar stentu	Obszar zastosowań
MAJ-1818	N4535530	1	● 3,2 mm	1900 mm	0,035"	7 Fr.	


QuickPlace V

Biliary Stent

Jednorazowy zestaw do wprowadzania stentów 8,5 Fr.



- Sterylnie zapakowany – gotowy do użycia
- Końcówka nieprzepuszczająca promieni RTG
- Gotowy do użycia cewnik prowadzący i popychacz
- Doskonałe wprowadzanie




Nazwa artykułu	Nr artykułu	Ilość	Min. średnica kanału roboczego	Długość robocza	Kompatybilny przewodnik	Rozmiar stentu	Obszar zastosowań
MAJ-1819	N4535630	1	● 3,2 mm	1900 mm	0,035"	8,5 Fr.	

OSTRZEŻENIE

- Niniejszego narzędzia nie należy stosować u pacjentów, w przypadku których występują przeciwwskazania do przeprowadzania zabiegów ECPW. Czynności te mogą spowodować zakażenie, podrażnienie tkanki, perforację, krwawienie lub uszkodzenie błony śluzowej.
- Niniejszego narzędzia nie należy stosować u pacjentów, w przypadku których występuje znaczne zwężenie uniemożliwiające przeprowadzenie cewnika prowadzącego lub stentu. Może to spowodować obrażenia pacjenta, takie jak perforacja, krwawienie lub uszkodzenie błony śluzowej.


7 Nazewnictwo i funkcje

○ Zestaw do wprowadzania (MAJ-1818)

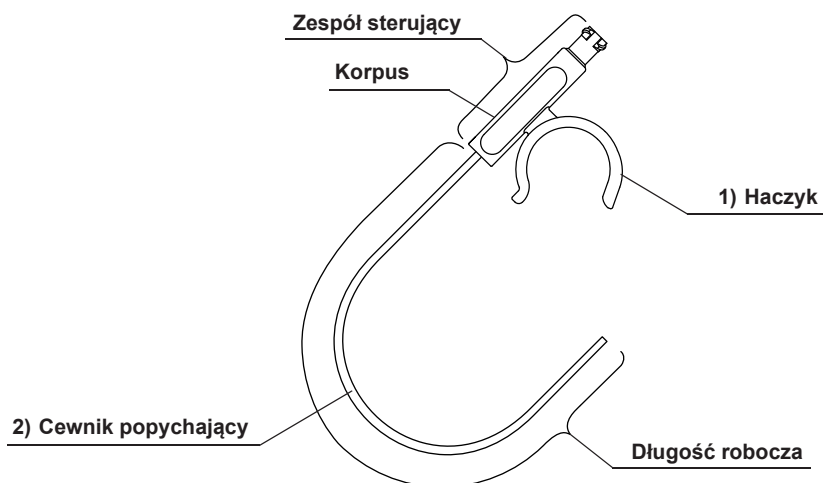

Nazewnictwo	Opis
1) Haczyk	Ten element należy zamocować na koszulce endoskopu.
2) Cewnik popychający	Służy do popychania stentu do wskazanej lokalizacji.

○ Zestaw do wprowadzania (MAJ-1819/1820/1821)

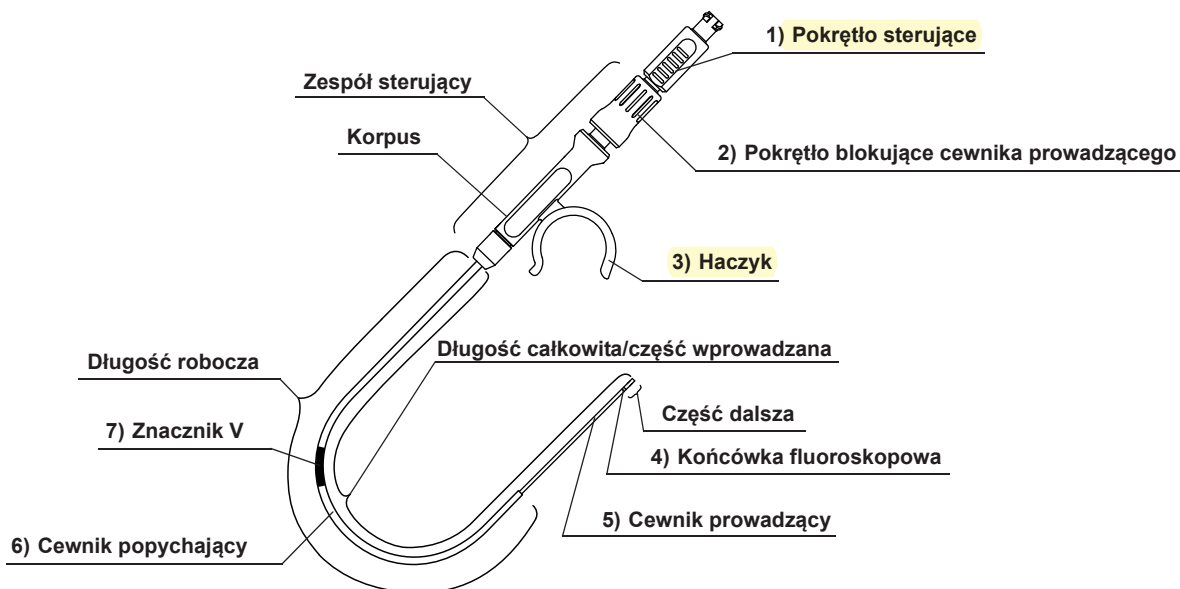

Nazewnictwo	Opis
1) Pokrętło sterujące	Służy do sterowania cewnikiem prowadzącym. Umożliwia wstrzyknięcie środka kontrastowego do ciała pacjenta za pomocą strzykawki, jeśli jest to konieczne.
2) Pokrętło blokujące cewnika prowadzącego	Obracanie tego pokrętła w prawo umożliwia zachowanie odpowiedniej odległości cewnika prowadzącego od końcówki dalszej stentu.
3) Haczyk	Ten element należy zamocować na koszulce endoskopu.
4) Końcówka fluoroskopowa	Umożliwia wizualizację końcówki dalszej cewnika prowadzącego na obrazie rentgenowskim.
5) Cewnik prowadzący	Służy do prowadzenia stentu do wskazanej lokalizacji przez wprowadzenie cewnika do stentu.
6) Cewnik popychający	Służy do popychania stentu do wskazanej lokalizacji.
7) Znacznik V	Wskazuje użytkownikowi, jak daleko wprowadzono cewnik prowadzący do endoskopu.

POLIPEKTOMIA, EMR I ESD

Jednorazowe narzędzie do podwiązania



- Do podwiązania polipów przed polipektomią
- Zapobieganie krwawieniu po polipektomii
- Wstępnie założona pętla z uchwytem, gotowa do użycia
- Podwiązanie za pomocą nylonowej pętli minimalizuje uszkodzenia tkanek
- Średnica otworu wynosząca 30 mm umożliwia podwiązanie dużych polipów



Nazwa artykułu	Nr artykułu	Ilość	Min. średnica kanału roboczego	Długość robocza	Średnica pętli	Obszar zastosowań
HX-400U-30	N5382130	5	● 2,8 mm	2300 mm	30 mm	


Wielorazowe narzędzie do podwiązania



HX-20U-1



MAJ-253



MAJ-254



MAJ-340



MA-479


- Do podwiązania polipów przed polipektomią
- Zapobieganie krwawieniu po polipektomii
- Dostępne są dwa rozmiary pętli
- Aplikator (osłonka zwojowa i osłonka rurki) do użycia w połączeniu z uchwytem FG (MA-479)

Nazwa artykułu	Nr artykułu	Ilość	Min. średnica kanału roboczego	Długość robocza	Średnica pętli	Kolor uchwytu pętli	Cechy	Obszar zastosowań
HX-20U-1	026292	1 korpus	● 2,8 mm	2300 mm			Korpus z osłonką do MA-479, MAJ-254, MAJ-340	
MAJ-253	026293	1 osłona	● 2,8 mm	2300 mm			Zapassowa osłonka do HX-20U-1	
MAJ-254	026294	10 pętli			30 mm	Biały	Do użycia z modelem HX-20U-1	
MAJ-340	026315	10 pętli			20 mm	Żółty	Do użycia z modelem HX-20U-1	
MA-479	026951	1 uchwyt						

Środowisko robocze

Temperatura otoczenia: 10 – 40°C, Wilgotność względna: 30 – 85%,
Ciśnienie powietrza: 700 – 1060 hPa

Parametry techniczne

Model	HX-400U-30	
Długość robocza (mm)	2300	
Maksymalna średnica części wprowadzanej (mm)	ø 2,6	
Maksymalna szerokość pętli (mm)	30	
Zgodne endoskopy firmy Olympus (wszystkie parametry muszą być spełnione)	Długość i model	Długość robocza poniżej 1850 mm; GIF, OGF, CF, PCF, OSF
	Wewnętrzna średnica kanału (mm) (kolorowe oznaczenie)	ø 2,8, ø 3,2 (żółty), ø 3,7, ø 4,2, ø 6 (pomarańczowy)
	Inne	Kąt widzenia: 0° (widok z przodu) wyłącznie
Dyrektywa dotycząca urządzeń medycznych	 0197	Urządzenie to jest zgodne z wymogami dyrektywy 93/42/EWG dotyczącej urządzeń medycznych. Klasyfikacja: Klasa IIa

Przechowywanie

OSTRZEŻENIE

Nie przechowywać sterylnej opakowania zawierającego urządzenie w miejscach, w których może ono zostać uszkodzone, zamoczone lub nieprawidłowo zamknięte. Niewłaściwe przechowywanie urządzenia może spowodować utratę sterylności i stać się przyczyną zakażenia lub podrażnienia tkanki.

Urządzenie należy przechowywać w sterylnym opakowaniu w temperaturze pokojowej, w czystym i suchym pomieszczeniu. Nie przechowywać w miejscach narażonych na bezpośrednie działanie promieni słonecznych.

INSTRUKCJE

Przetwornik THUNDERBEAT

TD-TB400

Przetwornik SONICBEAT

TD-SB400




Numer artykułu: PL-8002543



Symbole

Symbole dotyczące bezpieczeństwa są umieszczone na urządzeniu w miejscach przedstawionych poniżej. Jeżeli brakuje jakichś symboli albo są one nieczytelne, należy skontaktować się z firmą Olympus.

○ Przetwornik THUNDERBEAT (TD-TB400)

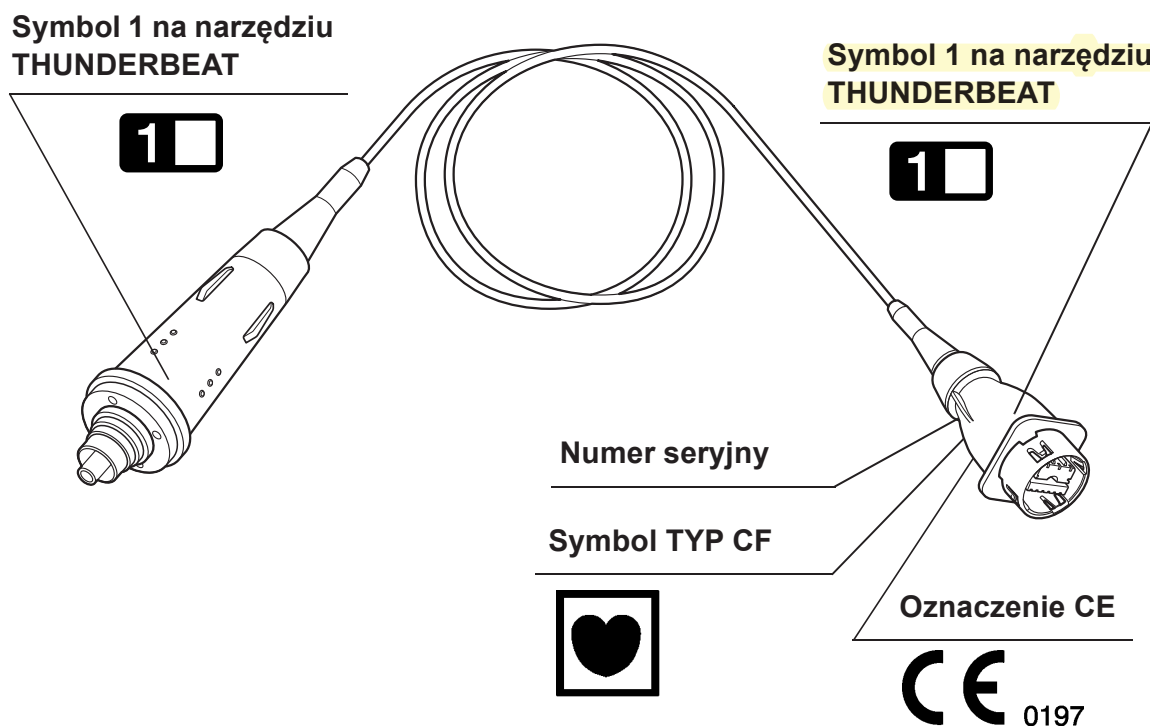

2.3 Dane techniczne



Zadanie 66, poz. 1

Środowisko

Środowisko robocze	Temperatura otoczenia	10–40°C (50–104°F)
	Wilgotność względna	30–85%
	Ciśnienie atmosferyczne	70–106 kPa
	Wysokość	3000 m lub mniej
Warunki transportu i przechowywania	Temperatura otoczenia	od -40 do +60°C (od -40 do +140°F)
	Wilgotność względna	10–90%
	Ciśnienie atmosferyczne	70–106 kPa

Dane techniczne

Pozycja		Parametry techniczne	
Model		TD-TB400	TD-SB400
Emisja ultradźwięków	Częstotliwość	47 kHz	
Wielkość	Średnica zewnętrzna	Ø 33 mm	Ø 31 mm
	Masa	60 g (nie uwzględnia przewodu przetwornika i wtyku przetwornika)	
	Długość przewodu przetwornika	3100 mm	
Znamionowe napięcie o wysokiej częstotliwości (RF, dwubiegunowe)		229 Vp	–
Długość cyklu pracy (normalna długość)		ON: 5 s/OFF: 10 s	

Dyrektywa dotycząca wyrobów medycznych		<p>Niniejszy przyrząd jest zgodny z wymogami dyrektywy 93/42/EWG w sprawie wyrobów medycznych.</p> <p>Klasyfikacja: Klasa II b</p>
Dyrektywa RoHS		<p>Niniejsze urządzenie spełnia wymagania dyrektywy 2011/65/UE oraz (UE) 2015/863 w sprawie sprzętu elektrycznego i elektronicznego.</p>
Kompatybilność elektromagnetyczna	Stosowana norma	<p>IEC 60601-1-2: 2001 IEC 60601-1-2: 2007 IEC 60601-1-2: 2014 IEC 60601-2-2: 1998 (TD-TB400) IEC 60601-2-2: 2009 (TD-TB400)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Urządzenie to jest zgodne z wymogami normy dotyczącej zgodności elektromagnetycznej elektrycznych urządzeń medycznych, wydanie 4 (IEC 60601-1-2:2014). Jeśli urządzenie zostanie podłączone do urządzenia spełniającego wymogi poprzedniego wydania normy dotyczącej zgodności elektromagnetycznej dla elektrycznych urządzeń medycznych, wówczas zachowanie deklarowanych parametrów zgodności elektromagnetycznej może nie być możliwe. • Emisja wypromieniowana wg CISPR 11: TD-TB400: Grupa 1, Klasa A TD-SB400: Grupa 1, Klasa B (tryb gotowości)
Rok produkcji	9012345	<p>↑ Ostatnia cyfra roku produkcji jest jednocześnie drugą cyfrą numeru seryjnego.</p>

**Ochrona przed porażeniem
prądem wywołanym częścią
aplikacyjną**

Klasyfikacja: Część aplikacyjna typu CF narzędzia elektromedycznego Ochrona przed porażeniem prądem wywołanym tym narzędziem zależy od używanego sprzętu elektromedycznego. Należy odnieść się do instrukcji obsługi dołączonej do konkretnego urządzenia.

Zadanie 66, poz. 2-5

THUNDERBEAT

Unikatowa technologia hybrydowa



Celem firmy Olympus jest dostarczanie innowacyjnych rozwiązań energetycznych, które są bezpieczne do stosowania podczas zabiegów chirurgicznych, umożliwiają korzystanie z różnorodnych urządzeń, zapewniają płynny przebieg zabiegu i przynoszą jak najwięcej korzyści pacjentom. Dlatego firma Olympus opracowała wyjątkową technologię hybrydową THUNDERBEAT przeznaczoną do wykorzystania podczas zabiegów otwartych i laparoskopowych. THUNDERBEAT to pierwszy i jedyny na świecie zaawansowany system energetyczny, który dostarcza do tkanek dwie powszechnie stosowane formy energii jednocześnie:

- **Energię ultradźwiękową – w celu uzyskania lepszej dysekcji i możliwości szybkiego cięcia tkanek**
- **Zaawansowaną energię bipolarną – w celu szybkiej i bezpiecznej hemostazy naczyń o średnicy do 7 mm włącznie**

Wprowadzenie do oferty systemu nowej generacji THUNDERBEAT Type S sprawia, że wyjątkowa koncepcja technologii hybrydowej osiągnęła zupełnie nowy poziom. Opracowanie innowacyjnej powłoki Type S oraz rewolucyjny system bezpieczeństwa Intelligent Tissue Monitoring (ITM) pozwalają w optymalnym stopniu kontrolować temperaturę i dostarczać energię w sposób ukierunkowany, dzięki czemu zabieg przebiega szybko i bezpiecznie.

System THUNDERBEAT jest zgodny z generatorem ESG-400 działającym w połączeniu z generatorem USG-400.




Informacje dotyczące składania zamówień

Numer artykułu	Opis artykułu	Kod artykułu	Średnica	Długość	Uchwyt	Liczba elementów
Urządzenia THUNDERBEAT do zabiegów endoskopowych						
EGTB-0535FCS	THUNDERBEAT Type S	TB-0535FCS	5 mm	35 cm	Z przednim manipulatorem	5/pudełko
EGTB-0545FCS	THUNDERBEAT Type S	TB-0545FCS	5 mm	45 cm	Z przednim manipulatorem	5/pudełko
N3810430	THUNDERBEAT	TB-0535PC	5 mm	35 cm	Pistoletowy	5/pudełko
Urządzenia THUNDERBEAT do zabiegów otwartych						
N5423930	THUNDERBEAT Type S	TB-0520FCS	5 mm	20 cm	Z przednim manipulatorem	5/pudełko
N3810730	THUNDERBEAT	TB-0520IC	5 mm	20 cm	Nożycowy	5/pudełko
N3810830	THUNDERBEAT	TB-0510IC	5 mm	10 cm	Nożycowy	5/pudełko
N4505530	THUNDERBEAT Open Extended Jaw	TB-0920OE	9,7 mm	20 cm	Z przednim manipulatorem	5/pudełko
N4505730	THUNDERBEAT Open Fine Jaw	TB-0009OF		9 cm	Typ „nożyczki”	5/pudełko
Generatory i akcesoria						
WB91051W	Generator elektrochirurgiczny ESG-400	ESG-400				
N5428060	Generator ultradźwiękowy USG-400	USG-400				
N3808760	Przetwornik urządzenia THUNDERBEAT	TD-TB400				
026441	Szczotka do czyszczenia przetwornika	MH-507				
N3809330	Przewód komunikacyjny – krótki, 0,25 m					
N3809630	Uchwyt dokujący					
WA956215	Przewód zasilający z wtyczką typu europejskiego (2x)					
WA95623A	Przewód zasilający z wtyczką UK, 4,5 m (1x)					
WA95621A	Przewód zasilający z wtyczką EU, 4,5 m (1x)					
A90223A	Adapter do czyszczenia na haczyki					
N2366530	Adapter do czyszczenia nożyczek					
N2301000	Szczotka do czyszczenia powierzchni (wszystkie urządzenia)					
Wyposażenie opcjonalne						
N3635730	Wózek z zasilaniem, TC-E400					
N3809230	Włącznik nożny narzędzia THUNDERBEAT					
WB50403W	Włącznik nożny, pojedynczy pedał (dwupołożeniowy)					
N3809430	Przewód komunikacyjny – długi, 10 m					
N3809530	Adapter do podłączania insuflatora UHI-3 lub UHI-4					
WA99510A	Kabel elektrody pacjenta (wielokrotnego użytku) do ręcznej i automatycznej dekontaminacji lub sterylizacji w autoklawie, 4,5 m (1x)					

Dane techniczne, wygląd, konstrukcja i akcesoria mogą ulec zmianie bez powiadomienia, a zamieszczone informacje na ich temat nie stanowią zobowiązania ze strony producenta.



Narzędzie THUNDERBEAT z przedłużonymi szczękami do zabiegów otwartych

TB-0920OE




USA: PRZESTROGA:
Prawo federalne dopuszcza sprzedaż tego urządzenia wyłącznie przez lekarza lub na zlecenie lekarza.

1 Etykiety i symbole

Etykiety i symbole dotyczące bezpieczeństwa są umieszczone na narzędziu w miejscach wskazanych poniżej. W razie braku etykiet lub symboli, lub gdy są one nieczytelne, prosimy o kontakt z firmą Olympus.

○ Narzędzie THUNDERBEAT (przedłużone szczęki do zabiegów otwartych)

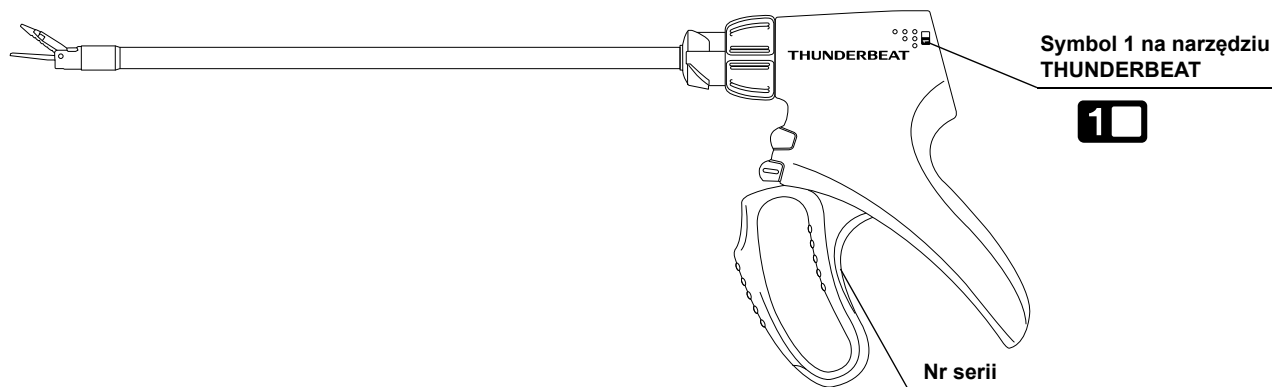


2 Symbole i opisy


Symbol	Opis	Symbol	Opis	Symbol	Opis
	Postępować według instrukcji obsługi		Należy użyć do (data ważności)		Sterylizowane tlenkiem etylenu
	Wyłącznie do jednorazowego użytku		Nr serii		Numer serii sterylizacji
	Nie poddawać ponownej sterylizacji		Nie przechowywać w nasłonecznionym miejscu		Upoważniony przedstawiciel na terenie Unii Europejskiej
	Nie używać, jeśli opakowanie jest uszkodzone		Przechowywać w suchym miejscu		Importer (na teren Unii Europejskiej)
	Produkt niewykonany z lateksu kuczuku naturalnego		Manufacturer		Zakres temperatur

13 Nazewnictwo

Zadanie 66, poz. 2


○ Narzędzie THUNDERBEAT

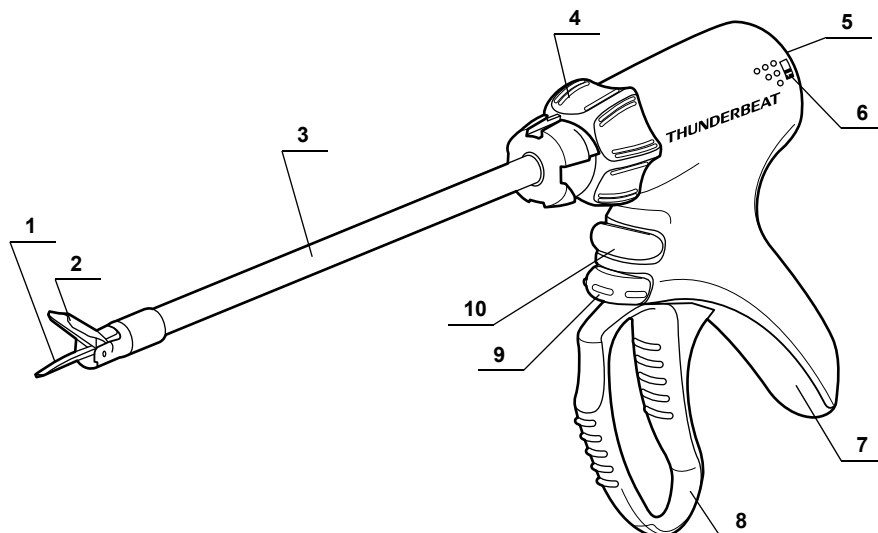

Nazewnictwo	Opis
1) Końcówka sondy	Podczas emisji prądu roboczego występuje drganie ultradźwiękowe i/lub następuje aktywacja bipolarnego prądu roboczego.
2) Końcówka chwytająca (szczęki)	Podczas emisji prądu roboczego następuje aktywacja bipolarnego prądu roboczego.
3) Trzonek	Ta część jest wprowadzana do jamy brzusznej.
4) Pokrętko	Służy do obracania sondy.
5) Złącze przetwornika	Ten element jest połączony z przetwornikiem.
6) Symbol  na narzędziu THUNDERBEAT	Oznacza, że jest to narzędzie THUNDERBEAT.
7) Uchwyt	Operator chwytą lub porusza tym elementem podczas zabiegu.
8) Uchwyt sterujący	Otwieranie uchwytu sterującego powoduje otwieranie końcówki chwytającej. Zamykanie uchwytu sterującego powoduje zamykanie końcówki chwytającej.
9) Przycisk SEAL (Zamykanie): niebieski (przełącznik ręczny) (z wystającą częścią)	Nacisnąć przycisk SEAL (Zamykanie), aby dostarczyć energię bipolarną prądu roboczego o wysokiej częstotliwości w celu koagulacji tkanek lub zamknięcia naczyń. Ten przycisk można uruchomić, naciskając go od przodu lub z boku.
10) Przycisk SEAL & CUT (Zamykanie i cięcie): fioletowy (przełącznik ręczny) (bez wystającej części)	Nacisnąć przycisk SEAL & CUT (Zamykanie i cięcie), aby wytworzyć połączoną energię ultradźwiękową i bipolarną prądu roboczego o wysokiej częstotliwości w celu równoczesnego zamykania i cięcia tkanek. Ten przycisk można uruchomić, naciskając go od przodu lub z boku.

○ Końcówka dystalna sondy z bliska

Zadanie 66, poz. 2

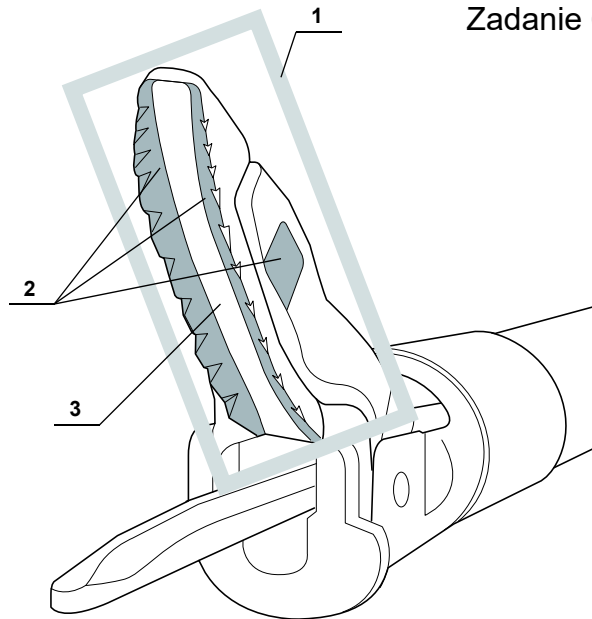


Nazewnictwo	Opis
1) Końcówka chwytająca	Pokryta materiałem izolacyjnym za wyjątkiem szarego obszaru.
2) Obszar bez izolacji	—
3) Podkładka PTFE	—

○ Klucz dynamometryczny (dostarczony)

Służy do podłączania przetwornika (dostępnego oddzielnie) do narzędzia THUNDERBEAT.

NOTA

Klucz dynamometryczny jest również dostępny oddzielnie (Zestaw klucz dynamometryczny/stabilizator MAJ-1983).

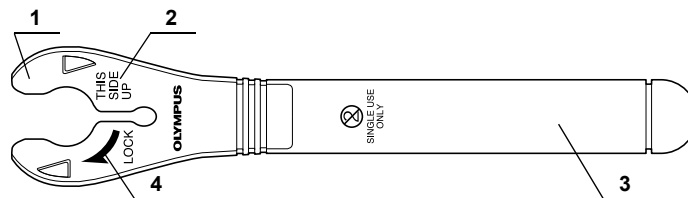

Nazewnictwo	Opis
1) Głowica	Szczelina do nakładania klucza dynamometrycznego na narzędzie THUNDERBEAT.
2) Wskaźnik montażowy	TĄ STRONĄ DO GÓRY.
3) Rękojeść	Operator chwyta ten element podczas zabiegu.
4) Wskaźnik montażowy	Kierunek mocowania.


○ Stabilizator (dostarczony)

Zadanie 66, poz. 2

Służy do podłączania przetwornika (dostępnego oddzielnie) do narzędzia THUNDERBEAT.


NOTA


Stabilizator jest również dostępny oddzielnie (Zestaw klucz dynamometryczny/stabilizator MAJ-1983).

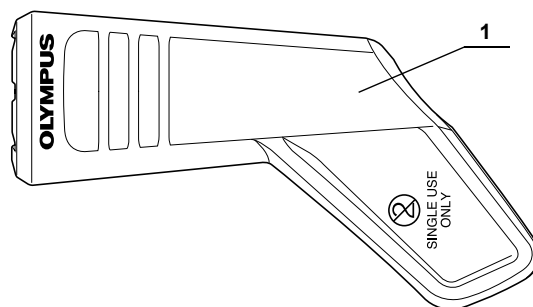

Nazewnictwo	Opis
1) Rękojeść	Operator chwyta ten element podczas zabiegu.

○ Przetwornik THUNDERBEAT (dostępny oddzielnie)

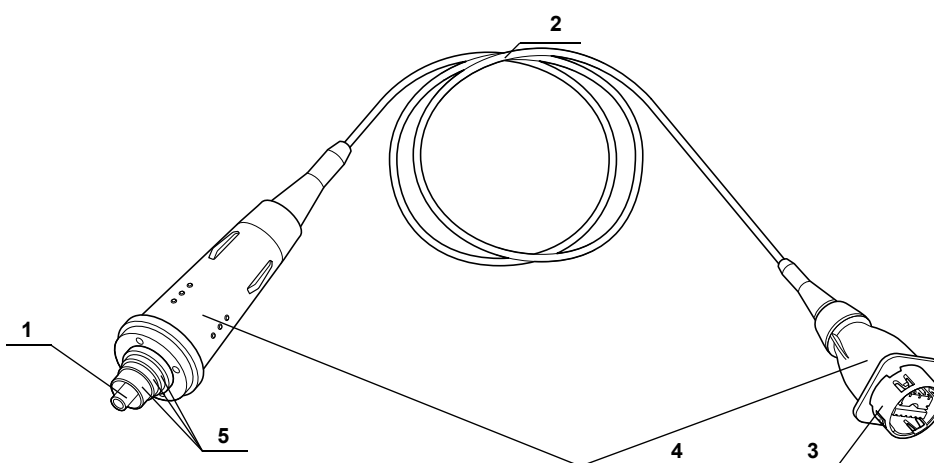

Nazewnictwo	Opis
1) Złącze narzędzia THUNDERBEAT	Służy do podłączenia do narzędzia.
2) Przewód przetwornika	Sygnal elektryczny jest wysyłany z generatora ultradźwiękowego do narzędzia.
3) Wtyk przetwornika	Podłączany do gniazda THUNDERBEAT na generatorze ultradźwiękowym.
4) Symbol  na narzędziu THUNDERBEAT	Oznacza, że jest to przetwornik THUNDERBEAT.
5) Styki przełącznika	Styki przełącznika przewodzą sygnał z przełącznika ręcznego.

14 Parametry techniczne

■ Warunki transportu i przechowywania oraz warunki robocze

Środowisko robocze	Temperatura otoczenia	10–40°C (50–104°F)
	Wilgotność względna	30–85%
	Ciśnienie atmosferyczne	70–106 KPa
	Wysokość	3000 M lub mniej
Standardowe warunki przechowywania (np. w środowisku szpitalnym)	Temperatura otoczenia	5–35°C (41–95°F)
	Wilgotność względna	45–85%
	Ciśnienie atmosferyczne	86–106 KPa
Transport i warunki przechowywania	Temperatura otoczenia	od –40 do +60°C (od –40 do +140°F)
	Wilgotność względna	10–90%
	Ciśnienie atmosferyczne	70–106 KPa



■ Parametry techniczne

Zadanie 66, poz. 2

Model		TB-09200E
Częstotliwość		47 kHz
Amplituda		80 µm
Wymiary	Średnica zewnętrzna sondy	ø 9,7 mm
	Długość efektywna	200 mm
Znamionowe napięcie bipolarnego prądu roboczego o wysokiej częstotliwości		229 Vp
Ustawienie poziomu (tryb SEAL & CUT (Zamykanie i cięcie))		Prąd wyjściowy energii ultradźwiękowej i energii bipolarnego prądu roboczego o wysokiej częstotliwości (czas między aktywacją energii prądu o wysokiej częstotliwości a energii ultradźwiękowej) – Poziom 1: 0 s – Poziom 2: 0,5 s – Poziom 3: 1 s
Ustawienie poziomu (tryb SEAL (Zamykanie))		Prąd wyjściowy energii ultradźwiękowej i energii bipolarnego prądu roboczego o wysokiej częstotliwości (minimalny czas aktywacji) – Poziom 1: 3 s – Poziom 2: 4 s – Poziom 3: 5 s

NOTA

Ten produkt jest przeznaczony do stosowania w cyklu pracy (WŁ.: 5 s / WYŁ.: 10 s).

Dyrektywa dotycząca wyrobów medycznych		 0197 Urządzenie jest zgodne z wymogami dyrektywy 93/42/EWG dotyczącej wyrobów medycznych. Klasyfikacja: Klasa II b
Dyrektywa RoHS		 Niniejsze urządzenie spełnia wymagania dyrektywy 2011/65/UE oraz (UE) 2015/863 w sprawie sprzętu elektrycznego i elektronicznego.
EMC	Zastosowana norma	IEC 60601-1-2: 2001 IEC 60601-1-2: 2007 IEC 60601-1-2: 2014 IEC 60601-2-2: 2006 IEC 60601-2-2: 2009 <ul style="list-style-type: none"> • Urządzenie to jest zgodne z wymogami normy dotyczącej zgodności elektromagnetycznej elektrycznych urządzeń medycznych, wydanie 4 (IEC 60601-1-2:2014). Jeśli urządzenie zostanie podłączone do urządzenia spełniającego wymogi poprzedniego wydania normy dotyczącej zgodności elektromagnetycznej elektrycznego sprzętu medycznego, wówczas zachowanie deklarowanych parametrów zgodności elektromagnetycznej może być zagrożone. • Emisja zgodnie z CISPR 11: Grupa 1, klasa A
Rok produkcji	Oznaczenie	Pierwsza cyfra numeru partii jest równoznaczna z ostatnią cyfrą roku produkcji. W tym przykładzie rok to 2010. Np. 01K. (nr serii)
Urządzenie jest zgodne z wymogami dyrektywy 93/42/EWG dotyczącej wyrobów medycznych.		Klasyfikacja: Część aplikacyjna typu CF narzędzia elektromedycznego. Ochrona przed porażeniem prądem elektrycznym wywołanym tym narzędziem zależy od używanego sprzętu elektromedycznego. Należy odnieść się do instrukcji obsługi dołączonej do konkretnego urządzenia.

Zadanie 66, poz. 3-4

Narzędzie THUNDERBEAT 5 mm, 45 cm, uchwyt z manipulatorem przednim typu S

TB-0545FCS

Narzędzie THUNDERBEAT 5 mm, 35 cm, uchwyt z manipulatorem przednim typu S

TB-0535FCS

Narzędzie THUNDERBEAT 5 mm, 20 cm, uchwyt z manipulatorem przednim typu S

TB-0520FCS




Nr artykułu: PL-8004248

1 Etykiety i symbole

Etykiety i symbole dotyczące bezpieczeństwa są umieszczone na narzędziu w miejscach wskazanych poniżej. W razie braku etykiet lub symboli, lub gdy są one nieczytelne, prosimy o kontakt z firmą Olympus.

○ Narzędzie THUNDERBEAT (uchwyt z manipulatorem przednim typu S)

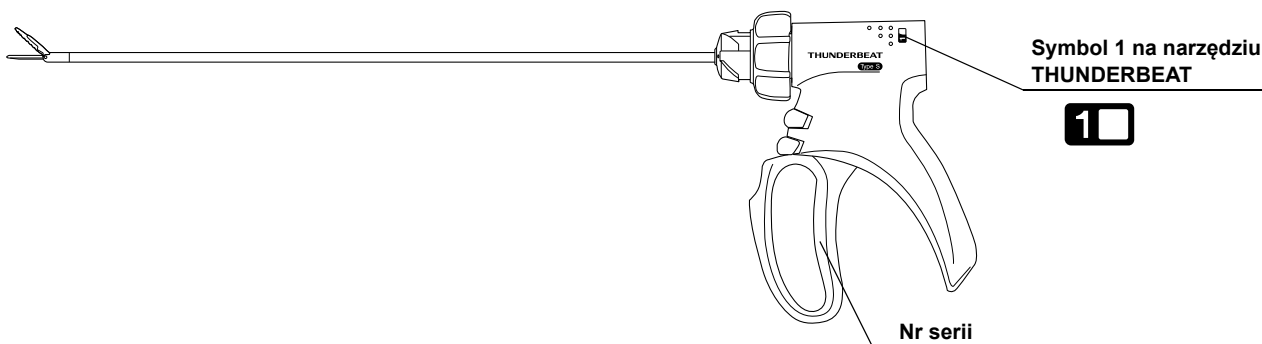


2 Symbole i opisy


Symbol	Opis	Symbol	Opis	Symbol	Opis
	Postępować według instrukcji obsługi		Należy użyć do (data ważności)		Sterylizowane tlenkiem etylenu
	Wyłącznie do jednorazowego użytku		Nr serii		Numer serii sterylizacji
	Nie poddawać ponownej sterylizacji		Nie przechowywać w nasłonecznionym miejscu		Upoważniony przedstawiciel na terenie Unii Europejskiej
	Nie używać, jeśli opakowanie jest uszkodzone		Przechowywać w suchym miejscu		Importer (na teren Unii Europejskiej)
	Produkt niewykonany z lateksu kuczuku naturalnego		Producent		Zakres temperatur

13 Nazewnictwo

Zadanie 66, poz. 3-4


○ Narzędzie THUNDERBEAT (uchwyt z manipulatorem przednim typu S)

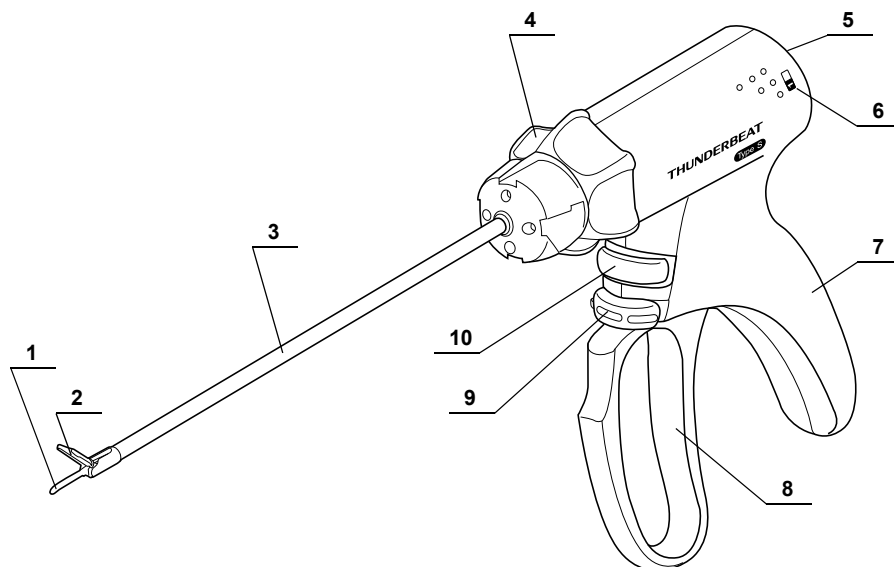

Nazewnictwo	Opis
1) Końcówka sondy	Podczas emisji prądu roboczego występuje drganie ultradźwiękowe i/lub następuje aktywacja bipolarnego prądu roboczego.
2) Końcówka chwytająca (szczęki)	Podczas emisji prądu roboczego następuje aktywacja bipolarnego prądu roboczego.
3) Trzonek	Ta część jest wprowadzana do jamy brzusznej. Sonda z osłoną izolacyjną.
4) Pokrętko	Służy do obracania sondy.
5) Złącze przetwornika	Ten element jest połączony z przetwornikiem.
6) Symbol  na narzędziu THUNDERBEAT	Oznacza, że jest to narzędzie THUNDERBEAT.
7) Uchwyt	Operator chwytą ten element podczas obsługi narzędzia.
8) Uchwyt sterujący	Otwieranie uchwytu sterującego powoduje otwieranie końcówki chwytającej. Zamykanie uchwytu sterującego powoduje zamykanie końcówki chwytającej.
9) Przycisk SEAL (Zamykanie): niebieski (przełącznik ręczny) (z wystającą częścią)	Nacisnąć przycisk SEAL (Zamykanie), aby dostarczyć energię bipolarną prądu roboczego o wysokiej częstotliwości w celu koagulacji tkanek lub zamknięcia naczyń. Ten przycisk można uruchomić, naciskając go od przodu lub z boku.
10) Przycisk SEAL & CUT (Zamykanie i cięcie): fioletowy (przełącznik ręczny) (bez wystającej części)	Nacisnąć przycisk SEAL & CUT (Zamykanie i cięcie), aby wytworzyć połączoną energię ultradźwiękową i bipolarną prądu roboczego o wysokiej częstotliwości w celu równoczesnego zamykania i cięcia tkanek. Ten przycisk można uruchomić, naciskając go od przodu lub z boku.

○ Końcówka dystalna sondy z bliska


Zadanie 66, poz. 3-4

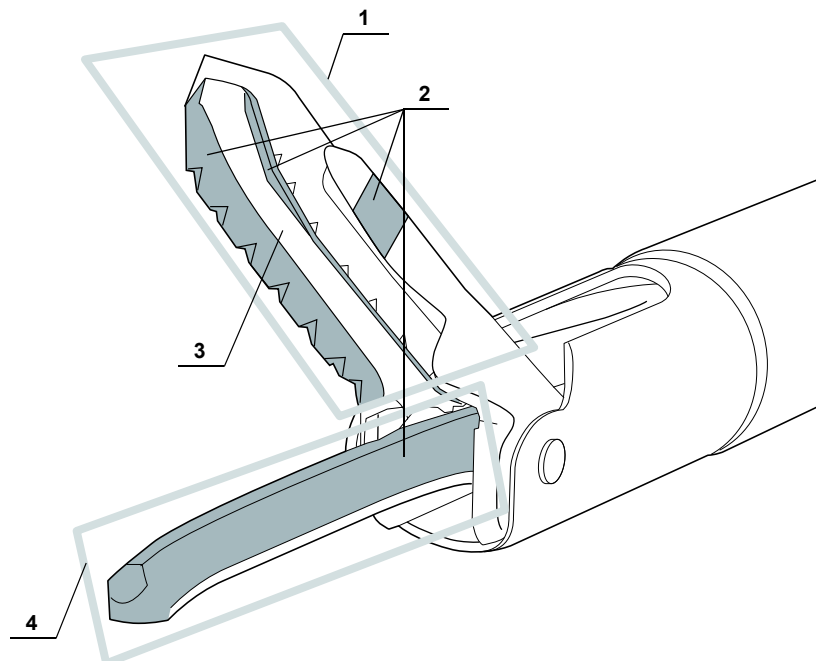

Nazewnictwo	Opis
1) Końcówka chwytająca	Pokryta materiałem izolacyjnym za wyjątkiem szarego obszaru.
2) Obszar bez izolacji	—
3) Podkładka PTFE	—
4) Końcówka sondy	Pokryta materiałem izolacyjnym za wyjątkiem szarego obszaru.

○ Klucz dynamometryczny (dostarczony)


Służy do podłączania przetwornika (dostępnego oddzielnie) do narzędzia THUNDERBEAT.

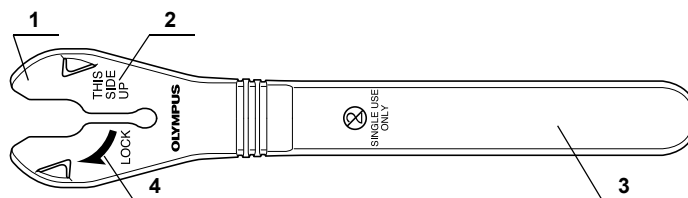

Nazewnictwo	Opis
1) Głowica	Szczelina do nakładania klucza dynamometrycznego na narzędzie THUNDERBEAT.
2) Wskaźnik montażowy	TAJ STRONĄ DO GÓRY.
3) Rękojeść	Operator chwyta ten element podczas zabiegu.
4) Wskaźnik montażowy	Kierunek mocowania.

○ Klucz dynamometryczny (Zestaw klucz dynamometryczny/stabilizator MAJ-1983, dostępny oddzielnie)

Służy do podłączania przetwornika (dostępnego oddzielnie) do narzędzia THUNDERBEAT.

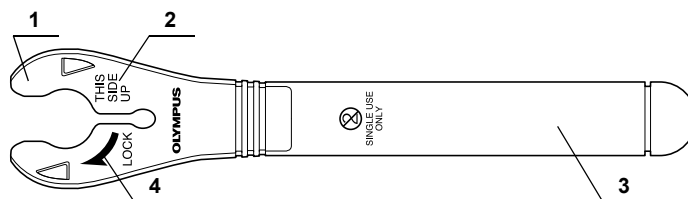


Nazewnictwo	Opis
1) Głowica	Szczelina do nakładania klucza dynamometrycznego na narzędzie THUNDERBEAT.
2) Wskaźnik montażowy	TAJ STRONĄ DO GÓRY.
3) Rękojeść	Operator chwyta ten element podczas zabiegu.
4) Wskaźnik montażowy	Kierunek mocowania.

○ Stabilizator (dostarczony)

Służy do podłączania przetwornika (dostępnego oddzielnie) do narzędzia THUNDERBEAT.


NOTA


Stabilizator jest również dostępny oddzielnie (Zestaw klucz dynamometryczny/stabilizator MAJ-1983).

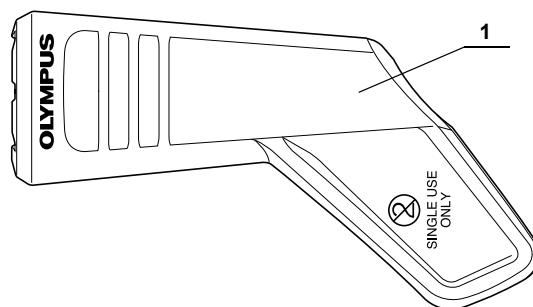

Nazewnictwo	Opis
1) Rękojeść	Operator chwyta ten element podczas zabiegu.

○ Przetwornik THUNDERBEAT (dostępny oddzielnie)

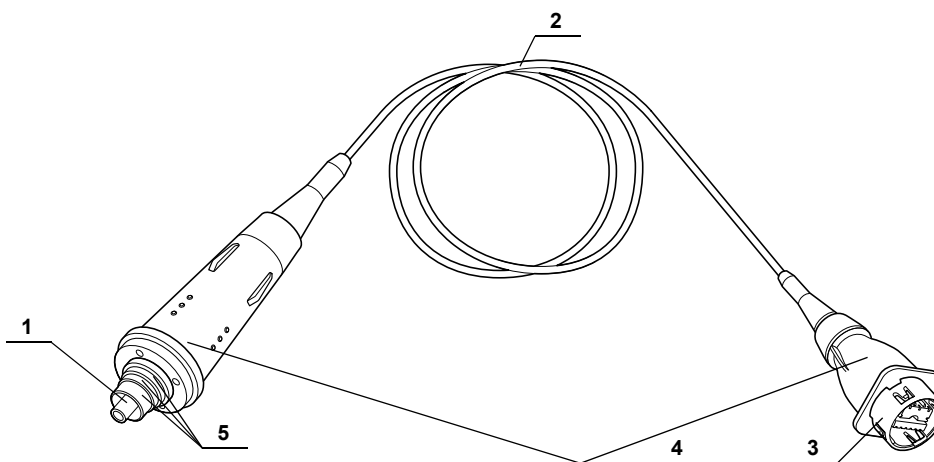

Nazewnictwo	Opis
1) Złącze narzędzia THUNDERBEAT	Służy do podłączenia do narzędzia.
2) Przewód przetwornika	Sygnal elektryczny jest wysyłany z generatora ultradźwiękowego do narzędzia.
3) Wtyk przetwornika	Podłączany do gniazda THUNDERBEAT na generatorze ultradźwiękowym.
4) Symbol  na narzędziu THUNDERBEAT	Oznacza, że jest to przetwornik THUNDERBEAT.
5) Styki przełącznika	Styki przełącznika przewodzą sygnał z przełącznika ręcznego.

14 Parametry techniczne

■ Warunki transportu i przechowywania oraz warunki robocze



Środowisko robocze	Temperatura otoczenia	10 – 40°C (50 – 104°F)
	Wilgotność względna	30 – 85%
	Ciśnienie atmosferyczne	70 – 106 KPa
	Wysokość	3000 M lub mniej
Standardowe warunki przechowywania (np. w środowisku szpitalnym)	Temperatura otoczenia	5 – 40°C (41 – 104°F)
	Wilgotność względna	10 – 90%
	Ciśnienie atmosferyczne	70 – 106 KPa
Warunki transportu (parametry transportu i krótkoterminowego przechowywania)	Temperatura otoczenia	od –40 do +60°C (od –40 do +140°F)
	Wilgotność względna	10 – 90%
	Ciśnienie atmosferyczne	70 – 106 KPa

■ Parametry techniczne

Model	Uchwyt z manipulatorem przednim typu S	TB-0520FCS	TB-0535FCS	TB-0545FCS
Częstotliwość		47 KHz		
Amplituda		80 μ m		
Wymiary	Średnica zewnętrzna sondy	ø 5,5 mm		
	Długość efektywna	200 mm	350 mm	450 mm
Znamionowe napięcie bipolarnego prądu roboczego o wysokiej częstotliwości		229 Vp		
Ustawienie poziomu (tryb SEAL & CUT (Zamykanie i cięcie))		Prąd wyjściowy energii ultradźwiękowej i energii prądu roboczego o wysokiej częstotliwości (RF bipolarna) (czas między aktywacją energii prądu o wysokiej częstotliwości a energii ultradźwiękowej) – Poziom 1: 0 s – Poziom 2: 0,5 s – Poziom 3: 1 s		
Ustawienie poziomu (tryb SEAL (Zamykanie))		Prąd wyjściowy energii o wysokiej częstotliwości (RF bipolarna) (minimalny czas aktywacji) – Poziom 1: 3 s – Poziom 2: 4 s – Poziom 3: 5 s		

NOTA


Ten produkt jest przeznaczony do stosowania w cyklu pracy (WŁ.: 5 s / WYŁ.: 10 s).

Dyrektywa dotycząca wyrobów medycznych		 0197 Urządzenie jest zgodne z wymogami dyrektywy 93/42/EWG dotyczącej wyrobów medycznych. Klasyfikacja: Klasa II b
Dyrektywa RoHS		 Niniejsze urządzenie spełnia wymagania dyrektywy 2011/65/UE oraz (UE) 2015/863 w sprawie sprzętu elektrycznego i elektronicznego.
Zgodność elektromagnetyczna	Zastosowana norma	IEC 60601-1-2: 2001 IEC 60601-1-2: 2007 IEC 60601-1-2: 2014 IEC 60601-2-2: 2006 IEC 60601-2-2: 2009 IEC 60601-2-18: 1996 IEC 60601-2-18: 2009 <ul style="list-style-type: none"> Urządzenie to jest zgodne z wymogami normy dotyczącej zgodności elektromagnetycznej elektrycznych urządzeń medycznych, wydanie 4 (IEC 60601-1-2:2014). Jeśli urządzenie zostanie podłączone do urządzenia spełniającego wymogi poprzedniego wydania normy dotyczącej zgodności elektromagnetycznej elektrycznego sprzętu medycznego, wówczas zachowanie deklarowanych parametrów zgodności elektromagnetycznej może być zagrożone. Emisja zgodnie z CISPR 11: Grupa 1, klasa A (tryb oczekiwania)
Rok produkcji	Oznaczenie	Pierwsza cyfra numeru partii jest równoznaczna z ostatnią cyfrą roku produkcji. W tym przykładzie rok to 2010. Np. 01K (numer partii)
Urządzenie jest zgodne z wymogami dyrektywy 93/42/EWG dotyczącej wyrobów medycznych.		Klasyfikacja: Część aplikacyjna typu CF narzędzia elektromedycznego. Ochrona przed porażeniem prądem elektrycznym wywołanym tym narzędziem zależy od używanego sprzętu elektromedycznego. Należy odnieść się do instrukcji obsługi dołączonej do konkretnego urządzenia.

INSTRUKCJE

Narzędzie THUNDERBEAT Open Fine Jaw

TB-0009OF

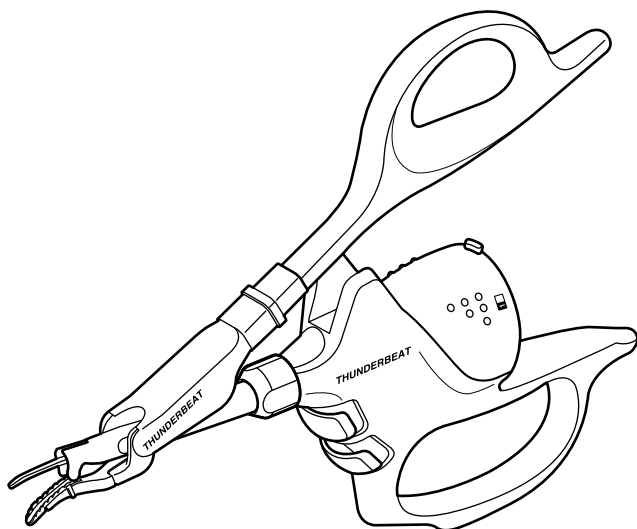

Numer artykułu: PL-8004019
Wersja 5.0 – 12/2018


Etykiety i symbole	1
Ważne informacje – przeczytać przed rozpoczęciem stosowania	2
Rozdział 1 Sprawdzenie zawartości opakowania	7
Rozdział 2 Nazewnictwo i parametry techniczne narzędzia	9
Rozdział 3 Przygotowanie i kontrola	19
Rozdział 4 Obsługa	37
Rozdział 5 Przechowywanie i utylizacja	53
Rozdział 6 Rozwiązywanie problemów	55
Dodatek	57

USA: UWAGA: Przepisy federalne (w Stanach Zjednoczonych) określają, że to urządzenie może być sprzedawane tylko przez lekarza lub na jego zlecenie.




2.2 Nazewnictwo


○ Narzędzie THUNDERBEAT

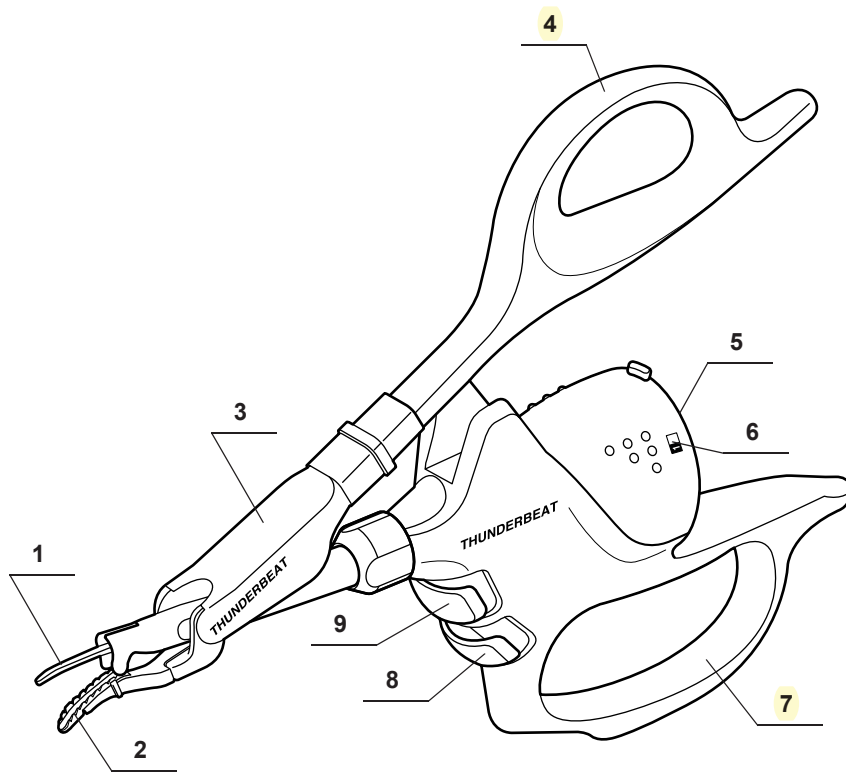

Rozdz. 2

Nr	Nazewnictwo	Opis
1	Końcówka sondy	Podczas emisji prądu roboczego występuje drganie ultradźwiękowe lub następuje aktywacja bipolarnego prądu roboczego.
2	Końcówka chwytająca (szczęki)	Podczas emisji prądu roboczego następuje aktywacja bipolarnego prądu roboczego.
3	Ramię robocze	Część wprowadzana z osłoną izolacyjną.
4	Uchwyt sterujący	Otwieranie i zamykanie uchwytu sterującego powoduje otwieranie i zamykanie końcówki chwytającej.
5	Złącze przetwornika	Służy do podłączania przetwornika THUNDERBEAT.
6	Symbol  na narzędziu THUNDERBEAT	Oznacza, że jest to narzędzie THUNDERBEAT.
7	Uchwyt	Operator chwytą lub porusza tym elementem podczas zabiegu.
8	Przycisk SEAL (Zamykanie): niebieski (przełącznik ręczny)	Nacisnąć przycisk SEAL (Zamykanie), aby dostarczyć energię bipolarną prądu roboczego o wysokiej częstotliwości w celu koagulacji tkanek lub zamknięcia naczyń.
9	Przycisk SEAL & CUT (Zamykanie i cięcie): fioletowy (przełącznik ręczny)	Nacisnąć przycisk SEAL & CUT (Zamykanie i cięcie), aby wytworzyć połączoną energię ultradźwiękową i bipolarną prądu roboczego o wysokiej częstotliwości w celu równoczesnej koagulacji i cięcia tkanek lub cięcia i zamykania naczyń krwionośnych.


○ Część dystalna części wprowadzanej z bliska

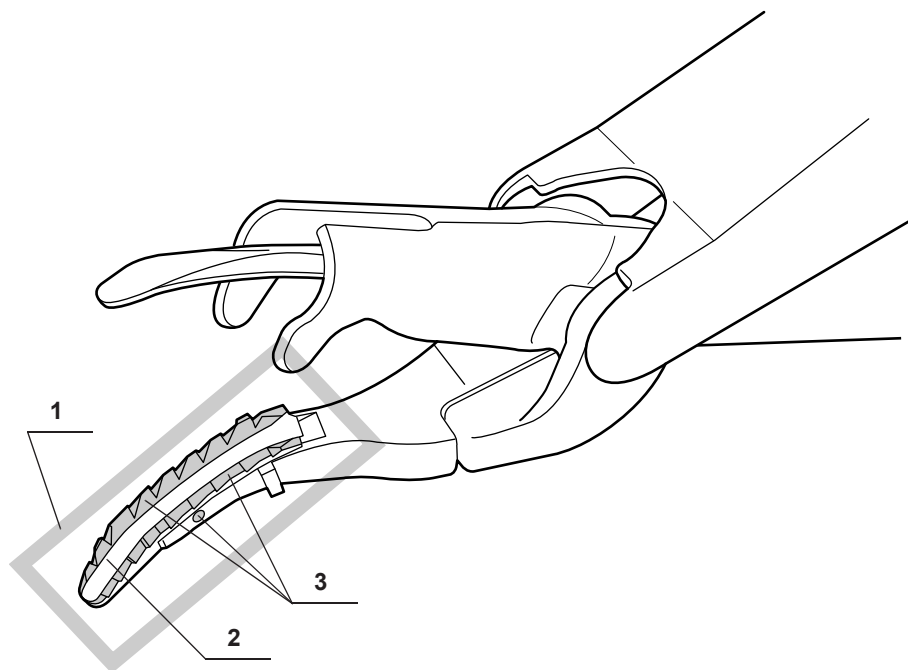

Nr	Nazewnictwo	Opis
1	Końcówka chwytająca	Pokryta materiałem izolacyjnym za wyjątkiem szarego obszaru.
2	Podkładka PTFE	–
3	Obszar bez izolacji	–

○ Klucz dynamometryczny (dostarczony)

Służy do podłączania przetwornika (dostępnego oddzielnie) do narzędzia THUNDERBEAT.

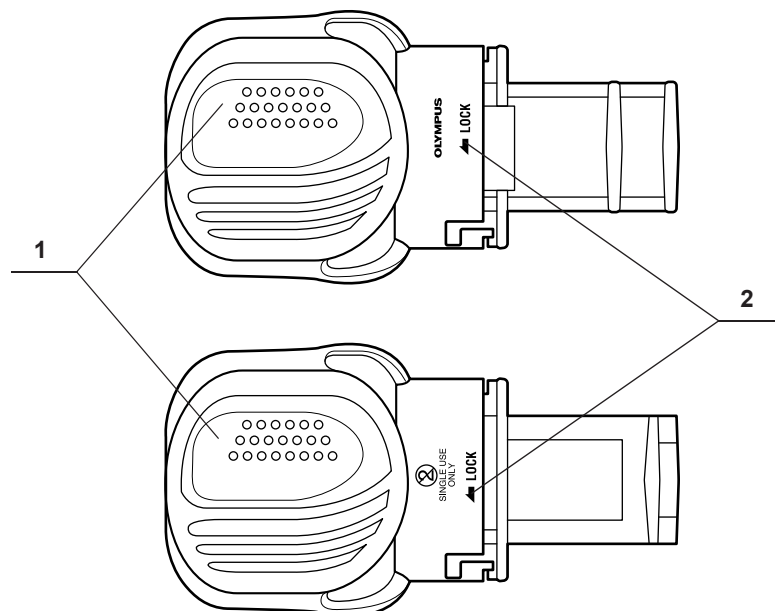


Rozdz. 2

Nr	Nazewnictwo	Opis
1	Rękojeść	Operator chwytą ten element podczas zabiegu.
2	Wskaźnik montażowy	Kierunek mocowania.


○ Stabilizator (dostarczony)

Służy do podłączania przetwornika (dostępnego oddzielnie) do narzędzia THUNDERBEAT.

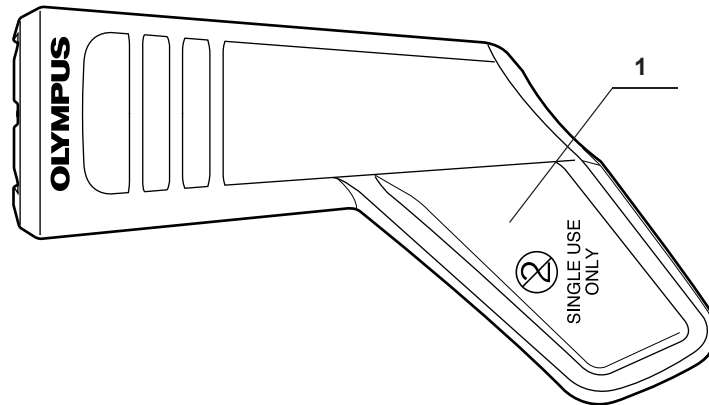


Nr	Nazewnictwo	Opis
1	Rękojeść	Operator chwyta ten element podczas zabiegu.

○ Przetwornik THUNDERBEAT TD-TB400 (dostępny oddzielnie)

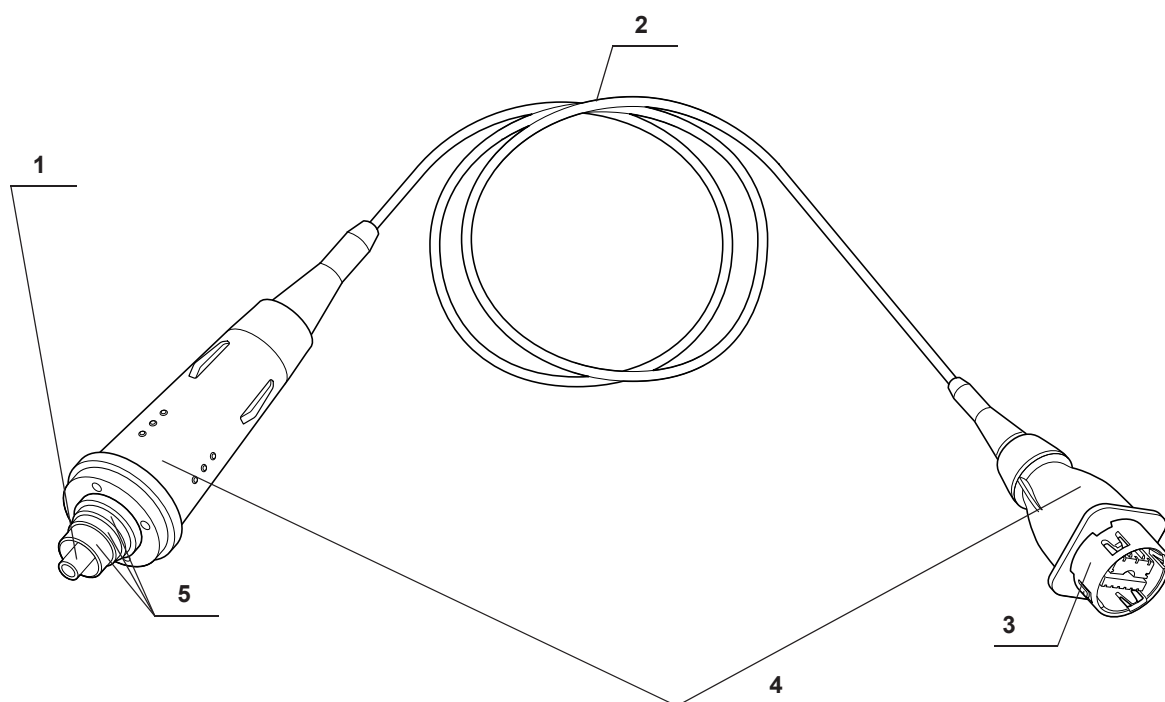

Rozdz. 2

Nr	Nazewnictwo	Opis
1	Złącze narzędzia THUNDERBEAT	Służy do podłączenia do narzędzia.
2	Przewód przetwornika	Sygnal elektryczny jest wysyłany z generatora ultradźwiękowego do narzędzia.
3	Wtyk przetwornika	Podłączany do gniazda THUNDERBEAT na generatorze ultradźwiękowym.
4	Symbol  na narzędziu THUNDERBEAT	Oznacza, że jest to przetwornik THUNDERBEAT.
5	Styki przełącznika	Styki przełącznika przewodzą sygnał z przełącznika ręcznego.


2.3 Dane techniczne

■ Warunki transportu i przechowywania oraz warunki robocze

Środowisko robocze	Temperatura otoczenia	10–40°C (50–104°F)
	Wilgotność względna	30–85%
	Ciśnienie atmosferyczne	70–106 KPa
	Wysokość	3000 M lub mniej
Transport i warunki przechowywania	Temperatura otoczenia	–40 do +60°C (–40 do +140°F)
	Wilgotność względna	10–90%
	Ciśnienie atmosferyczne	70–106 KPa

■ Dane techniczne

Model		TB-0009OF
Częstotliwość		47 KHz
Amplituda		64 μ m
Wymiary	Długość efektywna	90 mm
Znamionowe napięcie prądu roboczego o wysokiej częstotliwości		229 Vp
Cykl pracy (wartość referencyjna)		Wł.: 5 s / Wył.: 10 s
Ustawienie poziomu (tryb SEAL & CUT (Zamykanie i cięcie))		<p>Prąd wyjściowy energii ultradźwiękowej i energii bipolarnego prądu roboczego o wysokiej częstotliwości (czas między aktywacją energii prądu o wysokiej częstotliwości a energii ultradźwiękowej)</p> <ul style="list-style-type: none"> – Poziom 1: 0 s – Poziom 2: 0,5 s – Poziom 3: 1 s
Ustawienie poziomu (tryb SEAL (Zamykanie))		<p>Prąd wyjściowy energii bipolarnego prądu roboczego o wysokiej częstotliwości (Minimalny czas aktywacji)</p> <ul style="list-style-type: none"> – Poziom 1: 3 s – Poziom 2: 4 s – Poziom 3: 5 s

Dyrektywa dotycząca wyrobów medycznych		 Wyrób ten jest zgodny z wymogami dyrektywy 93/42/EWG dotyczącej wyrobów medycznych. Klasyfikacja: Klasa II b
Zgodność elektromagnetyczna	Zastosowana norma	IEC 60601-1-2: 2001 IEC 60601-1-2: 2007 IEC 60601-1-2: 2014 IEC 60601-2-2: 2006 IEC 60601-2-2: 2009 <ul style="list-style-type: none"> Urządzenie to jest zgodne z wymogami normy dotyczącej zgodności elektromagnetycznej medycznych urządzeń elektrycznych, wydanie 4 (IEC 60601-1-2:2014). Jeśli urządzenie zostanie podłączone do urządzenia spełniającego wymogi poprzedniego wydania normy dotyczącej zgodności elektromagnetycznej dla elektrycznych urządzeń medycznych, wówczas utrzymanie zgodności z tą normą może być zagrożone. Emisja zgodnie z CISPR 11: Grupa 1, klasa A (tryb oczekiwania)
Rok produkcji	Wskaźnik	Druga cyfra numeru partii jest równoznaczna z ostatnią cyfrą roku produkcji. W tym przykładzie rok to 2010. Np. 01K (numer partii)
Wyrób ten jest zgodny z wymogami dyrektywy 93/42/EWG dotyczącej wyrobów medycznych.		Klasyfikacja: Część aplikacyjna typu CF narzędzia elektromedycznego. Ochrona przed porażeniem prądem wywołanym tym narzędziem zależy od używanego sprzętu elektromedycznego. Należy odnieść się do instrukcji obsługi dołączonej do konkretnego urządzenia.

Wydruk informacji pobranej w trybie art. 4 ust. 4aa ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym, posiada moc dokumentu wydawanego przez Centralną Informację, nie wymaga podpisu i pieczęci.

CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY

Stan na dzień 08.06.2022 godz. 11:48:15

Numer KRS: 0000063126**Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu
Z REJESTRU PRZEDSIĘBIORCÓW**

Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym		30.11.2001		
Ostatni wpis	Numer wpisu	61	Data dokonania wpisu	06.04.2022
	Sygnatura akt	WA.XIII NS-REJ.KRS/16413/22/369		
	Oznaczenie sądu	SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO		

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu	
1.Oznaczenie formy prawnej	SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2.Numer REGON/NIP	REGON: 012330343, NIP: 5221651738
3.Firma, pod którą spółka działa	OLYMPUS POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
4.Dane o wcześniejszej rejestracji	RHB 49362 SĄD REJONOWY DLA M. ST. WARSZAWY XVI WYDZIAŁ GOSPODARCZY-REJESTROWY
5.Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?	NIE
6.Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?	---

Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu	
1.Siedziba	kraj POLSKA, woj. MAZOWIECKIE, powiat WARSZAWA, gmina WARSZAWA, miejsc. WARSZAWA
2.Adres	ul. WYNALAZEK, nr 1, lok. ---, miejsc. WARSZAWA, kod 02-677, poczta WARSZAWA, kraj POLSKA
3.Adres poczty elektronicznej	-----
4.Adres strony internetowej	WWW.OLYMPUS.PL

Rubryka 3 - Oddziały	
Brak wpisów	

Rubryka 4 - Informacje o umowie		
1.Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki	1	AKT NOTARIALNY Z DNIA 23 GRUDNIA 1996 ROKU, KANCELARIA NOTARIALNA DANUTA KOSIM-KRUSZEWSKA, WARSZAWA REPETYTORIUM A-9692/96
	2	29.12.2003R., REPERTORIUM A NR 8615/2003, KANCELARIA NOTARIALNA S.C. MARIA BOŁDOK - NOTARIUSZ, WIKTOR BOŁDOK - NOTARIUSZ, AGNIESZKA MROCZKOWSKA - GOŁOWICZ -

	NOTARIUSZ 00-544 WARSZAWA, UL WILCZA NR 28 LOK. 1, NUMERY ZMIENIONYCH PARAGRAFÓW: §2, §8 USTĘP 2, §13 USTĘP 5, §15, §16 USTĘP 2, §18.
3	DATA: 24.03.2005 ROK, NR REPERTORIUM: 1138/2005, NOTARIUSZ: AGNIESZKA MROCKOWSKA-GOŁOWICZ KANCELARIA NOTARIALNA S.C., UL. WILCZA NR 28 LOK. 1, 00-544 WARSZAWA, NUMERY ZMIENIONYCH PARAGRAFÓW: §6, §8 UST. 1, §8 UST. 2, §14 UST. 1.
4	26.06.2009 R., URSZULA STATKIEWICZ-WYSOCKA NOTARIUSZ W WARSZAWIE, REP. A NR 6729/2009, NUMERY ZMIENIONYCH PARAGRAFÓW: § 6 UST. 1, § 9 (UJEDNOLICENIE DANYCH), § 17
5	AKT NOTARIALNY Z DNIA 07.01.2010 ROKU, REPERTORIUM A NR 68/2010, NOTARIUSZ URSZULA STATKIEWICZ-WYSOCKA, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE PRZY UL. PŁOWIECKIEJ 7 ZMIENIONO § 14 UST. 2
6	15.03.2013 R., URSZULA STATKIEWICZ-WYSOCKA NOTARIUSZ W WARSZAWIE, REP. A NR 1187/2013, ZMIENIONO: § 14 UST. 1

Rubryka 5

1.Czas, na jaki została utworzona spółka	NIEOZNACZONY
2.Oznaczenie pisma innego niż Monitor Sądowy i Gospodarczy, przeznaczonego do ogłoszeń spółki	-----
3.Wspólnik może mieć:	WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW
4.Czy statut przyznaje uprawnienia osobiste określonym akcjonariuszom lub tytuły uczestnictwa w dochodach lub majątku spółki nie wynikających z akcji?	*****
5.Czy obligatoriusze mają prawo do udziałów w zysku?	*****

Rubryka 6 - Sposób powstania spółki

Brak wpisów

Rubryka 7 - Dane wspólników

1	1.Nazwisko / Nazwa lub firma	OLYMPUS EUROPA SE & CO. KG
	2.Imiona	*****
	3.Numer PESEL/REGON	---
	4.Numer KRS	-----
	5.Posiadane przez wspólnika udziały	266 970 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 26 697 000 ZŁOTYCH
	6.Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?	TAK

Rubryka 8 - Kapitał spółki

1.Wysokość kapitału zakładowego	26 697 000,00 Zł
Podrubryka 1 Informacja o wniesieniu aportu	
Brak wpisów	

Rubryka 9 - Nie dotyczy

Brak wpisów

Rubryka 10 - Nie dotyczy

Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu

1.Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotu	ZARZĄD
2.Sposób reprezentacji podmiotu	DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓLDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM

Podrubryka 1

Dane osób wchodzących w skład organu

1	1.Nazwisko / Nazwa lub Firma	DRASKOVIC
	2.Imiona	KRESIMIR
	3.Numer PESEL/REGON	---
	4.Numer KRS	****
	5.Funkcja w organie reprezentującym	CZŁONEK ZARZĄDU
	6.Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?	NIE
	7.Data do jakiej została zawieszona	-----
2	1.Nazwisko / Nazwa lub Firma	MRZYGŁÓD
	2.Imiona	TOMASZ
	3.Numer PESEL/REGON	78052404912
	4.Numer KRS	****
	5.Funkcja w organie reprezentującym	PREZES ZARZĄDU
	6.Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?	NIE
	7.Data do jakiej została zawieszona	-----
3	1.Nazwisko / Nazwa lub Firma	WOJASIEWICZ
	2.Imiona	ANDRZEJ MICHAŁ
	3.Numer PESEL/REGON	78111401179
	4.Numer KRS	****
	5.Funkcja w organie reprezentującym	CZŁONEK ZARZĄDU
	6.Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?	NIE
	7.Data do jakiej została zawieszona	-----

Rubryka 2 - Organ nadzoru

Brak wpisów

Rubryka 3 - Prokurenci

1	1.Nazwisko	REINHOLD
	2.Imiona	JACEK ANDRZEJ
	3.Numer PESEL	65070303956
	4.Rodzaj prokury	PROKURA ŁĄCZNA
2	1.Nazwisko	KOKOSZKA
	2.Imiona	RENATA EWA
	3.Numer PESEL	73091011488
	4.Rodzaj prokury	PROKURA ŁĄCZNA
3	1.Nazwisko	SŁOTWIŃSKA KARAŚ
	2.Imiona	SYLWIA
	3.Numer PESEL	80101007247
	4.Rodzaj prokury	PROKURA ŁĄCZNA Z CZŁONKIEM ZARZĄDU SPÓŁKI
4	1.Nazwisko	OSTROWSKA STRZELCZYK
	2.Imiona	MONIKA EMILIA
	3.Numer PESEL	84101411042
	4.Rodzaj prokury	PROKURA ŁĄCZNA Z CZŁONKIEM ZARZĄDU SPÓŁKI

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności

1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy	1	46, 46, Z, SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW FARMACEUTYCZNYCH I MEDYCZNYCH
2.Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy	1	33, 13, Z, NAPRAWA I KONSERWACJA URZĄDZEŃ ELEKTRONICZNYCH I OPTYCZNYCH
	2	33, 20, Z, INSTALOWANIE MASZYN PRZEMYSŁOWYCH, SPRZĘTU I WYPOSAŻENIA
	3	46, 43, Z, SPRZEDAŻ HURTOWA ELEKTRYCZNYCH ARTYKUŁÓW UŻYTKU DOMOWEGO
	4	46, 52, Z, SPRZEDAŻ HURTOWA SPRZĘTU ELEKTRONICZNEGO I TELEKOMUNIKACYJNEGO ORAZ CZĘŚCI DO NIEGO
	5	62, 01, Z, DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM
	6	74, 20, Z, DZIAŁALNOŚĆ FOTOGRAFICZNA
	7	82, 30, Z, DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ORGANIZACJĄ TARGÓW, WYSTAW I KONGRESÓW
	8	85, 60, Z, DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA EDUKACJĘ
	9	95, 21, Z, NAPRAWA I KONSERWACJA ELEKTRONICZNEGO SPRZĘTU POWSZECHNEGO UŻYTKU

Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach

Rodzaj dokumentu	Nr kolejny w polu	Data złożenia	Za okres od do
1.Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego	1	07.06.2002	01.04.2001 - 31.03.2002
	2	11.07.2003	01.04.2002 - 31.03.2003
	3	24.09.2004	01.04.2003 - 31.03.2004

	4	26.08.2005	01.04.2004 - 31.03.2005
	5	20.09.2006	01.04.2005 - 31.03.2006
	6	05.10.2007	01.04.2006 - 31.03.2007
	7	24.09.2008	01.04.2007 - 31.03.2008
	8	07.10.2009	01.04.2008 - 31.03.2009
	9	10.08.2010	01.04.2009 - 31.03.2010
	10	10.10.2011	01.04.2010 - 31.03.2011
	11	10.10.2012	01.04.2011 - 31.03.2012
	12	29.08.2013	01.04.2012 - 31.03.2013
	13	13.10.2014	OD 01.04.2013 DO 31.03.2014
	14	11.08.2015	OD 01.04.2014 DO 31.03.2015
	15	28.09.2016	OD 01.04.2015 DO 31.03.2016
	16	31.08.2017	OD 01.04.2016 DO 31.03.2017
	17	16.01.2019	OD 01.04.2017 DO 31.03.2018
	18	15.05.2020	OD 01.04.2018 DO 31.03.2019
	19	29.09.2020	OD 01.04.2019 DO 31.03.2020
	20	01.10.2021	OD 01.04.2020 DO 31.03.2021
2.Wzmianka o złożeniu opinii biegłego rewidenta / sprawozdania z badania rocznego sprawozdania finansowego	1	*****	01.04.2001 - 31.03.2002
	2	*****	01.04.2002 - 31.03.2003
	3	*****	01.04.2003 - 31.03.2004
	4	*****	01.04.2004 - 31.03.2005
	5	*****	01.04.2005 - 31.03.2006
	6	*****	01.04.2006 - 31.03.2007
	7	*****	01.04.2007 - 31.03.2008
	8	*****	01.04.2008 - 31.03.2009
	9	*****	01.04.2009 - 31.03.2010
	10	*****	01.04.2010 - 31.03.2011
	11	*****	01.04.2011 - 31.03.2012
	12	*****	01.04.2012 - 31.03.2013
	13	*****	OD 01.04.2013 DO 31.03.2014
	14	*****	OD 01.04.2014 DO 31.03.2015
	15	*****	OD 01.04.2015 DO 31.03.2016
	16	*****	OD 01.04.2016 DO 31.03.2017
	17	*****	OD 01.04.2017 DO 31.03.2018
	18	*****	OD 01.04.2018 DO 31.03.2019
	19	*****	OD 01.04.2019 DO 31.03.2020
	20	*****	OD 01.04.2020 DO 31.03.2021
3.Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu rocznego sprawozdania finansowego	1	*****	01.04.2001 - 31.03.2002
	2	*****	01.04.2002 - 31.03.2003
	3	*****	01.04.2003 - 31.03.2004
	4	*****	01.04.2004 - 31.03.2005
	5	*****	01.04.2005 - 31.03.2006

6	*****	01.04.2006 - 31.03.2007	
7	*****	01.04.2007 - 31.03.2008	
8	*****	01.04.2008 - 31.03.2009	
9	*****	01.04.2009 - 31.03.2010	
10	*****	01.04.2010 - 31.03.2011	
11	*****	01.04.2011 - 31.03.2012	
12	*****	01.04.2012 - 31.03.2013	
13	*****	OD 01.04.2013 DO 31.03.2014	
14	*****	OD 01.04.2014 DO 31.03.2015	
15	*****	OD 01.04.2015 DO 31.03.2016	
16	*****	OD 01.04.2016 DO 31.03.2017	
17	*****	OD 01.04.2018 DO 31.03.2019	
18	*****	OD 01.04.2019 DO 31.03.2020	
19	*****	OD 01.04.2020 DO 31.03.2021	
4.Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu	1	*****	01.04.2001 - 31.03.2002
	2	*****	01.04.2002 - 31.03.2003
	3	*****	01.04.2003 - 31.03.2004
	4	*****	01.04.2004 - 31.03.2005
	5	*****	01.04.2005 - 31.03.2006
	6	*****	01.04.2006 - 31.03.2007
	7	*****	01.04.2007 - 31.03.2008
	8	*****	01.04.2008 - 31.03.2009
	9	*****	01.04.2009 - 31.03.2010
	10	*****	01.04.2010 - 31.03.2011
	11	*****	01.04.2011 - 31.03.2012
	12	*****	01.04.2012 - 31.03.2013
	13	*****	OD 01.04.2013 DO 31.03.2014
	14	*****	OD 01.04.2014 DO 31.03.2015
	15	*****	OD 01.04.2015 DO 31.03.2016
	16	*****	OD 01.04.2016 DO 31.03.2017
	17	*****	OD 01.04.2018 DO 31.03.2019
	18	*****	OD 01.04.2019 DO 31.03.2020
	19	*****	OD 01.04.2020 DO 31.03.2021

Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej

Brak wpisów

Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego

Brak wpisów

Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy

1.Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za 31.03.1997

który należy złożyć sprawozdanie finansowe

Dział 4**Rubryka 1 - Zaległości**

Brak wpisów

Rubryka 2 - Wierzytelności

Brak wpisów

Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego

Brak wpisów

Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych

Brak wpisów

Dział 5**Rubryka 1 - Kurator**

Brak wpisów

Dział 6**Rubryka 1 - Likwidacja**

Brak wpisów

Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki

Brak wpisów

Rubryka 3 - Nie dotyczy

Brak wpisów

Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu

Brak wpisów

Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym

Brak wpisów

Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym

Brak wpisów

Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych, o postępowaniu naprawczym lub o przymusowej restrukturyzacji

Brak wpisów

Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej

Brak wpisów

data sporządzenia wydruku 08.06.2022

adres strony internetowej, na której są dostępne informacje z rejestru: ekrs.ms.gov.pl