



**SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI
ZDROWOTNEJ W RADZIEJOWIE**

ul. Szpitalna 3, 88-200 Radziejów
REGON 910333036 NIP 889-12-69-126
tel. 54/285-62-00; fax 54/285-37-01
e-mail: sekretariat@szpitalradziejow.pl
<https://www.szpitalradziejow.pl>

Radziejów, dnia 29.05.2023 r.

Do wszystkich zainteresowanych

Dotyczy udzielenia zamówienia publicznego niepodlegającego ustawie z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2022 r., poz. 1710, ze zm.), o wartości nieprzekraczającej kwoty na podstawie art. 2 ust 1 pkt 1) ustawy PZP na: **„Dostawa narzędzi do wykorzystania na bloku operacyjnym”** (oznaczenie sprawy ZO-15/2023) – ogłoszonego na platformie zakupowej w dniu 22 maja 2023 r.

<https://www.platformazakupowa.pl/pn/szpitalradziejow/proceedings>

ID (770192)

Niniejszym, na mocy przysługujących nam jako Zamawiającemu uprawnień i obowiązków poniżej przekazujemy treść zapytań i udzielonych wyjaśnień.

PAKIET NUMER 2 (Akcesoria do ALARIS CC)

1. Czy Zamawiający zgodzi się dopuścić produkt, który o opisie ma objętość wstępnego wypełnienia 1,5 ml (zamiast 1,6ml) przy zachowaniu pozostałych parametrów (dł 200 cm, dysk z czujnikiem ciśnienia w linii oraz niewchłaniałość leków)?

ODPOWIEDŹ: Zamawiający dopuszcza

PAKIET NUMER 4 (Trokary laparoskopowe)

Czy zamawiający dopuści i wydzieli z zadania nr 4

1. "CHIRURGIA: ZESTAW DO LAPAROSKOPII Z TROKARAMI

- sterylny, jednorazowego użytku

- 1 szt. trokara 12 mm:

* * z karbowaną kaniulą z kierunkowym metalowym ostrzem w kształcie litery V

trójstopniowy, zawór bezpieczeństwa umożliwiający przeprowadzenie desuflacji bez odłączania wężyka CO2

- 1 szt. kaniuli 12 mm

* karbowana z trójstopniowym zaworem insuflacyjnym i wbudowaną uszczelką 5-12 mm

- * trójstopniowy, zawór bezpieczeństwa umożliwiający przeprowadzenie desuflacji bez odłączania wężyka CO2
- 1 szt. trokara 5 mm:
 - * z karbowaną kaniulą z kierunkowym metalowym ostrzem w kształcie litery V
 - * dwustopniowy, zawór bezpieczeństwa
- 1 szt. kaniuli 5 mm:
 - * karbowana z dwustopniowym zaworem insuflacyjnym
- każdy komponent zestawu osobno sterylnie zapakowany
- zestaw zawiera 4 naklejki do historii choroby pacjenta opatrzone kodem katalogowym oraz nr LOT;
- zewnętrzne opakowanie zawiera:
 - * foliową plombę zabezpieczającą przed incydentalnym otwarciem zestawu
 - * kod kreskowy, dane producenta
 - * datę produkcji, datę ważności oraz nr LOT
 - * etykietę z kodem katalogowym i opisem zestawu
 - * kody katalogowe, opisy oraz ilości poszczególnych komponentów zestawu?

ODPOWIEDŹ: Zgodnie z treścią zapytania ofertowego.

Czy zamawiający dopuści i wydzieli z zadania nr 4

2. "CHIRURGIA: TROKAR LAPAROSKOPOWY – średnica 12 mm
- sterylny, jednorazowego użytku
 - z bezpiecznym ostrzem w kształcie liniowym naostrzonym obustronnie
 - z kaniulą karbowaną
 - z trójstopniowym zaworem insuflacja/stop/desuflacja (możliwość desuflacji bez odłączania wężyka CO2)
 - samodopasowująca się uszczelka mieszcząca narzędzia od 5 do 12 mm (bez konieczności używania redukcji)
 - ostrze w bezpiecznej osłonie
 - wizualny wskaźnik położenia ostrza oraz dźwiękowy sygnał informujący o jego wysunięciu?

ODPOWIEDŹ: Zgodnie z treścią zapytania ofertowego.

Czy zamawiający dopuści i wydzieli z zadania nr 4

3. "CHIRURGIA: TROKAR LAPAROSKOPOWY – średnica 5 mm
- sterylny, jednorazowego użytku
 - z bezpiecznym ostrzem w kształcie liniowym naostrzonym obustronnie
 - z kaniulą karbowaną
 - z dwustopniowym zaworem insuflacja/desuflacja
 - ostrze w bezpiecznej osłonie
 - wizualny wskaźnik położenia ostrza oraz dźwiękowy sygnał informujący o jego wysunięciu?

ODPOWIEDŹ: Zgodnie z treścią zapytania ofertowego.

PAKIET NUMER 5 (Zestaw do toracentezy)

1. Czy zamawiający dopuście zestaw o poniższych parametrach: **pozycja 1**

- worek do zbiórki odprowadzanych płynów 2 000 ml z zastawką przeciwwrotną, zapobiegającą cofaniu się zaaspirowanych płynów oraz zaworem spustowym
- dreny łączące: pomiędzy workiem, a kranikiem trójdrożnym (4,8 x 6,8-85 cm dł.) oraz pomiędzy kranikiem i igłą (4,8 x 6,8-40 cm dł.)
- zastawki przeciwwrotne wzdłuż linii umożliwiające nieprzerwaną aspirację i drenaż bez użycia kranika trójdrożnego
- strzykawka 60 ml do aspiracji
- zestaw do aspiracji jest dostępny w kilku wersjach i rozmiarach, co pozwala na rozszerzenie wachlarza zastosowań
- trio igieł 55 mm (14G, 16G i 19G)
- trio igieł 80 mm (14G, 16G i 19G)
- igła Veress 15G (100 mm długości), z automatycznie cofającą się końcówką
- sterylne
- opakowanie podwójne - zewnętrzne papier - folia, wewnętrzne folia



ODPOWIEDŹ: Zgodnie z treścią zapytania ofertowego.

PAKIET NUMER 6 (Narzędzia ortopedyczne wielorazowe)

1. Pakiet 6, poz. 6.1.: Czy Zamawiający wyraża zgodę na kleszczyki nazwa własna GROSS MAIER dł. 270 mm, pozostałe parametry bez zmian.

ODPOWIEDŹ: Zamawiający dopuszcza.

2. Pakiet 6, poz. 6.3.: Czy Zamawiający wyraża zgodę na skalpel dł. 120 mm pozostałe parametry bez zmian.

ODPOWIEDŹ: Zamawiający dopuszcza.

3. Pakiet 6, poz. 6.4.: Czy Zamawiający wyraża zgodę na nożyczki dł. 140 mm, pozostałe parametry bez zmian.

ODPOWIEDŹ: Zamawiający dopuszcza.

4. Pakiet 6, poz. 6.7.: Czy Zamawiający wyraża zgodę na nożyczki dł. 140 mm, pozostałe parametry bez zmian.

ODPOWIEDŹ: Zamawiający dopuszcza.

5. Pakiet 6, poz. 6.13.: Czy Zamawiający wyraża zgodę na kleszczyki nazwa własna Baby Crile, pozostałe parametry bez zmian.

ODPOWIEDŹ: Zamawiający dopuszcza.

6. Pakiet 6, poz. 6.14.: Czy Zamawiający wyraża zgodę na kleszczyki nazwa własna Rankin, pozostałe parametry bez zmian.

ODPOWIEDŹ: Zamawiający dopuszcza.

7. Pakiet 6, poz. 6.16.: Czy Zamawiający wyraża zgodę na imadło dł. 150 mm, pozostałe parametry bez zmian.

ODPOWIEDŹ: Zamawiający dopuszcza.

8. Pakiet 6, poz. 6.17.: Czy Zamawiający wyraża zgodę na imadło dł. 200 mm, pozostałe parametry bez zmian.

ODPOWIEDŹ: Zamawiający dopuszcza.

9. Pakiet 6, poz. 6.19.: Czy Zamawiający wyraża zgodę na hak o wymiarach 28x27, 45x27, dł. 190 mm, nazwa własna ROUX, pozostałe parametry bez zmian.

ODPOWIEDŹ: Zamawiający dopuszcza.

10. Pakiet 6, poz. 6.20.: Czy Zamawiający wyraża zgodę na rozwieracz dł. 135 mm, pozostałe parametry bez zmian.

ODPOWIEDŹ: Zamawiający dopuszcza.

11. Pakiet 6, poz. 6.23.: Czy Zamawiający wyraża zgodę na dźwignie o szerokości 18 mm, pozostałe parametry bez zmian.

ODPOWIEDŹ: Zamawiający dopuszcza.

12. Pakiet 6, poz. 6.24.: Czy Zamawiający wyraża zgodę na kleszcze dł. 205 mm, pozostałe parametry bez zmian.

ODPOWIEDŹ: Zamawiający dopuszcza.

13. Pakiet 6, poz. 6.25.: Czy Zamawiający wyraża zgodę na kleszcze dł. 135 mm, pozostałe parametry bez zmian.

ODPOWIEDŹ: Zamawiający dopuszcza.

14. Pakiet 6, poz. 6.27.: Czy Zamawiający wyraża zgodę na odgryzacz kostny dł. 175 mm, pozostałe parametry bez zmian.

ODPOWIEDŹ: Zamawiający dopuszcza.

15. Pakiet 6, poz. 6.32.: Czy Zamawiający wyraża zgodę na łyżkę kostną dł. 170 mm, pozostałe parametry bez zmian.

ODPOWIEDŹ: Zamawiający dopuszcza.

16. Pakiet 6, poz. 6.33.: Czy Zamawiający wyraża zgodę na łyżkę kostną dł. 170 mm, pozostałe parametry bez zmian.

ODPOWIEDŹ: Zamawiający dopuszcza.

17. Pakiet 6, poz. 6.36.: Czy Zamawiający wyraża zgodę na elewator z raspaturem o szerokości 3 mm, pozostałe parametry bez zmian

ODPOWIEDŹ: Zamawiający dopuszcza.

18. Pakiet 6, poz. 6.39.: Czy Zamawiający wyraża zgodę na młotek o wadze całkowitej 570 g, średnicy 45 mm, dł. 250 mm

ODPOWIEDŹ: Zamawiający dopuszcza.

19. Pakiet 6, poz. 6.41.: Czy Zamawiający wyraża zgodę na naczynie o wymiarach 85x54x40 mm, pozostałe parametry bez zmian.

ODPOWIEDŹ: Zamawiający dopuszcza.

20. Pakiet 6, poz. 6.43.: Czy Zamawiający wyraża zgodę na kosz o wymiarach 540x245x100 mm, pozostałe parametry bez zmian.

ODPOWIEDŹ: Zamawiający dopuszcza.

21. Pakiet 6. poz. 6.44.: Czy Zamawiający wyraża zgodę na pokrywę do kosza o wymiarach 540x245x100 mm, pozostałe parametry bez zmian.

ODPOWIEDŹ: Zamawiający dopuszcza.

22. Czy Zamawiający dopuści w pełni równoważny zestaw, zachowujący lub przewyższający wszystkie wskazane parametry użytkowe, oraz wszystkie wymagane warunki/parametry techniczne:

lp	OPIS	PRZEZNACZENIE	J.M	ILOŚĆ
6.1	KLESZCZYKI DO OPATRUNKÓW ODGIĘTE GROSS -MAIER DŁ. 250MM Z ZAMKIEM	wielorazowego użytku	szt.	1
6.2	UCHWYT SKALPELA NUMER 4 DŁUGOŚĆ 135 MM	wielorazowego użytku	szt.	1
6.3	UCHWYT SKALPELA NUMER 3 DŁUGOŚĆ 125 MM	wielorazowego użytku	szt.	1
6.4	NOŻYCZKI PREPARACYJNE ODGIĘTE METZENBAUM DŁUGOŚĆ 145 MM OSTRZA TĘPO TEPE UTWARDZONE Z TWARDĄ WKŁADKĄ ŻŁOTE UCHA	wielorazowego użytku	szt.	1
6.5	NOŻYCZKI PREPARACYJNE ODGIĘTE METZENBAUM DŁUGOŚĆ 200 MM OSTRZA TĘPO TEPE UTWARDZONE Z TWARDĄ WKŁADKĄ ŻŁOTE UCHA	wielorazowego użytku	szt.	1
6.6	NOŻYCZKI CHIRURGICZNE ODGIĘTE MAYO DŁUGOŚĆ 170 MM OSTRZA TĘPO TĘPE	wielorazowego użytku	szt.	1
6.7	NOŻYCZKI CHIRURGICZNE PROSTE TĘPO OSTRE DŁ. 145MM	wielorazowego użytku	szt.	1
6.8	PINCETA CHIRURGICZNA STANDARD PROSTA KOŃCÓWKA ROBOCZA 1X2 ZĄBKI DŁUGOŚĆ 145 MM	wielorazowego użytku	szt.	2
6.9	PINCETA CHIRURGICZNA STANDARD PROSTA KOŃCÓWKA ROBOCZA 1X2 ZĄBKI DŁUGOŚĆ 200 MM	wielorazowego użytku	szt.	1
6.10	PINCETA ANATOMICZNA ŚREDNIO SZEROKA PROSTA DŁUGOŚĆ 180 MM	wielorazowego użytku	szt.	1
6.11	KLESZCZYKI NACZYNIOWE KOCHER PROSTE KOŃCÓWKA ROBOCZA 1X2 ZĄBKI DŁUGOŚĆ 140 MM	wielorazowego użytku	szt.	2
6.12	KLESZCZYKI NACZYNIOWE OSCHNER- KOCHER PROSTE KOŃCÓWKA ROBOCZA 1X2 ZĄBKI DŁUGOŚĆ 200 MM	wielorazowego użytku	szt.	2
6.13	KLESZCZYKI NACZYNIOWE CRILE ZAKRZYWIONE DELIKATNE DŁUGOŚĆ 145 MM	wielorazowego użytku	szt.	2

6.14	KLESZCZYKI NACZYNIOWE CRILE-RANKIN ZAKRZYWIONE DELIKATNE DŁUGOŚĆ 160 MM	wielorazowego użytku	szt.	2
6.15	KLESZCZYKI PREPARACYJNE OVERHOLT-GEISSENDOERFER ZAKRZYWIONE DŁUGOŚĆ 210MM	wielorazowego użytku	szt.	1
6.16	IMADŁO CHIRURGICZNE CRILE-WOOD SZCZĘKI PROSTE Z TWARDĄ WKŁADKĄ ZŁOTE UCHA, DŁ 150 MM	wielorazowego użytku	szt.	1
6.17	IMADŁO CHIRURGICZNE HEGAR-MAYO SZCZĘKI PROSTE Z TWARDĄ WKŁADKĄ ZŁOTE DŁUGOŚĆ 200 MM	wielorazowego użytku	szt.	1
6.18	HAK OPERACYJNY VOLKMANN CZTEROZĘBNY PÓŁOSTRY 9X19 MM DŁUGOŚĆ 220 MM	wielorazowego użytku	szt.	2
6.19	HAK OPERACYJNY PARKER-LANGENBECK (US-ARMY) DŁUGOŚĆ 210 MM DWUSTRONNY WYMIARY ŁYŻEK 21X15/40X15-25X15/45X15	wielorazowego użytku	szt.	1
6.20	ROZWIERACZ CONE (ADSON BABY) Z PRZEGUBEM DŁUGOŚĆ 140 MM	wielorazowego użytku	szt.	1
6.21	HAK OPERACYJNY KOCHER JEDNOZĘBNY OSTRY DŁUGOŚĆ 215 MM	wielorazowego użytku	szt.	1
6.22	DŹWIGNIA KOSTNA SZEROKOŚĆ 7,5 MM SZEROKOŚĆ KOŃCÓWKI 2 MM DŁUGOŚĆ 150 MM	wielorazowego użytku	szt.	2
6.23	DŹWIGNIA KOSTNA HOHMANN SZEROKOŚĆ 17 MM DŁUGOŚĆ 240 MM	wielorazowego użytku	szt.	2
6.24	KLESZCZE REPOZYCYJNE DO DUŻYCH KOŚCI DŁUGOŚĆ 210 MM	wielorazowego użytku	szt.	2
6.25	KLESZCZE REPOZYCYJNE DO KOŚCI MAŁE Z ZAMKIEM ZAKRZYWIONE DŁUGOŚĆ 160 MM	wielorazowego użytku	szt.	2
6.26	KOŚCIOTRZYMACZ ZAKRZYWIONY W BOK ZE ŚRUBĄ BLOKUJĄCĄ DŁUGOŚĆ CAŁKOWITA 190 MM	wielorazowego użytku	szt.	2
6.27	ODGRYZACZ KOSTNY RASKIN (TYPU LUER) ZAKRZYWIONY SZEROKOŚĆ SZCZĘKI 6 MM DŁUGOŚĆ 180 MM	wielorazowego użytku	szt.	1
6.28	KLESZCZE PŁASKIE DO TRZYMANIA DRUTU SZCZĘKI KRZYŻOWO ZĄBKOWANE Z DODATKOWYMI KANAŁAMI PIONOWYM ORAZ POZIOMYM DŁ. 130 MM	wielorazowego użytku	szt.	1
6.29	KLESZCZE PŁASKIE DO TRZYMANIA DRUTU SZCZĘKI ZWĘŻAJĄCE SIĘ KU KOŃCÓWKI POPRZECZNIE ZĄBKOWANE DŁUGOŚĆ CAŁKOWITA 180 MM	wielorazowego użytku	szt.	1
6.30	KLESZCZE DO CIĘCIA DRUTU ZE WZMACNIANYMI KRAWĘDZIAMI TNĄCYMI DEDYKOWANE DO DRUTÓW O ŚREDNICY 2,2 MM DŁUGOŚĆ 235 MM	wielorazowego użytku	szt.	1
6.31	RASPATOR LAMBOTTE SZEROKOŚĆ CZĘŚCI ROBOCZEJ 10 MM DŁUGOŚĆ CAŁKOWITA 215 MM	wielorazowego użytku	szt.	1
6.32	ŁYŻKA KOSTNA VOLKMANN SZEROKOŚĆ CZĘŚCI ROBOCZEJ 5,2 MM DŁUGOŚĆ 170 MM	wielorazowego użytku	szt.	1
6.33	ŁYŻKA KOSTNA VOLKMANN SZEROKOŚĆ CZĘŚCI ROBOCZEJ 8,5 MM DŁUGOŚĆ 170 MM	wielorazowego użytku	szt.	1
6.34	POBIJAK KOSTNY ŚREDNICA GŁÓWKI 5 MM DŁ. 160MM	wielorazowego użytku	szt.	1
6.35	DŹWIGNIA KOSTNA QUERVAIN LEKKO ZAKRZYWIONA TĘPO ZAKOŃCZONA SZEROKOŚĆ 6 MM DŁUGOŚĆ 195 MM	wielorazowego użytku	szt.	1
6.36	ELEWATOR Z RASPATOREM FREER DWUSTRONNY TEPO/OSTRY DŁUGOŚĆ 185 MM	wielorazowego użytku	szt.	1

6.37	OSTEOTOM LAMBOTTE PROSTY SZEROKOŚĆ 10 MM DŁUGOŚĆ 245 MM	wielorazowego użytku	szt.	1
6.38	OSTEOTOM LAMBOTTE PROSTY SZEROKOŚĆ 16 MM DŁUGOŚĆ 245MM	wielorazowego użytku	szt.	1
6.39	MŁOTEK WAGA GŁOWY 380 G ŚREDNICA 45 MM DŁUGOŚĆ 240 MM	wielorazowego użytku	szt.	1
6.40	LINIJKĄ STALOWĄ WYSKALOWANĄ W MILIMETRACH I CALACH DŁUGOŚĆ 300 MM	wielorazowego użytku	szt.	1
6.41	NACZYNIĘ LABORATORYJNE STALOWE POJEMNOŚĆ 0,16 LITRA WYMIARY 83X 41MM	wielorazowego użytku	szt.	1
6.42	STALOWA MISKA NERKOWATA O DŁ.250 MM	wielorazowego użytku	szt.	1
6.43	1/1 KOSZ DO KONTENERA WYMIARY 540X255X100 MM	wielorazowego użytku	szt.	1
6.44	1/1 POKRYWA DEDYKOWANA DO KOSZA Z POZ 43	wielorazowego użytku	szt.	1
6.45	Pilnik kostny dł 220mm pilnik kostny, skrobaczka • Przeznaczenie: rzeźbienie kości • Dostępny rozmiar: 220 mm • Produkt wielokrotnego użytku • Produkt niesterylny	wielorazowego użytku	szt.	2

ODPOWIEDŹ: Zamawiający dopuszcza.

23. Czy wymieniona w postępowaniu przez Zamawiającego pozycja 6.43 ma stanowić komplet z pozycją 6.44?


ODPOWIEDŹ: Zamawiający dopuszcza.

24. Czy zamawiający dopuści do zaoferowania w pozycji 43, kosz o wymiarach 540x250x100mm oraz w pozycji 44, pokrywę do kosza o wymiarach 540x250x4,2mm?




ODPOWIEDŹ: Zamawiający dopuszcza.

25. 6.1 Kleszczyki do materiałów opatrunkowych typu GROSS-MAIER, odgięte, dł. 270 mm




ODPOWIEDŹ: Zamawiający dopuszcza.

26. 6.15 Kleszczyki naczyniowe typu OVERHOLT-GEISSENDOERFER, odgięte, dł. 210 mm




ODPOWIEDŹ: Zamawiający dopuszcza.

27. 6.17 Igiotrzymacz typu MAYO-HEGAR prosty, z twardą wkładką, dł. 203 mm



ODPOWIEDŹ: Zamawiający dopuszcza.

28. 6.18 Hak chirurgiczny typu VOLKMANN, półostrzy, 4-zębny, wymiary 9 x 19 mm, dł. 220 mm



ODPOWIEDŹ: Zamawiający dopuszcza.


29. 6.19 Hak typu US-ARMY, wymiary 26 x 14/ 43 x 14 mm, dł. 215 mm, Hak typu US-ARMY, wymiary 22 x 14/ 39 x 14 mm, dł. 215 mm



US-ARMY
07-377 220 mm (8 3/4")
26 x 15 / 43 x 15 mm
07-378 215 mm (8 1/2")
22 x 15 / 39 x 15 mm

ODPOWIEDŹ: Zamawiający dopuszcza.

30. 6.20 Rozwieracz typu ADSON-BABY, ostry, 3x4 zęby, dł. 135 mm



ADSON-BABY
07-784
135 mm (5 1/4")
ostry/spitz/sharp
3x4 ząbki/Zähne/prongs
07-785
135 mm (5 1/4")
tępy/stumpf/blunt
3x4 ząbki/Zähne/prongs

ADSON
07-466
160 mm (6 1/4")
ostry/spitz/sharp
3x4 ząbki/Zähne/prongs 13 mi
07-467
160 mm (6 1/4")
tępy/stumpf/blunt
3x4 ząbki/Zähne/prongs 13 mi

ADSON BABY / ADSON

ODPOWIEDŹ: Zamawiający dopuszcza.

31. 6.25 Kleszcze do repozycjonowania kości, dł. 130 mm



09-357
130 mm (5 1/8")

ODPOWIEDŹ: Zamawiający dopuszcza.

32. 6.26 Kleszcze do trzymania kości typu SELF-CENTERING, szczęki 10 mm, dł. 190 mm



09-384 150 mm (6")
do małych fragmentów szczęki 9 mm
für kleine Kieferteile/for small jaw parts 9 mm
09-385 190 mm (7 1/2")
super male szczęki 10 mm
/super kleines Maul/extra small jaws 10 mm
09-386 240 mm (9 1/8")
małe szczęki/kleines Maul/small jaw 14 mm
09-387 260 mm (10 1/4")
średnie szczęki/mittleres Maul/medium jaw 18 mm
09-388 280 mm (11")
duże szczęki/Großes Maul/large jaw 23 mm

SELF-CENTERING
kleszcze smocentrujące ze śrubą mocującą
/selbstzentrierend mit Gewindesperre
/self-centering forceps with thread fixation

ODPOWIEDŹ: Zamawiający dopuszcza.

33. 6.29 Kleszcze do trzymania drutu, dł. 180 mm



kleszcze do trzymania drutu
/Drahtfasszangen
/wire holding
09-539
180 mm (7 1/8")
ząbkowane/geriefelt/serrated

ODPOWIEDŹ: Zamawiający dopuszcza.


34. 6.30 Kleszcze do cięcia drutu, boczne, miękki max. 2,0 mm, twarde max. 1,6 mm, z twardą wkładką, dł. 240 mm



09-606
240 mm (9 1/2")
Do drutów:
miękki max. 2.0 mm
twardy max. 1.6 mm

ODPOWIEDŹ: Zamawiający dopuszcza.

35. 6.31 Skrobaczka kostna typu LAMBOTTE, prosta, szer. 10 mm, dł. 210 mm



LAMBOTTE 09-063/M 5 mm
210 mm (8 1/4") 09-063 10 mm
09-064 15 mm
09-065 20 mm

ODPOWIEDŹ: Zamawiający dopuszcza.

36. 6.34 Pobijak kostny do pobijania młotkiem, dł. 210 mm, część robocza okrągła z nacięciami krzyżowymi, śr. 5 mm, niebieski uchwyt z tworzywa RADEL



ODPOWIEDŹ: Zamawiający dopuszcza.


37. 6.35 Podważka kostna typu QUERVAIN szer. 6 mm, dł. 200 mm



QUERVAIN
09-969
200 mm (8")

ODPOWIEDŹ: Zamawiający dopuszcza.

38. 6.39 Młotek ortopedyczny typu HEATH, waga 600 g, śr. 35 mm, dł. 235 mm

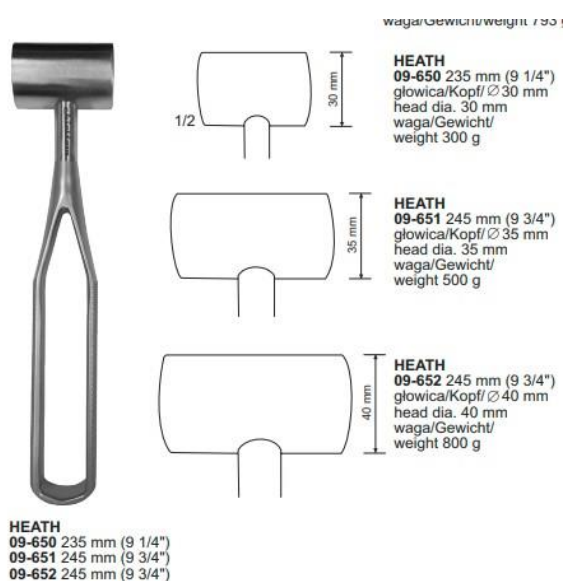

ODPOWIEDŹ: Zamawiający dopuszcza.

39. 6.41 Miska typu GALLIPOT, wymiary śr. 70 x 50 mm, poj. 0,18 L



ODPOWIEDŹ: Zamawiający dopuszcza.

40. Poz.6.1) Kleszczyki o dł. 260mm, funkcjonalnie identyczne.
ODPOWIEDŹ: Zamawiający dopuszcza.
41. Poz.6.4) Nożyczki o dł. 140mm, funkcjonalnie identyczne.
ODPOWIEDŹ: Zamawiający dopuszcza.
42. Poz.6.14) Kleszczyki o nazwie własnej Crile Rankin, typ Crile, funkcjonalnie identyczne.
ODPOWIEDŹ: Zamawiający dopuszcza.
43. Poz.6.15) Kleszczyki o dł. 190mm, funkcjonalnie identyczne.
ODPOWIEDŹ: Zamawiający dopuszcza.
44. Poz.6.16) Imadło o dł. 150mm, funkcjonalnie identyczne.
ODPOWIEDŹ: Zamawiający dopuszcza.
45. Poz.6.17) Imadło o dł. 200mm, funkcjonalnie identyczne.
ODPOWIEDŹ: Zamawiający dopuszcza.
46. Poz.6.18) Hak o szer.18mm, funkcjonalnie identyczny.
ODPOWIEDŹ: Zamawiający dopuszcza.
47. Poz.6.19) Hak o dł., 210mm, funkcjonalnie identyczny.
ODPOWIEDŹ: Zamawiający dopuszcza.
48. Poz.6.20) Rozwieracz o dł. 160mm ostry lub tęp, funkcjonalnie identyczny.
ODPOWIEDŹ: Zamawiający dopuszcza.
49. Poz.6.22) Dźwignia o szer. 6mm, funkcjonalnie identyczna.
ODPOWIEDŹ: Zamawiający dopuszcza.
50. Poz.6.23) Dźwignia o szer. 18mm, funkcjonalnie identyczna.
ODPOWIEDŹ: Zamawiający dopuszcza.
51. Poz.6.26) Kościotrzymacz o szer. części roboczej 9mm, funkcjonalnie identyczny.
ODPOWIEDŹ: Zamawiający dopuszcza.
52. Poz.6.30) Kleszcze do drutu o śr. 2,5mm , dł. 230mm, funkcjonalnie identyczne lub kleszcze o dł. 175mm, identyczne z wymaganymi.
ODPOWIEDŹ: Zamawiający dopuszcza.
53. Poz.6.31) Raspator o dł. 220mm, funkcjonalnie identyczny.
ODPOWIEDŹ: Zamawiający dopuszcza.
54. Poz.6.32, 6.33) Łyżka o dł. 170mm, funkcjonalnie identyczna.
ODPOWIEDŹ: Zamawiający dopuszcza.
55. Poz.6.35) Dźwignia o dł. 200mm, funkcjonalnie identyczna.
ODPOWIEDŹ: Zamawiający dopuszcza.
56. Poz.6.36) Elewator o szer. 5mm i dł. 190mm, funkcjonalnie identyczny.
ODPOWIEDŹ: Zamawiający dopuszcza.

57. Poz.6.39) Młotek o dł. 230mm, waga 770g, śr. 40mm, funkcjonalnie identyczny lub młotek o dł. 200mm, waga 680g i śr. 40mm, funkcjonalnie identyczny.

ODPOWIEDŹ: Zamawiający dopuszcza.

58. Poz.6.41) Naczynie o wym. 80x40mm, funkcjonalnie identyczne.

ODPOWIEDŹ: Zamawiający dopuszcza.

59. Poz.6.43) Kosz o wym. 510x255x100mm, funkcjonalnie identyczny.

ODPOWIEDŹ: Zamawiający dopuszcza.

60. Poz.6.44) Z uwagi na fakt, że pozycja jest możliwa do zrealizowania wyłącznie przez jednego dostawcę, zwracamy się z prośbą o wyłączenie jej z zadania i utworzenie nowego odrębnego. Umożliwi to złożenie ofert przez większą liczbę oferentów przy zachowaniu zasad uczciwej konkurencji. Ewentualnie prosimy o dopuszczenie możliwości zaoferowania całego kontenera, bezobsługowego (wanna + pokrywa) o wym. 590x290x130mm.

ODPOWIEDŹ: Zamawiający dopuszcza, ale nie wydzieli pozycji.

61. Z uwagi na fakt, że narzędzia są produkowane z najwyższej jakości stali nierdzewnej w Niemczech oraz ze względu na spowolnienie dostaw w związku z obostrzeniami COVID-19 i normą MDR745/2017, jak również z brakiem stali chirurgicznej na rynkach światowych, zwracamy się z prośbą o zmianę terminu dostawy dla zadania nr 6 na 10 tygodni od daty otrzymania zamówienia.

ODPOWIEDŹ: Zamawiający zmienia termin realizacji zamówienia do maks. 4 dni roboczych.

62. Zwracamy się z uprzejmą prośbą o wydłużenie terminu realizacji dostawy do 4 tygodni od dnia złożenia zamówienia.

ODPOWIEDŹ: Odpowiedź pytanie nr 61 (pakiet 6).

63. *Poz.6.1 – Czy Zamawiający dopuści takie same kleszczyki do opatrunków tylko nazwa własna Gross Maier i dl. 27cm?*

ODPOWIEDŹ: Zamawiający dopuszcza.

64. *Poz.6.4 – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie takich samych nożyczek preparacyjnych tylko dl.15cm?*

ODPOWIEDŹ: Zamawiający dopuszcza.

65. *Poz.6.16 - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie takiego samego imadła chirurgicznego tylko dl.15cm?*

ODPOWIEDŹ: Zamawiający dopuszcza.

66. *Poz.6.17 - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie takiego samego imadła chirurgicznego tylko dl.20cm?*

ODPOWIEDŹ: Zamawiający dopuszcza.

67. Poz. 6.18 - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie takiego samego haka tylko dl.21,5cm?

ODPOWIEDŹ: Zamawiający dopuszcza.

68. Poz.6.19 – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie takiego samego haczyka tylko dl.210mm i rozmiar 21x15mm,40x15mm; 25x15m,,45,15mm?

ODPOWIEDŹ: Zamawiający dopuszcza.

69. Poz.6.23 – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie takie samej podważki tylko szer.18mm i dl.23,5cm?

ODPOWIEDŹ: Zamawiający dopuszcza.

70. Poz.6.25 – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie takich samych kleszczy tylko dl.13,5cm?

ODPOWIEDŹ: Zamawiający dopuszcza.

71. Poz.6.26 – Czy Zamawiający dopuści takie sam kleszcze tylko szer.2,5/6,5mm? Pozostale parametry bez zmian?

ODPOWIEDŹ: Zamawiający dopuszcza.

72. Poz.6.27 – Czy Zamawiający dopuści odgryzacz typ Luer dl.17mm i szer.8mm?

ODPOWIEDŹ: Zamawiający dopuszcza.

73. Poz.6.30 – Czy Zamawiający dopuści kleszcze o dl. 23cm lub 22cm?

ODPOWIEDŹ: Zamawiający dopuszcza.

74. Poz.6.31 – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie raspatora dl.210mm zamiast 215mm?

ODPOWIEDŹ: Zamawiający dopuszcza.

75. Poz. 6.32 i 6.32 – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie takich samych łyżek tylko dl. 17cm, szer. 4,8mm i 8,mm?

ODPOWIEDŹ: Zamawiający dopuszcza.

76. Poz. 6.36 – Czy Zamawiający dopuści taki sam elewator tylko dl.18cm?

ODPOWIEDŹ: Zamawiający dopuszcza.

77. Poz.6.38 – Czy Zamawiający dopuści tali sam osteotom tylko szer.16mm?

ODPOWIEDŹ: Zamawiający dopuszcza.

78. Poz.6.39 – Proszę o dopuszczenie młotka ortopedycznego waga całkowita 900gr., śr. główki 34mm, dl.26,5cm?

ODPOWIEDŹ: Zamawiający dopuszcza.

79. Poz.6.43 – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie kosza o rozmiarze 540x240x90mm?

ODPOWIEDŹ: Zamawiający dopuszcza.

80. Poz.6.44 – Czy Zamawiający dopuści pokrywę do kosza w rozmiarze 540x240mm?

ODPOWIEDŹ: Zamawiający dopuszcza.

81. Czy Zamawiający dopuści tolerancję wymiaru o +/- 10% w stosunku do modelu wskazanego w SWZ z uwzględnieniem wszystkich innych parametrów?

ODPOWIEDŹ: Zamawiający dopuszcza.

82. Czy Zamawiający dopuszcza złożenie oferty na produkty równoważne?

ODPOWIEDŹ: Zamawiający dopuszcza.

83. Czy Zamawiający dopuści termin dostaw do 45 dni?

ODPOWIEDŹ: Odpowiedź na pytanie nr 61 (pakiet 6).

84. Czy Zamawiający dopuści termin dostaw do 30 dni?

ODPOWIEDŹ: Odpowiedź na pytanie nr 61 (pakiet 6).

PAKIET NUMER 7 (Narzędzia chirurgiczne wielorazowe)

1. Pakiet 7, poz. 7.2.: Czy Zamawiający wyraża zgodę na kleszcze nazwa własna PEAN, pozostałe parametry bez zmian

ODPOWIEDŹ: Zamawiający dopuszcza.

2. Pakiet 7, poz. 7.5.: Czy Zamawiający wyraża zgodę na nożyczki dł. 190 mm, pozostałe parametry bez zmian.

ODPOWIEDŹ: Zamawiający dopuszcza.

3. Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania jako zestawu równoważnego narzędzi chirurgicznych o podanych poniżej parametrach technicznych:


opis	ilość
kleszczyki naczyniowe typ pean odgięte długość 130 mm smukły wzór skok ząbków 0,7 mm	10
kleszczyki naczyniowe typ Pean odgięte długość 130 mm smukły wzór skok ząbków 0,7 mm	60
uchwyt skalpela nr 4 długość 135 mm	10
kleszczyki do opatrunków odgięte typ Foerster-Ballenger długość 245 mm z zamkiem szerokość oczka 13,5 mm szczęki ząbkowane skok ząbka 1,75 mm	20
nożyczki preparacyjne typ Mayo odgięte długość 190 mm ostrza tępo/tępe zaokrąglone	5
nożyczki preparacyjne odgięte typ Metzenbaum długość 200 mm końce tępo/tępe (figura delikatna)	10
kleszczyki naczyniowe typ Rochester-Pean proste długość 225 mm skok ząbków 0,9 mm	20

ODPOWIEDŹ: Zamawiający dopuszcza.

4. Czy Zamawiający dopuści w poz. Nr 7 KLESZCZE Rochester-Pean PROSTY 22cm?

ODPOWIEDŹ: Zamawiający dopuszcza.

5. 7.2 Kleszczyki naczyniowe typu PEAN odgięte, dł. 130 mm

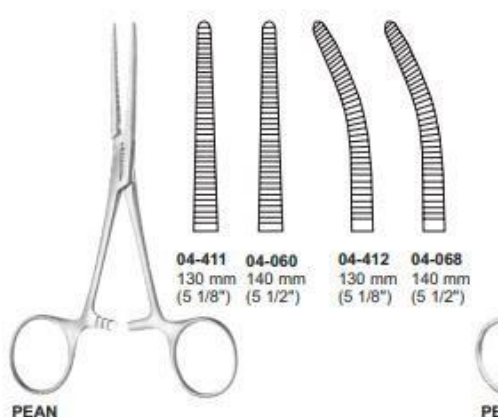

ODPOWIEDŹ: Zamawiający dopuszcza.

6. 7.7 Kleszczyki naczyniowe typu ROCHESTER-PEAN proste, dł. 220 mm



ODPOWIEDŹ: Zamawiający dopuszcza.

7. Zwracamy się z uprzejmą prośbą o wydłużenie terminu realizacji dostawy do 4 tygodni od dnia złożenia zamówienia.

ODPOWIEDŹ: Zamawiający wydłuża termin dostawy do maks. 4 dni roboczych.

8. Czy Zamawiający dopuści termin dostaw do 45 dni?

ODPOWIEDŹ: Odpowiedź pytanie nr 7 (pakiet 7).

9. Czy Zamawiający dopuści termin dostaw do 30 dni?

ODPOWIEDŹ: Odpowiedź pytanie nr 7 (pakiet 7).

PAKIET NUMER 9 (Sprzęt do diatermii ERBE)

1. Poz. 2. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania elektrodę nożową, cienką, prostą, trzonek 4mm, wielorazową, pakowaną po 1 szt. z przeliczeniem ilości?

ODPOWIEDŹ: Zamawiający dopuszcza.

2. Poz. 3. Czy Zamawiający dopuści do zaferowania elektrodę monopolarną, kulkową, prostą, średnica 6mm, długość robocza 100mm, długość całkowita 133mm, pakowaną po 1 szt., z przeliczeniem ilości ?

ODPOWIEDŹ: Zamawiający dopuszcza.

3. Czy Zamawiający wymaga dodatkowo elektrody monopolarnej nożowej, prostej, trzonek 4mm, wielorazowej? Jeśli tak, to czy Zamawiający dopuści elektrodę monopolarną nożową, prostą, trzonek 4mm, wielorazową, o długości roboczej 100mm, długość całkowita 160mm, pakowaną po 1 szt., z przeliczeniem ilości ?

ODPOWIEDŹ: Zamawiający dopuszcza.

PAKIET NUMER 10 (Ewakuator laparoskopowy)

1. Czy Zamawiający dopuści zaferowanie ewakuatora o wymiarach 85 mm x 185 mm, z uchwytem na palce w formie pierścieni dookoła aplikatora i popychacza, pozostałe właściwości według opisu.

ODPOWIEDŹ: Zamawiający dopuszcza.

2. Czy Zamawiający dopuści możliwość zaferowania jako narzędzia równoważnego ewakuator laparoskopowy wykonany z przeziernego poliuretanu nieprzepuszczającego płynów, wytrzymały na wysokie naprężenia i ciśnienie o sile do 50 – 60 N, o wymiarach 90 mm x 150 mm, pojemności 260 ml, długości przewodnika ok. 220 mm, kompatybilnego z trokarem o średnicy 10 mm, z uchwytem na palce w postaci pierścieni, z obręczą z pamięcią kształtu, samoczynnie otwierający się, pakowany pojedynczo, sterylnie, jednorazowego użycia?

ODPOWIEDŹ: Zamawiający dopuszcza.

3. Czy Zamawiający w zadaniu 10 w miejsce pierwotnych zapisów wyrazi zgodę na złożenie oferty na oryginalny produkt znanego amerykańskiego producenta zgodnie z opisem: Ewakuator Laparoskopowy wykonany z przeziernego poliuretanu nieprzepuszczającego płynów

- wytrzymałość na wysokie naprężenia i ciśnienia
- 50mmx190mm
- długość przewodnika (tuleja) 220 mm
- kompatybilny z trokarem 10 mm
- obręcz z pamięcią kształtu – samoczynnie otwierający
- produkt sterylny jednorazowego użycia
- rozmiar 200ml?

ODPOWIEDŹ: Zamawiający dopuszcza.

PAKIET NUMER 15 (Osłona na USG)

1. Czy w pozycji 15 możliwe będzie złożenie oferty osłony której Państwo oczekujecie ale o wym. 15x240 cm o nr kat. APC1292 ?

ODPOWIEDŹ: Zamawiający dopuszcza.

PYTANIA DO WZORU UMOWY I SPECYFIKACJI

1. § 3 wzoru umowy oraz formularz oferty pkt 4 Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o możliwość zaoferowania maksymalnego terminu dostawy 3 dni robocze.

ODPOWIEDŹ: Zamawiający wydłuża termin dostawy do maks. 4 dni roboczych.

2. § 6 ust. 1 wzoru umowy Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o liczenie kar od wartości niedostarczonej dostawy, a nie całego przedmiotu zamówienia.

ODPOWIEDŹ Zamawiający zmienia zapis wzoru umowy z:

1.a)0,15% wartości brutto umowy za każdy dzień zwłoki w wykonaniu przedmiotu zamówienia trwającej do 7 dni,

1.b)0,35% wartości brutto umowy za każdy dzień zwłoki w wykonaniu przedmiotu zamówienia trwającej powyżej 7 dni,

Na:

1.a)0,15% wartości brutto niedostarczonej dostawy za każdy dzień zwłoki trwający do 7 dni,

1.b)0,35% wartości brutto niedostarczonej dostawy za każdy dzień zwłoki trwający powyżej 7 dni,

3. § 7 wzoru umowy Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie faktury w formacie PDF wysłanej na wskazany wcześniej przez Zamawiającego adres e-mail.

ODPOWIEDŹ: Zamawiający dopuszcza. Zamawiający prosi o przesyłanie faktur w wersji PDF na adresy mailowe, które zostaną uzupełnione przed podpisaniem umowy w §3 .

4. ad par. 6 ust. 1a wzoru umowy czy Zamawiający zgodzi się na naliczanie kar od wartości zamówienia, a nie umowy, co jest powszechnie stosowaną metodą w analogicznych postępowaniach?

ODPOWIEDŹ: Odpowiedź na pytanie nr 3 (pytania do wzoru umowy i specyfikacji).

Powyższe wyjaśnienia stają się integralną częścią specyfikacji warunków zamówienia i są dla Wykonawców wiążące. Pozostała treść specyfikacji pozostaje bez zmian.

Radziejów, dnia 29 maja 2023 r.

DYREKTOR

mgr Sebastian JANKIEWICZ