

Jelenia Góra, dnia 2 kwietnia 2019 r.

L.dz.NZ/306/2019

DO WYKONAWCÓW.

dot: przetarg nieograniczony: postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego - Dostawa wyrobów medycznych dla Bloku Operacyjnego, Pracowni Hemodynamiki i Elektrofizjologii, Stacji Dializ, Oddziału Onkologii, nr postępowania: ZP/PN/02/02/2019.

Wojewódzkie Centrum Szpitalne Kotliny Jeleniogórskiej z siedzibą przy ul. Ogińskiego 6, 58-506 Jelenia Góra jako Zamawiający informuje, że wpłynęły zapytania do postępowania jak w tytule. Poniżej przesyłamy treść pytań wraz z odpowiedziami.

Zestaw 1:

1. Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o określenie jakich parametrów wymaga w zakresie pakietu 11.

L.p.	Nazwa i opis produktu	Wymóg do spełnienia/ /Punktacja	należy potwierdzić spełnienie warunków wpisując TAK / NIE i podać wartość tam gdzie wymagane
A	B	B1	B2
1.0	Stapler okrężny wygięty		
1.1	Stapler okrężny	Tak	
1.2	Stapler wygięty (zakrzywiony)	Tak	
1.3	Stapler po wystrzale posiada możliwość złamania główki (tzw. łamane kowadełko ułatwiające wyjęcie staplera po zespoleniu)	Tak	
1.4	Średnice: 21 mm, 25 mm, 28 mm, 31 mm, 33 mm do swobodnego wyboru przez Zamawiającego w czasie trwania umowy (dopuszcza się możliwość zaoferowania większej ilości średnic, obejmujących jednak także wszystkie wymienione)	Tak	
1.5	Stapler dostępny w dwóch długościach do swobodnego wyboru przez Zamawiającego w czasie trwania umowy	Tak	
1.6	Rozmiar (wysokość) otwartych zszywek: 4.8 mm (dopuszcza się zaoferowanie także większej ilości)	Tak	

	rozmiarów, obejmujących jednak także wysokość 4.8 mm dla każdej średnicy staplera)		
1.7	Stapler automatyczny (automatyczna regulacja docisku zszywek)	Tak	
1.8	Zszywki ze stopu tytanu (wanadowo-aluminowego) zapewniającego większą odporność na wyginanie lub z drutu obustronnie spłaszczonego zwiększającego szanse poprawnego zamknięcia	Tak	
1.9	Wyrób medyczny jednorazowy	Tak	
1.10	Wyrób medyczny jałowy	Tak	
1.11	Opakowanie bezpośrednie: 1 szt./op.	Tak	
1.12	Możliwość zakupu wyrobów na sztuki	Tak	
1.13	Wyrób posiada naklejki do umieszczenia w dokumentacji zawierające informacje o dacie ważności oraz numerze serii oraz numerze ref lub nazwie i producencie (do jednoznacznej identyfikacji produktu) - minimum 2 sztuki	Tak	
1.14	Wykonawca na prośbę Zamawiającego zapewni/przeprowadzi szkolenie z zakresu używania wyrobu	Tak	

Powyższa tabela przedstawia wymóg Zamawiającego określony w SIWZ, natomiast na podstawie udzielonych odpowiedzi z dnia 21.03.2019 (poniżej) Zamawiający potwierdza wymóg zaofiarowania w pakiecie 11 zupełnie innych staplerów okrężnych bez łamanej główki po oddaniu strzału co zmienia opis przedmiotu zamówienia.


3. Dot pakietu 11 Czy Zamawiający wymaga staplera okrężnego o poniższych parametrach:


L.p.	Nazwa i opis produktu
A	B
1.0	Stapler okrężny wygięty
1.1	Stapler okrężny
1.2	Stapler wygięty (zakrzywiony)
1.3	
1.4	Rozmiary staplera: 21, 25, 29, 33 mm. Ergonomiczny uchwyt staplera pokryty antypoślizgową gumową powłoką. Zamawiający w czasie trwania umowy podczas zamówienia określi rozmiar staplera.
1.5	Stapler dostępny w dwóch długościach do swobodnego wyboru przez Zamawiającego w czasie trwania umowy
1.6	Wysokość otwartej zszywki 5,5mm, stapler posiada regulowaną wysokością zamknięcia zszywki w zakresie od 1 mm do 2,5 mm
1.7	
1.8	Zszywki ze stopu tytanu (wanadowo-aluminowego) zapewniającego większą odporność na wyginanie
1.9	Wyrób medyczny jednorazowy
1.10	Wyrób medyczny jałowy


pyt i odp 21-03-2019.pr

file:///C:/Users/cwymam1/AppData/Local/Microsoft/Windows/NetCache/Content.Outlook/8QQLFB50/pyt%20i%20odp%20%2021-03-2019.pd

1.11	Opakowanie bezpośrednie: 3szt./op.
1.12	Możliwość zakupu wyrobów na op.
1.13	Wyrób posiada jasne zgodne z przepisami oznaczenia opakowania producenta zawierające instrukcje w języku polskim, informacje o dacie ważności oraz numerze serii oraz numerze ref lub nazwie i producencie (do jednoznacznej identyfikacji produktu)
1.14	Wykonawca na prośbę Zamawiającego zapewni/przeprowadzi szkolenie z zakresu używania wyrobu


 tel. sekretariat: (075)-75-37-201, tel. centrala: (075)-75-37-100
 fax: (075)-75-42-335
 e-mail: poczta@spzoz.jgora.pl


WOJEWÓDZKIE CENTRUM SZPITALNE
KOTLINY JELENIOGÓRSKIEJ
 58 - 506 Jelenia Góra, ul. Ogińskiego 6
 NIP: 611-12-13-469, REGON: 000293640


**DOLNY
ŚLĄSK**

Odpowiedź: Tak.

2. Identyczna sytuacja jest w pakiecie 12. Zamawiający określił wymóg jak poniżej:

L.p.	Nazwa i opis produktu	Wymóg do spełnienia/ /Punktacja
A	B	B1
1.0	Stapler tnąco-zszyjący	

1.1	Stapler linowy z nożem	Tak
1.2	Długość linii szwu: 60-77 mm	Tak
1.3	Rozmiary (wysokość) otwartych zszywek: od 2.5 mm do 4.8 mm (wymagane zaoferowanie minimum trzech rozmiarów zszywek w podanym zakresie do swobodnego wyboru przez Zamawiającego w czasie trwania umowy)	Tak
1.4	Stapler z pierwotnie załadowanym ładunkiem (tj. nie wymaga włożenia ładunku przed zabiegiem)	Tak
1.5	Nóż zintegrowany ze staplerem bądź z ładunkiem - w przypadku noża zintegrowanego ze staplerem - wymagana blokada bezpieczeństwa w staplerze, w przypadku noża zintegrowanego z ładunkiem - wymagany system ochrony ostrza ładunku.	opisać rodzaj integracji i zabezpieczenia
1.6	Ładunek posiada minimum 4 rzędy zszywek	Tak
1.7	Zszywki ze stopu tytanu (wanadowo-aluminowego) zapewniającego większą odporność na wyginanie lub z drutu obustronnie spłaszczzonego zwiększającego szanse poprawnego zamknięcia	Tak
1.8	Wyrób medyczny jednorazowy	Tak
1.9	Wyrób medyczny jałowy	Tak
1.10	Opakowanie bezpośrednie: 1 szt./op.	Tak
1.11	Możliwość zakupu wyrobów na sztuki	Tak
1.12	Wyrób posiada naklejki do umieszczenia w dokumentacji zawierające informacje o dacie ważności oraz numerze serii oraz numerze ref lub nazwie i producencie (do jednoznacznej identyfikacji produktu) - minimum 2 sztuki	Tak
1.13	Wykonawca na prośbę Zamawiającego zapewni/przeprowadzi szkolenie z zakresu używania wyrobu	Tak
2.0	Ładunek do staplera tnąco-szyjącego	
2.1	Ładunki w pełni kompatybilne ze staplerem z pozycji 1.0	Tak
2.2	Ładunki spełniają parametry odnośnie rozmiarów i materiałów takie jak w staplerze z poz. 1.0	Tak

2.3	Wyrób medyczny jednorazowy	Tak
2.4	Wyrób medyczny jałowy	Tak
2.5	Opakowanie bezpośrednie: 1 szt./op.	Tak
2.6	Możliwość zakupu wyrobów na sztuki	Tak
2.7	Wyrób posiada naklejki do umieszczenia w dokumentacji zawierające informacje o dacie ważności oraz numerze serii oraz numerze ref lub nazwie i producencie (do jednoznacznej identyfikacji produktu) - minimum 2 sztuki	Tak
3.0	Stapler liniowy	
3.1	Stapler liniowy z częścią zszywającą na ramieniu, bez noża	Tak
3.2	Stapler tworzący prosty (tj. niewygięty) szew	Tak
3.3	Długość lini szwu: 30-45 mm	Tak
3.4	Rozmiary (wysokość) otwartych zszywek: od 3.5 mm do 4.8 mm (wymagane zaoferowanie minimum dwóch rozmiarów zszywek w podanym zakresie do swobodnego wyboru przez Zamawiającego w czasie trwania umowy, w tym - jeden rozmiar poniżej, a drugi powyżej 4.0 mm, a różnica między wymiarami na wynosić minimum 0.5 mm)	Tak
3.5	Stapler automatyczny (automatyczna regulacja docisku zszywek)	Tak
3.6	Stapler posiada dwie dźwignie - zamykającą i spustową. Dopuszcza się stapler posiadający jedną dźwignię o ile będzie wyposażony w blokadę uniemożliwiającą zamknięcie stablera bez ładunku (z wystrzelonym ładunkiem).	Tak
3.7	Zszywki ze stopu tytanu (wanadowo-aluminowego) zapewniającego większą odporność na wyginanie lub z drutu obustronnie spłaszczzonego zwiększającego szanse poprawnego zamknięcia	Tak
3.8	Wyrób medyczny jednorazowy	Tak
3.9	Wyrób medyczny jałowy	Tak
3.10	Opakowanie bezpośrednie: 1 szt./op.	Tak
3.11	Możliwość zakupu wyrobów na sztuki	Tak

3.12	Wyrób posiada naklejki do umieszczenia w dokumentacji zawierające informacje o dacie ważności oraz numerze serii oraz numerze ref lub nazwie i producencie (do jednoznacznej identyfikacji produktu) - minimum 2 sztuki	Tak
3.13	Wykonawca na prośbę Zamawiającego zapewni/przeprowadzi szkolenie z zakresu używania wyrobu	Tak
4.0	Ładunek do staplera liniowego	
4.1	Ładunki w pełni kompatybilne ze staplerem z pozycji 3.0	Tak
4.2	Ładunki spełniają parametry odnośnie rozmiarów i materiałów takie jak w staplerze z poz. 3.0	Tak
4.3	Wyrób medyczny jednorazowy	Tak
4.4	Wyrób medyczny jałowy	Tak
4.5	Opakowanie bezpośrednie: 1 szt./op.	Tak
4.6	Możliwość zakupu wyrobów na sztuki	Tak
4.7	Wyrób posiada naklejki do umieszczenia w dokumentacji zawierające informacje o dacie ważności oraz numerze serii oraz numerze ref lub nazwie i producencie (do jednoznacznej identyfikacji produktu) - minimum 2 sztuki	Tak
5.0	Stapler liniowy	
5.1	Stapler liniowy z częścią zszywającą na ramieniu, bez noża	Tak
5.2	Stapler tworzący prosty (tj. niewygięty) szew	Tak
5.3	Długość linii szwu: 60 mm	Tak
5.4	Rozmiary (wysokość) otwartych zszywek: od 3.5 mm do 4.8 mm (wymagane zaoferowanie minimum dwóch rozmiarów zszywek w podanym zakresie do swobodnego wyboru przez Zamawiającego w czasie trwania umowy, w tym - jeden rozmiar poniżej, a drugi powyżej 4.0 mm, a różnica między wymiarami na wynosić minimum 0.5 mm)	Tak
5.5	Stapler automatyczny (automatyczna regulacja docisku zszywek)	Tak




5.6	Stapler posiada dwie dźwignie - zamykającą i spustową. Dopuszcza się stapler posiadający jedną dźwignię o ile będzie wyposażony w blokadę uniemożliwiającą zamknięcie stablera bez ładunku (z wystrzelonym ładunkiem).	Tak
5.7	Zszywki ze stopu tytanu (wanadowo-aluminowego) zapewniającego większą odporność na wyginanie lub z drutu obustronnie spłaszczzonego zwiększającego szanse poprawnego zamknięcia	Tak
5.8	Wyrób medyczny jednorazowy	Tak
5.9	Wyrób medyczny jałowy	Tak
5.10	Opakowanie bezpośrednie: 1 szt./op.	Tak
5.11	Możliwość zakupu wyrobów na sztuki	Tak
5.12	Wyrób posiada naklejki do umieszczenia w dokumentacji zawierające informacje o dacie ważności oraz numerze serii oraz numerze ref lub nazwie i producencie (do jednoznacznej identyfikacji produktu) - minimum 2 sztuki	Tak
5.13	Wykonawca na prośbę Zamawiającego zapewni/przeprowadzi szkolenie z zakresu używania wyrobu	Tak
6.0	Ładunek do staplera liniowego	
6.1	Ładunki w pełni kompatybilne ze staplerem z pozycji 3.0	Tak
6.2	Ładunki spełniają parametry odnośnie rozmiarów i materiałów takie jak w staplerze z poz. 5.0	Tak
6.3	Wyrób medyczny jednorazowy	Tak
6.4	Wyrób medyczny jałowy	Tak
6.5	Opakowanie bezpośrednie: 1 szt./op.	Tak
6.6	Możliwość zakupu wyrobów na sztuki	Tak
6.7	Wyrób posiada naklejki do umieszczenia w dokumentacji zawierające informacje o dacie ważności oraz numerze serii oraz numerze ref lub nazwie i producencie (do jednoznacznej identyfikacji produktu) - minimum 2 sztuki	Tak

Zamawiający udzielił 21.03.2019 odpowiedzi potwierdzającej wymóg zaferowania poniższego sprzętu co zmienia opis przedmiotu zamówienia i ogranicza możliwość złożenia oferty na sprzęt który był pierwotnie wymogiem.


4. Dotyczy Pakietu 12. Czy Zamawiający wymaga staplera o poniższych parametrach?:

Lp.	Nazwa i opis produktu
A	B
1.0	Stapler tnąco-szyjący
1.1	Stapler linowy z nożem
1.2	Długość linii szwu: 61-81 mm
1.3	Jednorazowa rączka staplera liniowego z nożem wbudowanym w ładunek, umożliwiającą sekwencyjną regulację wysokości zszywek przeznaczonych do tkanki standardowej (1,5 mm po zamknięciu), pośredniej (1,8 mm po zamknięciu) i grubej (2 mm po zamknięciu). Stapler kompatybilny z ładunkiem
1.4	Stapler nie zafadowanym ładunkiem (tj. Wymaga włożenia ładunku przed zabiegiem)
1.5	Nóż zintegrowany ze staplerem - w przypadku noża zintegrowanego ze staplerem - wymagana blokada bezpieczeństwa w staplerze, wymagany system ochrony ostrza ładunku.
1.6	Ładunek posiada minimum 6 rzędów zszywek w technologii 3D

1.7	Zszywki ze stopu tytanu (wanadowo-aluminiowego) zapewniającego większą odporność na wyginanie.
1.8	Wyrób medyczny jednorazowy
1.9	Wyrób medyczny jałowy


 tel. sekretariat: (075)-75-37-201, tel. centrala: (075)-75-37-100
 fax: (075)-75-42-335
 e-mail: poczna@spoz.jgora.pl

WOJEWÓDZKIE CENTRUM SZPITALNE
KOTLINY JELENIOGÓRSKIEJ
 58 - 506 Jelenia Góra, ul. Ogińskiego 6
 NIP: 611-12-13-469, REGON: 000293640


**DOLNY
ŚLĄSK**

1.10	Opakowanie bezpośrednie: 3 szt./op.
1.11	Możliwość zakupu wyrobów na op.
1.12	Wyrób posiada jasne zgodne z przepisami oznaczenia opakowania producenta zawierające instrukcje w języku polskim, informacje o dacie ważności oraz numerze serii oraz numerze ref lub nazwie i producencie (do jednoznacznej identyfikacji produktu)
1.13	Wykonawca na prośbę Zamawiającego zapewni/przeprowadzi szkolenie z zakresu używania wyrobu
2.0	Ładunek do staplera tnąco-szyjącego
2.1	Ładunki w pełni kompatybilne ze staplerem z pozycji 1.0


2.2	Ładunki spełniają parametry odnośnie rozmiarów i materiałów takie jak w staplerze z poz. 1.0
2.3	Wyrób medyczny jednorazowy
2.4	Wyrób medyczny jałowy
2.5	Opakowanie bezpośrednie: 12 szt./op.
2.6	Możliwość zakupu wyrobów na op.
2.7	Wyrób posiada jasne zgodne z przepisami oznaczenia opakowania producenta zawierające instrukcje w języku polskim, informacje o dacie ważności oraz numerze serii oraz numerze ref lub nazwie i producencie (do jednoznacznej identyfikacji produktu)
3.0	Stapler liniowy
3.1	Stapler liniowy z częścią zszywającą na ramieniu, bez noża
3.2	Stapler tworzący prosty (tj. Niewygięty) szew
3.3	Długość lini szwu: 30 mm
3.4	Rozmiary ładunków: Jednorazowy ładunek w kolorze białym do automatycznego staplera liniowego o długości linii szwu 30 mm do tkanki naczyniowej. Wys. Zszywki 2,5 mm, po zamknięciu 1,0 mm. Zszywki wykonane ze stopu tytanu, ułożone naprzemiennie w trzy rzędy (12 szt./op.) ładunek w kolorze niebieskim do automatycznego staplera liniowego o długości linii szwu 30 mm do tkanki standardowej. Wys. Zszywki 3,5 mm, po zamknięciu 1,5 mm. Zszywki wykonane ze stopu tytanu. (12szt./op.) ładunek w kolorze zielonym do automatycznego staplera liniowego o długości linii szwu 30 mm do tkanki standardowej. Wys. Zszywki 4,8 mm, po zamknięciu 2,0 mm. Zszywki wykonane ze stopu tytanu. (12szt./op.)
3.5	Stapler automatyczny (automatyczna regulacja docisku zszywek)


3.6	Stapler posiada dwie dźwignie – zamykającą i spustową.
3.7	Zszywki ze stopu tytanu (wanadowo-aluminowego) zapewniającego większą odporność na wyginanie lub z drutu obustronnie spłaszczonego zwiększającego szanse poprawnego zamknięcia
3.8	Wyrób medyczny jednorazowy
3.9	Wyrób medyczny jałowy
3.10	Opakowanie bezpośrednie: 3 szt./op.
3.11	Możliwość zakupu wyrobów na opakowamia
3.12	Wyrób posiada jasne zgodne z przepisami oznaczenia opakowania producenta zawierające instrukcje w języku polskim, informacje o dacie ważności oraz numerze serii oraz numerze ref lub nazwie i producencie (do jednoznacznej identyfikacji produktu)
3.13	Wykonawca na prośbę Zamawiającego zapewni/przeprowadzi szkolenie z zakresu używania wyrobu
4.0	Ładunek do staplera liniowego
4.1	Ładunki w pełni kompatybilne ze staplerem z pozycji 3.0
4.2	Ładunki spełniają parametry odnośnie rozmiarów i materiałów takie jak w staplerze z poz. 3.0
4.3	Wyrób medyczny jednorazowy
4.4	Wyrób medyczny jałowy
4.5	Opakowanie bezpośrednie: 12 szt./op.
4.6	Możliwość zakupu wyrobów na opakowania
	Wyrób posiada jasne zgodne z przepisami oznaczenia opakowania producenta zawierające instrukcje w języku


pyt i odp 21-03-2019.ppt

file:///C:/Users/cwynam1/AppData/Local/Microsoft/Windows/NetCache/Content.Outlook/8QQLF850/pyt%20i%20odp%202021-03-2019.ppt

4.7	polskim, informacje o dacie ważności oraz numerze serii oraz numerze ref lub nazwie i producencie (do jednoznacznej identyfikacji produktu)
5.0	Stapler liniowy
5.1	Stapler liniowy z częścią zszywającą na ramieniu, bez noża
5.2	Stapler tworzący prosty (tj. Niewygięty) szew
5.3	Długość linii szwu: 60 mm


 tel. sekretariat: (075)-75-37-201, tel. centrala: (075)-75-37-100
 fax: (075)-75-42-335
 e-mail: poczta@spzoz.jgora.pl


**WOJEWÓDZKIE CENTRUM SZPITALNE
KOTLINY JELENIOGÓRSKIEJ**
 58 - 506 Jelenia Góra, ul. Ogińskiego 6
 NIP: 611-12-13-469, REGON: 000293640

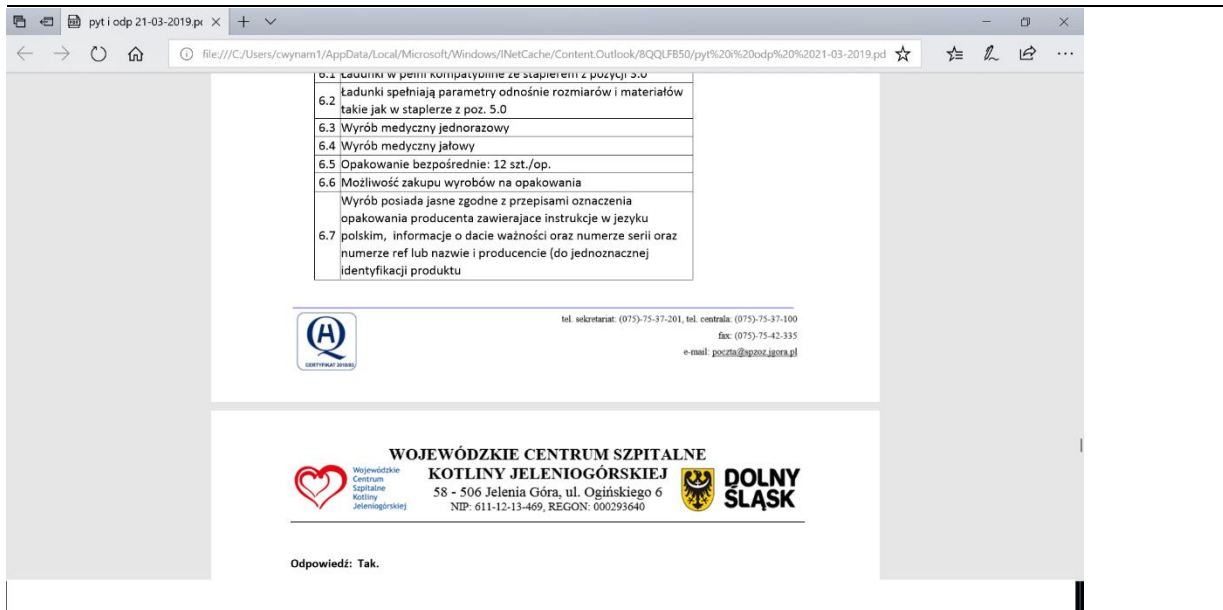

**DOLNY
ŚLĄSK**

5.4	Rozmiary ładunków : ładunek w kolorze niebieskim do automatycznego staplera liniowego o długości linii szwu 60 mm do tkanki standardowej. Wys. Zszywki 3,5 mm, po zamknięciu 1,5 mm.) ładunek w kolorze zielonym do automatycznego
-----	--

pyt i odp 21-03-2019.ppt

file:///C:/Users/cwynam1/AppData/Local/Microsoft/Windows/NetCache/Content.Outlook/8QQLF850/pyt%20i%20odp%202021-03-2019.ppt

5.4	ładunek w kolorze zielonym do automatycznego staplera liniowego o długości linii szwu 60 mm do tkanki standardowej. Wys. Zszywki 4,8 mm, po zamknięciu 2,0mm
5.5	Stapler automatyczny (automatyczna regulacja docisku zszywek)
5.6	Stapler posiada dwie dźwignie – zamykającą i spustową. Dopuszcza się stapler posiadający jedną dźwignię o ile będzie wyposażony w blokadę uniemożliwiającą zamknięcie stablera bez ładunku (z wystrzelonym ładunkiem).
5.7	Zszywki ze stopu tytanu (wanadowo-aluminowego) zapewniającego większą odporność na wyginanie.
5.8	Wyrób medyczny jednorazowy
5.9	Wyrób medyczny jałowy
5.10	Opakowanie bezpośrednie: 3szt./op.
5.11	Możliwość zakupu wyrobów na opakowania
5.12	Wyrób posiada jasne zgodne z przepisami oznaczenia opakowania producenta zawierające instrukcje w języku polskim, informacje o dacie ważności oraz numerze serii oraz numerze ref lub nazwie i producencie (do jednoznacznej identyfikacji produktu)
5.13	Wykonawca na prośbę Zamawiającego zapewni/przeprowadzi szkolenie z zakresu używania wyrobu
6.0	Ładunek do staplera liniowego
6.1	ładunki w pełni kompatybilne ze staplerem z pozycji 3.0
6.2	ładunki spełniają parametry odnośnie rozmiarów i materiałów takie jak w staplerze z poz. 5.0



Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie wymogu zaoferowania sprzętu w pakiecie 11 i 12 lub potwierdzenie, że wymóg określony w załączniku cenowym stanowiącym integralną część SIWZ jest nadal obowiązujący.

Odpowiedź: Podtrzymujemy odpowiedzi z dnia 21.03.2019 r. zmieniające SIWZ.

Zestaw 2:

1. **Dotyczy pakiet 12, pozycja 3.12; 4.7; 5.12; 6.7**
Czy Zamawiający dopuści wybór bez naklejek, ale wyrób posiada jasne zgodne z przepisami oznaczenia opakowania producenta zawierające instrukcje w języku polskim, informacje o dacie ważności oraz numerze serii oraz numerze ref lub nazwie i producencie (do jednoznacznej identyfikacji produktu)?

Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedziami z dnia 21.03.2019 r.

Zestaw 3:

Dotyczy: Pakiety nr 1, 2 i 3.

Prosimy o wyjaśnienie, czy Zamawiający podtrzymuje zawarty w SIWZ wymóg zaoferowania w tych pakietach klipsów pakowanych w magazynki po 4 sztuki, 6sztuk i 10 sztuk do swobodnego wyboru przez Zamawiającego w czasie trwania umowy.

Odpowiedź: Podtrzymujemy wymóg, że klipsy mogą być po 10 szt.



Wojewódzkie
Centrum
Szpitalne
Kotliny
Jeleniogórskiej

WOJEWÓDZKIE CENTRUM SZPITALNE

KOTLINY JELENIÓGÓRSKIEJ

58 - 506 Jelenia Góra, ul. Ogińskiego 6

NIP: 611-12-13-469, REGON: 000293640



**DOLNY
ŚLĄSK**

Pozostałe zapisy SIWZ utrzymują dotychczasowe brzmienie. Powyższe informacje stanowią integralną część warunków zamówienia i dotyczą wszystkich Wykonawców biorących udział w w/w postępowaniu. Wykonawca zobowiązany jest złożyć ofertę z uwzględnieniem powyższego.

Z poważaniem

z up. Dyrektora WCSKJ
Kierownik Działu Umów,
Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia
inż. Jerzy Świątkowski



tel. sekretariat: (075)-75-37-201, tel. centrala: (075)-75-37-100

fax: (075)-75-42-335

e-mail: poczta@spzoz.jgora.pl