



SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ W RADZIEJOWIE

ul. Szpitalna 3, 88-200 Radziejów
REGON 910333036 NIP 889-12-69-126
tel. 54/285-62-00; fax 54/285-37-01
e-mail: sekretariat@szpitalradziejow.pl
<https://www.szpitalradziejow.pl>

Radziejów, dnia 22.05.2024 r.

Do wszystkich zainteresowanych

Dotyczy udzielenia zamówienia publicznego realizowanego na podstawie ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2023 r., poz. 1605 ze zm.) w trybie podstawowym bez negocjacji na: **Dostawa odczynników i materiałów eksploatacyjnych oraz kalibratorów i materiałów kontrolnych dla analizatora oznaczeń immunochemicznych wraz z obsługą serwisową i dzierżawą analizatora**” (oznaczenie sprawy TP-05/2024) – ogłoszonego w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 15 maja 2024 r. pod numerem: **2024/BZP 00323910/01**

Niniejszym, na mocy przysługujących nam jako Zamawiającemu uprawnień i obowiązków wynikających z dyspozycji art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 ze zm.) poniżej przekazujemy treść zapytań i udzielonych wyjaśnień.


1. Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby w miejsce wymaganych procedur wykonywania badania (metodyk) oraz kart charakterystyki załączyć oświadczenie o posiadaniu tych dokumentów oraz ich dostawie na każde żądanie Zamawiającego? Jednocześnie Wykonawca poda w ofercie adres strony internetowej, na której znajdują się metodyki i karty charakterystyk, z której Zamawiający może stale korzystać.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza złożenie przedmiotowego środka dowodowego w postaci adresu strony internetowej w przypadku gdy jest on ogólnie dostępny, w innym wypadku przedmiotowe środki dowodowe należy dołączyć do oferty.

2. Oferowane analizatory oraz systemy wymagają do pracy stałego połączenia z internetem. Jest to związane z aktualizacją licencji oprogramowania, pobieraniem danych o odczynnikach, kontrolach, kalibratorach, serwisem zdalnym oraz połączeniem z LIS. Czy zamawiający udostępni w swoich zasobach dostęp do sieci lokalnej w celu zapewnienia integracji z LIS oraz dostępu do internetu ?

Wymagane jest połączenie z poniższymi serwerami na spacyfikowanych portach. Poniżej schemat połączeń rozwiązań diagnostycznych (analyzerów).

Odpowiedź: Tak

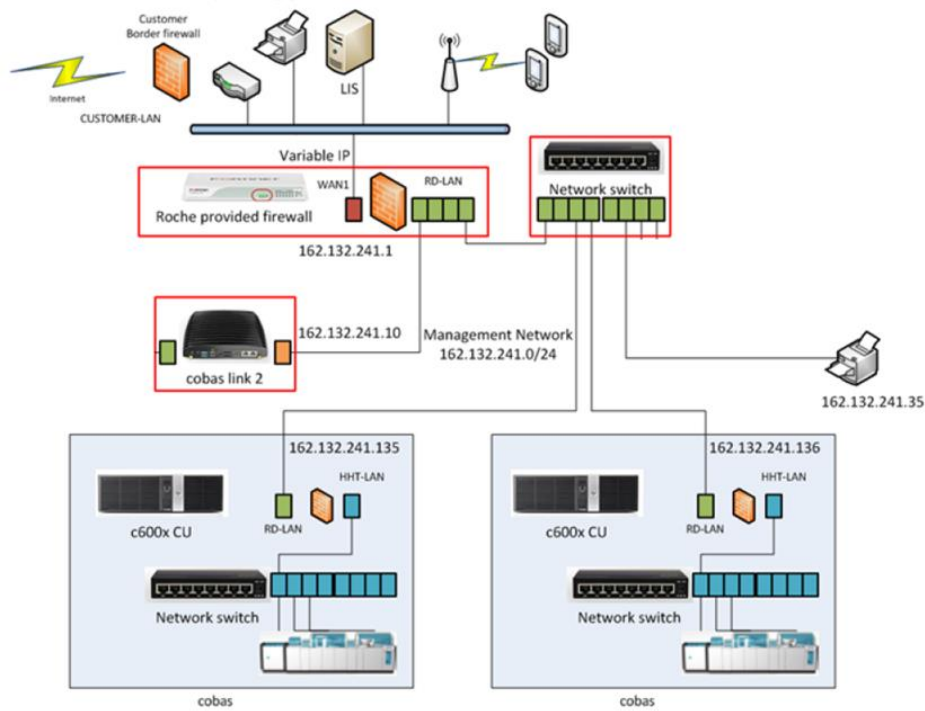

URL	IP	Port	Typ	Description
*.navify.com	193.58.155.0/24	443	CloudFlare	Main connections enabling Remote Service
*.navify.com	193.228.103.0/24	433 (514/541)	CloudFlare	Current/future setup using Cloudflare
remoteservice.roche.com	62.209.44.11	443	Direct	Dedicated connections enabling Remote Support
remoteservice-gas1.roche.com	62.209.44.21	443	Direct	Dedicated connections enabling Remote Support
remoteservice-gas2.roche.com	62.209.44.22	443	Direct	Dedicated connections enabling Remote Support
remoteservice-gas3.roche.com	209.202.167.19	443	Direct	Dedicated connections enabling Remote Support
remoteservice-gas4.roche.com	209.202.167.20	443	Direct	Dedicated connections enabling Remote Support
remoteservice-gas5.roche.com	120.136.45.231	443	Direct	Dedicated connections enabling Remote Support
remoteservice-gas6.roche.com	120.136.45.230	443	Direct	Dedicated connections enabling Remote Support
remoteservice-gas15.roche.com	35.76.193.4	443	Direct	Dedicated connections enabling Remote Support
remoteservice-gas16.roche.com	52.193.219.53	443	Direct	Dedicated connections enabling Remote Support
rln-cm-**.dia.roche.com	52.178.37.238	514 / 541	Direct	Dedicated connections enabling FortiGate management
teleservice.roche.com	196.3.50.39	443 / 80	HTTP	Dedicated connection to TSN
remoteservice-dr.roche.com	209.202.167.21	443	Direct	Axeda Disaster Recovery

3. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na składanie zamówień oraz na zgłaszanie reklamacji odczynników i awarii aparatu przez aplikację Wykonawcy (strona internetowa)? Uzasadnienie: Składanie zamówień, zgłaszanie reklamacji odczynników i awarii aparatu przez aplikację Wykonawca umożliwi Zamawiającemu przeglądanie historii wpisów, śledzenie statusu zgłoszeń i wysyłki zamówień.

Odpowiedź: Dopuszczamy, Zamawiający zastrzega sobie prawo do zgłaszania awarii sprzętu w sposób telefoniczny.

4. Ad pkt 9.: Identyfikacja odczynników za pomocą kodów kreskowych z monitorowaniem ilości odczynników w opakowaniu – Czy identyfikacja odczynników, nowsza technologicznie, za pomocą kodów RFID (drogą sygnału radiowego) będzie dopuszczona przez Zamawiającego.

Odpowiedź: Dopuszczamy

5. Ad 10.: Automatyczne otwieranie i zamykanie zestawów w rotorze odczynnikowym w celu eliminacji parowani : Czy analizator z systemem sept / osłon silikonowych zabezpieczających przed parowaniem , które osłaniają płyn po pobraniu przez system dozujący, będzie uznany za wystarczający co jest zapewnione przez producenta dopuszczającego przydatność odczynnika do użycia przez okres minimum 4 tygodni na pokładzie analizatora po pierwszym otwarciu.

Odpowiedź: Tak

6. Ad 13 : Czy materiał kontrolny wieloparametrowy , ale i w kilku przypadkach jak odczynniki do parametrów zakaźnych – dedykowany wyłącznie do danego odczynnika czy aCCP – będzie uznany za wystarczający przez Zamawiającego.

Odpowiedź: Tak

7. Ad 15 – mamy automatyczne rozcieńczenia – Prosimy o doprecyzowanie jaki procent /liczbę stanowią automatyczne rozcieńczenia w przypadku: zamawianych odczynników z oczywistym pominięciem FT3 i FT4

Odpowiedź: Zamawiający wymaga aby Wykonawca zaoferował aparat posiadający możliwość wykonywania automatycznych rozcieńczeń.

8. Pkt 5 - Czy zamawiający dopuści analizator wyposażony w tytanową igłę próbowko-reagentową pokrywaną teflonem oraz wyposażoną w wewnętrzny i zewnętrzny system mycia co niweluje ewentualną kontaminację pomiędzy oznaczeniami jednocześnie wpływając na zmniejszenie ilości odpadów plastikowych?

Odpowiedź: Dopuszcza.

9. Pkt 9 - Czy Zamawiający dopuści analizator, w którym odczynniki identyfikowane są za pomocą technologii RFID? Analizator monitoruje ilość dostępnych odczynników na pokładzie.

Odpowiedź: Dopuszcza.

10. Pkt 10 - Czy Zamawiający dopuści analizator, w którym kasyety odczynnikowe wyposażone zostały w silikonowe membrany zapobiegające odparowywaniu odczynnika?

Odpowiedź: Dopuszcza.

11. Pkt 12 – Czy Zamawiający dopuści rozwiązanie, w którym krzywa kalibracyjna zapisana jest w Chipie RFID kasyety odczynnikowej pozwalającym na szybkie wczytanie wszystkich informacji do analizatora?

Odpowiedź: Dopuszcza.

12. Pkt 13 – czy Zamawiający dopuści zestawy odczynnikowe z dedykowanymi kontrolami jakości do każdego parametru znajdującymi się w zestawach odczynnikowych?

Odpowiedź: Dopuszcza.

PYTANIA DO UMOWY:

1. par. 2 ust. 6 Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby dostarczone zostały dokumenty w formie elektronicznej (email, strona internetowa)?

Odpowiedź: Tak

2. par. 3 ust. 2 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zamianę słowa "dni" na "dni robocze"?

Odpowiedź: Tak

3. par. 3 ust. 3 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na składanie zamówień oraz na zgłaszanie reklamacji odczynników i awarii aparatu przez aplikację Wykonawcy (strona internetowa)? Uzasadnienie:

Składanie zamówień, zgłaszanie reklamacji odczynników i awarii aparatu przez aplikację Wykonawcy umożliwi Zamawiającemu przeglądanie historii wpisów, śledzenie statusu zgłoszeń i wysyłki zamówień, bez konieczności oczekiwania na potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia przez Wykonawcę.

Odpowiedź: Dopuszczamy, Zamawiający zastrzega sobie prawo do zgłaszania awarii sprzętu w sposób telefoniczny.

4. par. 4 ust. 8 Czy Zamawiający wyraża zgodę na przesyłanie faktur drogą elektroniczną i mógłby podać adres mailowy, na który można fakturę w tej formie wysłać?

Odpowiedź: Tak wyraża zgodę, adres mailowy na który należy przysyłać faktury wyszczególniony będzie w par. 3 ust 6 lit. a

5. par. 8 ust. 4 Czy Zamawiający wyraża zgodę na dodanie "do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody"? Ewentualnie dodanie: „wyłączona jest odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu utraconych korzyści”?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na modyfikację zapisów umowy w powyższym zakresie.

6. par. 8 ust. 5 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę niniejszego postanowienia tak, aby skorzystanie z zakupu interwencyjnego wykluczało zastosowanie kar umownych?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na modyfikację zapisów umowy w powyższym zakresie.

7. Czy Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację tego postanowienia poprzez dodanie w jego treści, że Zamawiający może skorzystać z prawa do zakupu interwencyjnego „po bezskutecznym upływie przynajmniej 5- dniowego dodatkowego terminu wyznaczonego Wykonawcy do realizacji zobowiązania”?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na modyfikację zapisów umowy w powyższym zakresie.

8. par. 10 ust. 10 W projekcie umowy, nie zawarto postanowień umownych, dotyczących zasad wprowadzania zmian wysokości wynagrodzenia należnego wykonawcy w przypadku zmiany ceny materiałów lub kosztów związanych z realizacją zamówienia. W związku z tym, że umowa, która zostanie zawarta w wyniku przetargu, ma być zawarta na okres dłuższy niż 6 miesięcy, postanowienia takie są wymagane przez art. 439 Prawa zamówień publicznych. Czy wobec powyższego postanowienia te zostaną wprowadzone do projektu umowy?

Poniżej dołączamy proponowane przez nas brzmienie postanowień zgodnych z art. 439 PZP.

1. Strony zobowiązują się dokonywać zmian wynagrodzenia należnego Wykonawcy z tytułu dostawy określonych w Umowie produktów (w szczególności odczynników, materiałów zużywalnych, części zamiennych) określonego w §4 Umowy oraz w załącznikach do niej („Waloryzacja”), w przypadku zmiany ceny materiałów lub kosztów związanych z realizacją zamówienia („Zmiana cen”).
2. Waloryzacja dokonywana będzie w oparciu o wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem w stosunku do kwartału poprzedniego, publikowany co kwartał przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego („GUS”) na podstawie art. 25 ust. 11 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych („Wskaźnik”).
3. Przyjmuje się, że Zmiana cen nastąpiła, jeżeli Wskaźnik osiągnął wartość większą lub równą 3%.
4. Przyjmuje się, że Zmiana cen wpływa na koszt wykonania Zamówienia odpowiednio do wysokości Wskaźnika, przy czym Waloryzacja następować będzie w wysokości wynoszącej połowę Wskaźnika.
5. Waloryzacja następować będzie co 3 miesiące, przy czym pierwsza waloryzacja nastąpi po 6 miesiącach od zawarcia Umowy.
6. W dniu, w którym zgodnie z ust. 5 następuje Waloryzacja, zmienia się wynagrodzenie w zakresie wskazanym w ust. 1, biorąc pod uwagę wartość Wskaźnika ostatnio opublikowaną przez Prezesa GUS, o ile wartość ta będzie większa lub równa wartości wskazanej w ust. 3. Odpowiednio zmienione zostają ceny poszczególnych pozycji załącznika asortymentowo-cenowego.
7. W razie potrzeby, przy wyliczaniu Waloryzacji, ceny zaokrągla się w dół do pełnych groszy.
8. W przypadku drugiej i kolejnych Waloryzacji, cenami wyjściowymi, które będą waloryzowane, będą ceny powstałe w wyniku poprzedniej Waloryzacji, z uwzględnieniem ewentualnych zmian jakie od czasu poprzedniej Waloryzacji zostały dokonane w drodze aneksów do Umowy.
9. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1, może się zmienić w wyniku zastosowania wszystkich Waloryzacji o maksymalnie 50% pierwotnej wartości Umowy.
10. Waloryzacja, o której mowa w niniejszym paragrafie nie wymaga aneksu do Umowy.
Po Waloryzacji, w razie potrzeby, Wykonawca przekaże Zamawiającemu załącznik asortymentowo-cenowy zmieniony zgodnie z niniejszym paragrafem.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że §10 ust.10 otrzymuje brzmienie:

Dopuszcza się możliwość zmiany umowy w stosunku do treści oferty Sprzedającego w następującym zakresie:

- a) zmiana cen na dostarczone towary może nastąpić w wyniku wzrostu stawki podatku VAT. Sprzedający ma obowiązek pisemnego poinformowania kupującego o zmianach stawek przed wystawieniem pierwszej faktury wg nowych stawek. Zmiana podatku VAT w trakcie trwania umowy jest dokonywana zgodnie z przepisami i nie powoduje zmiany cen jednostkowych netto,
- b) wydłużenie terminu realizacji umowy z chwilą niewykorzystania przez kupującego wartości umowy;
- c) Zgodnie z treścią art.439 ust.2 pkt.2 ustawy Pzp, Zamawiający przewiduje możliwość zmiany wynagrodzenia należnego Wykonawcy z tytułu dostawy określonych w Umowie produktów (w szczególności odczynników, materiałów zużywalnych, części zamiennych) określonego w §4 Umowy oraz w załącznikach do niej („Waloryzacja”), w przypadku zmiany ceny materiałów lub kosztów związanych z realizacją zamówienia („Zmiana cen”).
- d) Waloryzacja dokonywana będzie w oparciu o wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem w stosunku do kwartału poprzedniego, publikowany co kwartał przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego („GUS”) na podstawie art. 25 ust. 11 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych („Wskaźnik”).
- e) Przyjmuje się, że Zmiana cen nastąpiła, jeżeli Wskaźnik osiągnął wartość większą lub równą 3%.
- f) Przyjmuje się, że Zmiana cen wpływa na koszt wykonania Zamówienia odpowiednio do wysokości Wskaźnika, przy czym Waloryzacja następować będzie w wysokości wynoszącej połowę Wskaźnika.
- g) Waloryzacja następować będzie co 3 miesiące, przy czym pierwsza waloryzacja nastąpi po 6 miesiącach od zawarcia Umowy.
- h) W dniu, w którym zgodnie z ust. 5 następuje Waloryzacja, zmienia się wynagrodzenie w zakresie wskazanym w ust. 1, biorąc pod uwagę wartość Wskaźnika ostatnio opublikowaną przez Prezesa GUS, o ile wartość ta będzie większa lub równa wartości wskazanej w ust. 3. Odpowiednio zmienione zostają ceny poszczególnych pozycji załącznika asortymentowo-cenowego.
- i) W razie potrzeby, przy wyliczaniu Waloryzacji, ceny zaokrągla się w dół do pełnych groszy.
- j) W przypadku drugiej i kolejnych Waloryzacji, cenami wyjściowymi, które będą waloryzowane, będą ceny powstałe w wyniku poprzedniej Waloryzacji, z uwzględnieniem ewentualnych zmian jakie od czasu poprzedniej Waloryzacji zostały dokonane w drodze aneksów do Umowy.
- k) Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1, może się zmienić w wyniku zastosowania wszystkich Waloryzacji o maksymalnie 30% pierwotnej wartości Umowy.
- l) Waloryzacja, o której mowa w niniejszym paragrafie nie wymaga aneksu do Umowy. Po Waloryzacji, w razie potrzeby, Wykonawca prześle Zamawiającemu załącznik asortymentowo-cenowy zmieniony zgodnie z niniejszym paragrafem.

9. par. 11 ust. 5 Czy Zamawiający wyraża zgodę na zawarcie umowy w formie elektronicznej przy wykorzystaniu kwalifikowanego podpisu elektronicznego przez Wykonawcę?

Odpowiedź: Tak.

10. par. 12 Czy Zamawiający jako administrator danych osobowych, które mogą znajdować się na aparatach będących przedmiotem zamówienia i do których w związku z prawidłową realizacją obowiązków wynikających z umowy o udzielenie zamówienia publicznego, tj. przyłączenie do sieci, dokonywanie przeglądów, świadczenie usług serwisowych może mieć dostęp Wykonawca, wyrazi zgodę na zawarcie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych? Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych zawarta zostałaby z Wykonawcą jako procesorem wg załączonego wzoru.

Odpowiedź: Tak.

11. Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby w miejsce wymaganych procedur wykonywania badania (metryk) kart charakterystyki oraz wpisów do rejestru wyrobu medycznego lub potwierdzone zgłoszenia do rejestru wyrobu medycznego załączyć oświadczenie o posiadaniu tych dokumentów oraz ich dostawie na każde żądanie Zamawiającego? Jednocześnie Wykonawca poda w ofercie adres strony internetowej, na której znajdują się metryki i karty charakterystyk, z której Zamawiający może stale korzystać.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza złożenie przedmiotowego środka dowodowego w postaci adresu strony internetowej w przypadku gdy jest on ogólnie dostępny, w innym wypadku przedmiotowe środki dowodowe należy dołączyć do oferty.

Powyższe wyjaśnienia stają się integralną częścią specyfikacji warunków zamówienia i są dla Wykonawców wiążące. Pozostała treść specyfikacji pozostaje bez zmian.

.....
Podpis