



Dział Zamówień Publicznych  
SPS – V. 262.32.2024

Grodzisk Mazowiecki 25.06.2024 r.

**Wszyscy Wykonawcy**

## WYJAŚNIENIA I ZMIANY TREŚCI SWZ

**Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostaw materiałów szewnych dla Szpitala Zachodniego w Grodzisku Mazowieckim. Nr procedury: SPSSZ/29/D/24**


**Niniejszym Zamawiający, przekazuje treść zapytań/wniosek do treści SWZ, które wpłynęły do Zamawiającego i udziela odpowiedzi oraz dokonuje zmiany treści SWZ.**

### Pytanie nr 1

Czy Zamawiający dopuści w pakiecie 22?

Taśma do leczenia wysiłkowego nietrzymania moczu u kobiet . Wykonana z niewchłanialnego polipropylenu monofilamentowego. Parametry : 1,1 cm (+/-1mm) x 45 cm x 0,34 mm. Gramatura 45g/m kw. ; wielkość porów 1x1,25 mm. Taśma w plastikowej osłonce, brzegi zakończone pętelkami. Implantacja taśmy przez otwory zasłonowe .

W przypadku dopuszczenia i wyboru naszej oferty bezpłatnie użyczymy dwa narzędzia wielorazowego użytku wykonane z niekorodującego chromu. Ergonomiczne uchwyty.

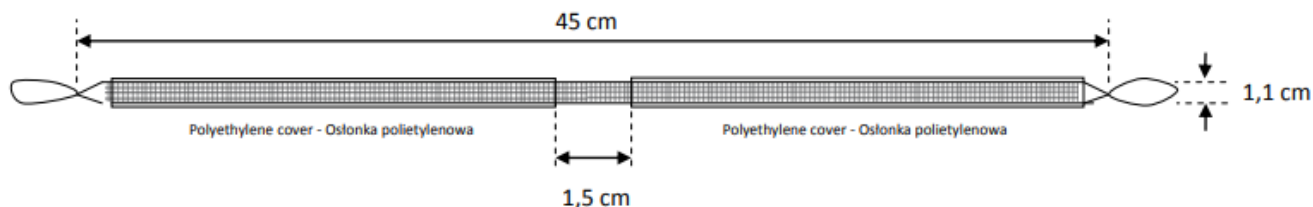

Niewielkie techniczne różnice nie wpływają na technikę operacyjną ani na oczekiwany, pożądany efekt terapeutyczny.

Zwracamy się z prośbą o przyjęcie oferty w powyższym składzie jako opcję/zamiennik -dzięki temu otrzymacie Państwo ofertę konkurencyjną, zyskując tym samym możliwość racjonalnego zarządzania środkami publicznymi.

Istniejący zapis pakietu wskazuje na zasoby danego Wykonawcy bez opcji złożenia oferty konkurencyjnej, co jest jednoznaczne z ograniczeniem konkurencji.

**Odpowiedź – Zgodnie z SWZ**

### Pytanie 2

Par. 2 ust. 10.1: czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby Poziom zmiany cen uprawniający strony umowy do złożenia wniosku żądania zmiany wynagrodzenia, wynosił nie mniej niż 7,5 % w stosunku do cen materiałów przyjętych w celu ustalenia wynagrodzenia Wykonawcy zawartego w ofercie?

**Odpowiedź: Zgodnie z SWZ**

### **Pytanie nr 3**

Pakiet 17: Czy zamawiający zgodzi się na siatki przepuklinowe o parametrach zbliżonych do wskazanych w opisie zamówienia? Proponujemy implant makroporowy monofilamentowy niewchłaniający siatka polipropylenowa masa 37 +/- 5 g/m<sup>2</sup>. Biokompatybilna. Grubość siatki 0,36 +/- 0.06 mm; wielkość porów ok. 3 mm kwadrat.

**Odpowiedź: Zgodnie z SWZ**

### **Pytanie nr 4 – dotyczy pakietu 2**

Pakiet 22: Czy zamawiający zgodzi się na implant o charakterystyce: taśma ultralekka 26 g/m<sup>2</sup> +/- 4 g, wykonana z polipropylenu monofilamentowego o grubości przędzy 0,08 mm, transparentna z niebieskimi liniami, całkowicie niewchłaniająca, dł. 450mm, szer.11mm (+/- 1mm), brzegi taśmy atraumatyczne, niewymagające plastikowej osłonki, porowatość 60%, mocowanie taśmy do narzędzia w postaci monofilamentowej kolorowej pętli na obu końcach taśmy, niewielka elastyczność pozwalająca na śródoperacyjną regulację. Taśma do metod TVT, TOT, TVT-O. Narzędzia dostępne wielorazowe, wypożyczone na czas trwania przetargu.

**Odpowiedź: Zgodnie z SWZ**

### **Pytanie nr 5**

#### Pakiet 17

Czy Zamawiający dopuści w pak. 17 w poz.1- 3 siatki chirurgiczne :

- gramatura siatki 50g/m<sup>2</sup>
- grubość siatki 0,41 mm
- wielkość porów 1x1,25 mm
- grubość pojedynczego włókna < 0,10 mm?

Rozmiary zgodnie z SWZ.

Rozmiary zgodnie z SWZ.

**Odpowiedź: Zgodnie z SWZ**

### **Pytanie nr 6**

Czy Zamawiający w pak 19 poz. 1 w miejsce pierwotnych zapisów wyrazi zgodę na złożenie oferty na oryginalny produkt znanego amerykańskiego producenta zgodnie z opisem: Stapler skórny jednorazowy z minimum 35 zszywkami, średnica drutu zszywki 0,58-0,60mm, wymiary zszywki po zamknięciu 6,5mm x 4,7mm, powlekane teflonem?

**Odpowiedź: Zgodnie z SWZ**

### **Pytanie nr 7**

Czy Zamawiający wydzieli z pak 19 poz. 1? Pozwoli to innym oferentom do dołączenia do postępowania.

**Odpowiedź: Zgodnie z SWZ**

### **Pytanie nr 8**

Czy Zamawiający dopuszcza w **pakiecie 3** poz. 2 grubość nitki 3 w miejsce 4 z igłą odwrotnie tnącą ½ koła 40mm? Pozostałe parametry zgodne z SWZ.

**Odpowiedź: Zgodnie z SWZ**

### **Pytanie nr 9**

Czy Zamawiający dopuszcza w pakiecie 5 poz.1 nitkę 70cm w miejsce 75cm?

Pozostałe parametry w tym igły zgodne z SWZ.

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza**

### Pytanie nr 10

Czy Zamawiający dopuszcza w **pakiecie 6** poz. 1 nitkę 70cm w miejsce 75cm?

Pozostałe parametry w tym igły zgodne z SWZ.

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza**

### Pytanie nr 11

Czy Zamawiający dopuszcza w **pakiecie 12 poz. 1-15, 17, 18** monofilament niewchłaniający. syntetyczny poliamid z wyłączeniem **poz. 16** polipropylen z lietylenem?

**Odpowiedź: W związku z omyłką pisarską Zamawiającego. Zamawiający poprawia ogólny opis dla przedmiotu zamówienia w Pakiecie 12. Zmiana dla Pakietu 12 w załączeniu do wyjaśnień /odpowiedzi.**

### Pytanie nr 12

Zwracamy się z pytaniem o sprostowanie ilości asortymentu z Pakietu 25.

**Pozycja 1.** W opisie przedmiotu zamówienia widnieje ilość 60 sztuk, w jedn miary 25 opakowań. Jaką ilość Oferent powinien zaoferować?

**Pozycja 2.** W opisie przedmiotu zamówienia widnieje ilość 60 sztuk w jedn miary 5 opakowań, nasz asortyment pakowany jest po 10 sztuk w 1 opakowaniu, jaką ilość Oferent powinien zaoferować?

**Pozycja 3.** W opisie przedmiotu zamówienia widnieje 40 sztuk, natomiast w jed miary 17 opakowań, która ilość jest dla Oferenta wiążąca?

**Odpowiedź:** Wykonawca błędnie wskazał Pakiet 25 dla zadawanego pytania, według treści zadanego pytania dotyczy to Pakietu 23.

Nie mniej jednak, Zamawiający udziela odpowiedzi na pytanie w ramach Pakietu 23.

Pozycja 1 - Zamawiający wymaga zaoferowania 25 opakowań wraz z zestawem do przygotowania 4 ml.

Pozycja 2 - Zamawiający wymaga zaoferowania 5 opakowań.

Pozycja 3 - Zamawiający wymaga zaoferowania 17 opakowań.

### Pytanie nr 13

Dotyczy pozycji 1 w Pakiecie 25

Czy zamawiający dopuści

Klej tkankowy fibrynowy:

Składnik 1: Roztwór białek klejących

-Fibrynogen ludzki (jako białko wykrzepiające) 91 mg/ ml

-Aprotynina (syntetyczna) 3000 KIU /ml

Składnik 2: Roztwór trombiny

Trombina rozpuszczona w roztworze chlorku wapnia

-Trombina ludzka 500 j.m./ ml

-Wapnia chlorek 40 umol / ml

Opakowanie zawierające roztwory w strzykawce PRIMA, dwukomorowej (polipropylenowej) zamkniętej korkiem i pakowanej w dwa worki wraz z przyrządem składającym się z 2 łączników i 4 igieł aplikacyjnych.

Preparat przechowywany w temperaturze  $\leq -20^{\circ}\text{C}$  Pojemność 4ml zamiennie z klejem tkankowym (zestaw do przygotowania dwuskładnikowego fibrynowego kleju do tkanek), do wyboru przez operatora.

**Odpowiedź:** Wykonawca błędnie wskazał Pakiet 25 dla zadawanego pytania, według treści zadanego pytania dotyczy to Pakietu 23.

Nie mniej jednak, Zamawiający udziela odpowiedzi na pytanie w ramach Pakietu 23 poz. 1

**Zgodnie z SWZ**

**Pytanie nr 14**Dot. Pakietu 1

Czy Zamawiający dopuści plecionkę wchłaniałną, powlekaną, syntetyczną, 50% kopolimer glikolidu i l-laktydu Poli (glikolid i l-laktyd 30/70) 50% stearynian wapnia, o zdolności podtrzymywania tkankowego po 14 dniach 75%, po 21 dniach 50%, wchłanianie całkowite 60-70 dni?

**Odpowiedź: Zgodnie z SWZ**

**Pytanie nr 15**Dot. Pakietu 1

Czy Zamawiający wszędzie tam gdzie wymaga długość nici 70 cm dopuści również długość 75 cm?

**Odpowiedź: Zgodnie z tolerancją zawartą w ogólnym opisie przedmiotu zamówienia dla pakietu 1 która wynosi 10 %. Cyt.: „..... Tolerancja długości nici 10%,.....”**

**Pytanie nr 16**Dot. Pakietu 1, poz. 31

Czy Zamawiający dopuści szew z igłą nie odczepianą?

**Odpowiedź: NIE. Zgodnie z SWZ**

**Pytanie nr 17**Dot. Pakietu 2

Czy Zamawiający dopuści plecionkę wchłaniałną, powlekaną, syntetyczną, 50% kopolimer glikolidu i l-laktydu Poli (glikolid i l-laktyd 30/70) 50% stearynian wapnia, o zdolności podtrzymywania tkankowego po 14 dniach 75%, po 21 dniach 50%, wchłanianie całkowite 60-70 dni, bez powleczenia chlorheksydyną?

**Odpowiedź: NIE. Zgodnie z SWZ**

**Pytanie nr 18**Dot. Pakietu 2

Czy Zamawiający wszędzie tam gdzie wymaga długość nici 70 cm dopuści również długość 75 cm?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza**

**Pytanie nr 19**Dot. Pakietu 3

Czy Zamawiający dopuści plecionkę niewchłaniałną, poliestrową, syntetyczną, powlekaną w całości silikonem?

**Odpowiedź: Zgodnie z SWZ**

**Pytanie nr 20**Dot. Pakietu 4

Czy Zamawiający dopuści plecionkę niewchłaniałną, poliestrową, syntetyczną, powlekaną silikonem?

**Odpowiedź: Zgodnie z SWZ**

**Pytanie nr 21**Dot. Pakietu 5

Czy Zamawiający dopuści Monofilament wchłaniałny, syntetyczny z kopolimeru kwasu glikolowego i kaprolaktonu, czas podtrzymywania tkankowego ok. 40% po 14 dniach, czas wchłaniania 90-120 dni?

**Odpowiedź: NIE. Zgodnie z SWZ**

**Pytanie nr 22**

Dot. Pakietu 7

Czy Zamawiający dopuści Szew syntetyczny, polipropylenowy, niewchłaniający, jednowłóknowy, bez katalogowego opisu „charakteryzujący się kontrolowanym rozciąganiem zapobiegającym nieumyślnemu zerwaniu szwu oraz plastycznym odkształceniem węzła zapobiegającym jego rozwiązaniu”?

**Odpowiedź: NIE. Zgodnie z SWZ**

**Pytanie nr 23**

**Dot. Pakietu 7, poz. 10**

Czy Zamawiający dopuści szew z igłą okrągłą z tnącym ostrzem (przypstrzoną)?

**Odpowiedź: Zgodnie z SWZ**

**Pytanie nr 24**

**Dot. Pakietu 7, poz. 11**

Czy Zamawiający dopuści szew z igłą odwrotnie tnącą kosmetyczną z precyzyjnym ostrzem typu micro-point?

**Odpowiedź: Zgodnie z SWZ**

**Pytanie nr 25**

Dot. Pakietu 12

Czy Zamawiający dopuści plecionkę wchłaniającą, powlekaną, syntetyczną, 50% kopolimer glikolidu i 1-laktydu Poli (glikolid i 1-laktyd 30/70) 50% stearynian wapnia, o zdolności podtrzymywania tkankowego po 14 dniach 75%, po 21 dniach 50%, wchłanianie całkowite 60-70 dni, bez powleczenia chlorheksydyną?

**Odpowiedź: W związku z omyłką pisarską Zamawiającego. Zamawiający poprawia ogólny opis dla przedmiotu zamówienia w Pakiecie 12. Zmiana dla Pakietu 12 w załączeniu do wyjaśnień /odpowiedzi.**

**Pytanie nr 26**

Dot. Pakietu 12, poz. 13

Czy Zamawiający dopuści szew z igłą odwrotnie tnącą kosmetyczną z precyzyjnym ostrzem typu micro-point?

**Odpowiedź: W związku z omyłką pisarską Zamawiającego. Zamawiający poprawia ogólny opis dla przedmiotu zamówienia w Pakiecie 12. Zmiana dla Pakietu 12 w załączeniu do wyjaśnień/odpowiedzi. Pozostałe wymagania bez zmian.**

**Pytanie nr 27**

Dot. Pakietu 17

Czy Zamawiający dopuści monofilamentową niewchłaniającą siatkę przepuklinową o masie 55 g/m<sup>2</sup>, grubość 0,55 mm oraz wielkość porów 1,3 x 2,0 mm?

**Odpowiedź: Zgodnie z SWZ**

**Pytanie nr 28**

Czy w celu miarkowania kar umownych Zamawiający dokona modyfikacji postanowień projektu przyszłej umowy w zakresie zapisów § 6 ust. 1:

1. Wykonawca płaci Zamawiającemu następujące kary umowne:

5) W przypadku wystąpienia sytuacji określonych w § 3 ust. 5 Zamawiający naliczy Wykonawcy karę umowną w wysokości 100 zł za każdy przypadek zakupu zastępczego.

**Odpowiedź: Zgodnie z SWZ**

**Pytanie nr 29****Odpowiedź: Zgodnie z SWZ**

Prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający akceptuje, że Wykonawca będzie przekazywał faktury VAT za pośrednictwem Platformy Elektronicznego Fakturowania, co będzie równoznaczne z realizacją przez Wykonawcę wszystkich wskazanych w projekcie umowy obowiązków w zakresie przekazania faktury VAT (zgodnie z przepisami ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno-privatnym)?

Powyższe postulaty zgodne są z art. 4 ust. 1 wspomnianej powyżej ustawy, na jego podstawie Zamawiający jest obowiązany do odbierania od Wykonawcy ustrukturyzowanych faktur elektronicznych przesłanych za pośrednictwem platformy.

**Odpowiedź: Zamawiający akceptuje, że Wykonawca będzie przekazywał faktury VAT za pośrednictwem Platformy Elektronicznego Fakturowania.**

**Pytanie nr 30**

Dotyczy Pakiet 7

Czy w Pakiecie 7, poz 11 Zamawiający dopuści szew z nicią o długości 45 cm spełniający wszystkie pozostałe wymagania SWZ?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza**

**Pytanie nr 31**

Dotyczy Pakiet 10

Czy w Pakiecie 10, poz 1 Zamawiający dopuści szew z igłą o długości 26 mm spełniający wszystkie pozostałe wymagania SWZ?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza**

**Pytanie nr 32**

„Czy Zamawiający w postępowaniu nr SPSSZ/29/D/24 w pakietach nr 13,14,15 i 16 ma na myśli konkretne parametry tj. rozmiary i krzywiznę igieł, długości nici, grubość szwu i kolor?”

**Odpowiedź: Zgodnie z SWZ**

**Pytanie nr 33**

Zamawiający w Formularzu cenowym nie przewidział kolumny na wpisanie nazwy i kodu poszczególnych nici. Jest to bardzo istotna informacja, także wniosimy o zmodyfikowanie formularza i zamianę kolumny "producent" na "Producent oraz nazwa asortymentu inr katalogowy".

**Odpowiedź: Zamawiający przychyła się do wniosku i w Formularzu cenowym – Załącznik nr 2 po zmianie w kolumnie nr 10 w pakietach od 1 do 25 nadaje tej kolumnie następujące brzmienie cyt.: „Producent, Nazwa oferowanego asortymentu, Numer katalogowy” i wymaga podania niniejszych informacji przez Wykonawców.**

**Pytanie nr 34**

Czy Zamawiający w Pakiet 17 - Siatki przepuklinowe 2 poz. 3 wymaga siatki o rozmiarze 30,5 x 30,5 cm. Pozostałe parametry bez mian.

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza**

## ZMIANY TREŚCI SWZ

### Zmiana 1

FORMULARZ CENOWY ZAŁACZNIK NR 2 PO ZMIANIE - W KOLUMNIE 10 DLA WSZYSTKICH PAKIETÓW OD 1 DO 25 – ZAMAWIAJĄCY UJEDNOLICA ZAKRES PODANIA WYMAGANYCH INFORMACJI PRZEZ WYKONAWCÓW JAK NIŻEJ.

Cyt.: „Producent, Nazwa oferowanego asortymentu, Numer katalogowy”

### Zmiana 2

**FORMULARZ CENOWY ZAŁACZNIK NR 2 PAKIET 1 W OGÓLNYM OPISIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ZAMAWIAJĄCY UZUPEŁNIA OPIS O CZĘŚĆ ZDANIA W ZAKRESIE cyt.: „..... o wytrzymałości węzła na rozciąganie, która wynosi w początkowym okresie ok. 140%, ...”**

#### Było:

Plecionka wchłaniałna zbudowana z mieszaniny pochodnych kwasu glikolowego i mlekowego, powlekana mieszaniną 50% kopolimeru glikolidu i l-laktydu Poli (glikolid i l laktyd w stosunku 30/70 lub 35/65) i 50% stearynian wapnia. Plecionka wchłaniałna potwierdzona badaniami. Zdolność podtrzymywania tkankowego po 14 dniach 75-80%, po 21 dniach 30-50% . Okres podtrzymywania 0% po 35 dniach, wchłanianie całkowite 56-70 dni. Tolerancja długości nici 10%, igieł : do 20 mm tolerancja 1 mm; 20-40 mm tolerancja 2 mm; > 40 mm tolerancja 5 mm

#### Jest po zmianie:

Plecionka wchłaniałna zbudowana z mieszaniny pochodnych kwasu glikolowego i mlekowego, powlekana mieszaniną 50% kopolimeru glikolidu i l-laktydu Poli (glikolid i l laktyd w stosunku 30/70 lub 35/65) i 50% stearynian wapnia. Plecionka wchłaniałna, o wytrzymałości węzła na rozciąganie, która wynosi w początkowym okresie ok. 140%, potwierdzona badaniami.

Zdolność podtrzymywania tkankowego po 14 dniach 75-80%, po 21 dniach 30-50% . Okres podtrzymywania 0% po 35 dniach, wchłanianie całkowite 56-70 dni. Tolerancja długości nici 10%, igieł : do 20 mm tolerancja 1 mm; 20-40 mm tolerancja 2 mm; > 40 mm tolerancja 5 mm.

### Zmiana 3

FORMULARZ CENOWY ZAŁACZNIK NR 2 PAKIET 12 W OGÓLNYM OPISIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ZAMAWIAJĄCY POPEŁNIŁ OMYŁKĘ PISARSKĄ W ZWIĄZKU Z CZYM POPRAWIA OGÓLNY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA NA cyt.: „Monofilament niewchłaniałny syntet. poliamid; pozycja 16 polipropylen z polietylenem lub polipropylen.”

#### Było:

Plecionka wchłaniałna, antybakteryjna powlekana 50% kopolimer glikolidu i l-laktydu Poli (glikolid i l-laktyd 30/70) 50% stearynian wapnia. Średnia wytrzymałość węzła na zerwanie w okresie początkowym ok. 135% potwierdzona badaniami. Okres podtrzymywania 25% po 28 dniach, wchłanianie całkowite 56-70 dni. Szew antybakteryjny powleczony chlorheksydyną.

#### Jest po zmianie:

Monofilament niewchłaniałny syntet. poliamid; pozycja 16 polipropylen z polietylenem lub polipropylen.

### Zmiana 4

W związku z powyższymi wyjaśnieniami/odpowiedziami i zmianami oraz z uwagi niedochowaniem ustawowego terminu na udzielenie wyjaśnień/odpowiedzi, niniejszym Zamawiający przedłuża termin składania ofert o czas niezbędny do zapoznania się przez wszystkich zainteresowanych wykonawców z wyjaśnieniami i zmianami niezbędnymi do należytego przygotowania i złożenia ofert na podstawie artykułu art. 284 ust. 3, Zamawiający dokonuje zmiany terminów związanych z przeprowadzeniem niniejszego postępowania do SWZ i w ogłoszeniu o zmianie.

***Było:***

**XI. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTA**

1. Wykonawca jest związany ofertą od dnia terminu składania ofert do dnia **25.07.2024** roku

**XII. TERMIN SKŁADANIA OFERT**

2. Ofertę wraz z wymaganymi załącznikami należy złożyć w terminie do dnia **26 czerwca 2024** roku do godziny 10:00.

**XIII. TERMIN OTWARCIA OFERT**

1. Otwarcie ofert nastąpi w dniu **26 marca 2024** roku o godzinie 10:05.

***Jest po zmianie:***

**XI. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTA**

1. Wykonawca jest związany ofertą od dnia terminu składania ofert do dnia **31.07.2024** roku

**XII. TERMIN SKŁADANIA OFERT**

2. Ofertę wraz z wymaganymi załącznikami należy złożyć w terminie do dnia **02 lipca 2024** roku do godziny 10:00.

**XIII. TERMIN OTWARCIA OFERT**

1. Otwarcie ofert nastąpi w dniu **02 lipca 2024** roku o godzinie 10:05.

***Zamawiający informuje, że niniejsze wyjaśnienia/odpowiedzi na pytanie oraz zmiany treści SWZ stają się integralną częścią Specyfikacji Warunków Zamówienia i są wiążące przy sporządzaniu i składaniu ofert.***

***Załącznik:***

***Formularz cenowy – Załącznik nr 2 po zmianie z dnia 25.06.2024 r.***

.....