

Sprawa ZP/06/2024

Wszyscy zainteresowani

Dotyczy: postępowania w trybie podstawowym na „ *Zakup i dostawy materiałów medycznych*” ogłoszonego w **Biuletynie Zamówień Publicznych pod nr 2024/BZP 00063246/01 z dnia 24.01.2024 r.**

Działając na podstawie art. 135 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r. poz. 1129) zwanej dalej ustawa Pzp Zamawiający: Wielospecjalistyczny Szpital w Ostrowcu Świętokrzyskim udostępnia treść zapytań wykonawców wraz z wyjaśnieniami zamawiającego:

Pytania do SIWZ:

Pakiet 17

1. Czy Zamawiający w pozycji 1 dopuści zaoferowanie worków laparoskopowych poj. 200 ml, do trokara 10mm, rozmiar worków 85 mm x 185 mm. Worki samorozprężające się po uwolnieniu dzięki izolowanej linie służącej do zaciągania worka po umieszczeniu w niej zawartości. Worki umieszczone w tubusie bez uchwytów ograniczających głębokość aplikacji.

Odp.: Zgodnie z SWZ.

2. Czy Zamawiający w pozycji 2 dopuści zaoferowanie staplerów skórnych z 35 zszywkami w rozmiarze 4,5mm x 6,5mm. Średnica drutu 0,6 mm.

Odp.: Zgodnie z SWZ.

3. Pakiet nr 26, pozycja 1

Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający wymaga myjki wykonanej z obu stron z włókniny 100g/m² (czyli łącznie 200 g)?

Odp.: Zamawiający dopuszcza.

4. Pakiet nr 26, pozycja 1

Czy Zamawiający wymaga myjki rękawicy o anatomicznym, zaokrąglonym kształcie (nie prostokątna), zwężana w nadgarstku, co zapobiega zsuwaniu się?

Odp.: Zamawiający dopuszcza.

5. Pakiet nr 26, pozycja 1

Czy Zamawiający wymaga myjki zgrzewanej termicznie, a nie zszywanej, dzięki czemu nie działa drażniąco na skórę pacjenta?

Odp.: Zamawiający dopuszcza.

6. Pakiet nr 26, pozycja 1

Czy Zamawiający wymaga, aby myjki można było stosować również u niemowląt, co wykonawca potwierdzi stosownym dokumentem?

Odp.: Tak.

7. Pakiet nr 26, pozycja 1

Czy Zamawiający w trosce o najwyższe standardy bezpieczeństwa pacjenta i personelu, wymaga, aby myjki (będące wyrobem kosmetycznym objętym 23% stawką VAT zgodnie z opinią Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych), posiadały wpis do europejskiego rejestru wyrobów kosmetycznych? Wpis produktu do europejskiego rejestru wyrobów kosmetycznych (CPNP) oznacza, że produkt i wszystkie składniki, zostały przetestowane pod względem bezpieczeństwa stosowania i jest gwarancją dla Zamawiającego, że użytkuje produkt sprawdzony i zarejestrowany zgodnie z obowiązującym prawem.

Odp.: Tak.

8. Pakiet nr 26, pozycja 2

Czy Zamawiający wymaga golarek medycznych pakowanych indywidualnie w tekturową osłonkę?

Odp.: Tak.

9. Pakiet nr 26, pozycja 2

Czy Zamawiający wymaga gołarek medycznych z pojedynczym ostrzem wykonanym ze stali nierdzewnej pokrytym platyną oraz teflonem?


Odp.: Zamawiający dopuszcza.

10. Pytanie 1 do pakietu 12 Czy Zamawiający rozważy możliwość rozszerzenia zakresu dopuszczalnych produktów, które spełniają te same funkcje lecznicze i użytkowe dla pacjenta:

Cewnik czasowy do hemodializ dwuświatłowy 12 F, wykonany z termoaktywnego poliuretanu, końcówka nieprzepuszczalna dla promieni rentgenowskich, zmniejszająca ryzyko urazu ściany naczynia, otwory boczne, końcówki luer oznaczone kolorami, nasadka barierowa ograniczająca przenoszenie drobnoustrojów, przewodnik z nitinolową końcówką w kształcie litery J z dozownikiem pokrętła zapewniającym łatwą kontrolę 0,35" x 70cm, igła wprowadzająca 18G x 7cm z zaworem bocznym pozwala na bezkrwawe wprowadzenie cewnika, rozszerzacz z powłoką hydrofilową 10Fr x 11cm, rozszerzacz z powłoką hydrofilową 12Fr x 14cm, strzykawka 5ml, skaplel, czapki wtryskowe

Dla pozycji 1 długość 15cm

Dla pozycji 2 długość 20cm



Odp.: Zgodnie z SWZ.

11. Pakiet 26, pozycja 1

Cz Zamawiający dopuści myjkę rękawicę o gramaturze

- przednia warstwa ze środkiem myjącym: 100g/m²
- tylna warstwa: 50g/m² ?

Odp.: Zamawiający dopuszcza.

Dotyczy pakietu nr 7, poz. 1.

12. Pyt. 1 - Prosimy o dopuszczenie produktu mikrobiologicznie czystego.

Odp.: Zgodnie z SWZ.

Dotyczy pakietu nr 7, poz. 2.

13. Pyt. 2 - Prosimy o dopuszczenie produktu mikrobiologicznie czystego.

Odp.: Zamawiający nie dopuszcza.

Dotyczy pakietu nr 7, poz. 3.

14. Pyt. 3- Prosimy o dopuszczenie zestawu z łącznikiem Y oraz łącznikiem kątowym, wyposażonym w port Luer Lock, zabezpieczonym zintegrowanym koreczkiem trzecia rura o dł. 80 cm. Worek w okolicy szyjki wewnątrz zaopatrzony w koszyczek zapobiegający sklejanemu się jego powierzchni, a na zewnątrz w silikonowy uchwyt.

Odp.: Zamawiający nie dopuszcza.

Dotyczy pakietu nr 7, poz. 4.

15. Pyt. 4 - Prosimy o dopuszczenie zestawu anestetycznego dla dzieci o długości 180 cm, wyposażonego w samodomykające się pułapki wodne, zakończone od strony pacjenta trójnikiem Y oraz łącznikiem kątowym z portem Luer Lock, zabezpieczonym zintegrowanym koreczkiem, ramię do worka o długości 110 cm, worek oddechowy bezlateksowy o pojemności 1l wraz z łącznikiem do worka. Worek w okolicy szyjki wewnątrz zaopatrzony w koszyczek zapobiegający sklejanemu się jego powierzchni, a na zewnątrz w silikonowy uchwyt.

Odp.: Zamawiający dopuszcza.

Dotyczy pakietu nr 7, poz. 5.

16. Pyt. 5 - Prosimy o dopuszczenie produktu mikrobiologicznie czystego.

Odp.: Zamawiający nie dopuszcza.

Wzór umowy

17. Pyt. 1 - Czy Zamawiający zgodzi się na skrócenie terminu płatności do 30 dni?

Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody.

18. Pytanie nr 1 - dotyczy Pakietu nr 28

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie niżej opisanego zestawu nieznacznie różniącego się od opisanego w SWZ?

Zestaw do operacji kończyny z osłoną na kończyne

2 taśmy przylepne 9-10 x 50 cm

1 wzmocniona osłona na stół Mayo 78-80 x 145-146 cm,

4 ręczniki do osuszania rąk 30-40 x 30-40 cm

1 osłona na kończyne **36x65 cm**

1 serweta dwuwarstwowa 150-160 x 190-200 cm

1 serweta do operacji kończyn **225** x 300- 320 cm z elastycznym otworem samouszczelniającym o średnicy 7-8 cm z padem chłonnym 50 x 50-100 cm i 2 organizatorami

1 serweta na stół do instrumentarium 150-160 x 190-200 cm,

Serweta do operacji kończyn z materiału trzywarstwowego o dużej chłonności i wysokiej odporności na przeniknięcie cieczy, gramatura 65g/m² + pad chłonny o gramaturze 55g/m². Produkt sterylny, pakowany w sposób gwarantujący aseptyczny sposób aplikacji zawartości pakietu. Materiał obłożenia musi spełniać wymogi normy PN-EN 13795

Opakowanie typu folia-papier. Na opakowaniu minimum 2 repozycjonowalne etykiety samoprzylepne zawierające min. numer katalogowy, serię, datę ważności oraz nazwę marki służące do archiwizacji danych. W dobrze widocznej części opakowania umieszczona etykieta pokazująca obrazkowo elementy wchodzące w skład zestawu oraz ich rozmiary. Na zestawie powinno być wyraźne oznaczenie kierunku rozkładania (system strzałek)

Odp.: Tak.

19. Pytanie nr 2 - dotyczy Pakietu nr 29

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie niżej opisanego zestawu nieznacznie różniącego się od opisanego w SWZ?

Zestaw do operacji żyłaków z wycięciem U

1 taśma przylepna min. 9 x 50 cm

1 wzmocniona osłona na stół Mayo 78-80 x do145-146 cm, wzmocnienie min. 65 x 85 cm

4 ręczniki do osuszania rąk min. 30,5 x 34 cm 1 przylepna serweta 70-75 x 90-95 cm

1 serweta **225**-240 x 260-270 cm z wycięciem „U” 20-25 x 100 cm z padem chłonnym min. 75 x 140 cm i organizatorami przewodów

1 przylepna serweta 150-160 x 240-250 cm z padem chłonnym min. 25 x 60 cm i organizatorami przewodów

1 serweta na stół do instrumentarium 150-160 x 190-200 cm, wzmocnienie min. 75 x 190 cm

Serwety z materiału minimum dwuwarstwowego o dużej chłonności i wysokiej odporności na przenikanie cieczy

Produkt sterylny, pakowany w sposób gwarantujący aseptyczny sposób aplikacji zawartości pakietu.

Materiał obłożenia musi spełniać wymogi normy PN-EN 13795

Opakowanie typu TYVEC/Folia. Na opakowaniu minimum 2 repozycjonowalne etykiety samoprzylepne zawierające min. numer katalogowy, serię, datę ważności oraz nazwę marki służące do archiwizacji danych. W dobrze widocznej części opakowania umieszczona etykieta pokazująca obrazkowo elementy wchodzące w skład zestawu oraz ich rozmiary. Na zestawie powinno być wyraźne oznaczenie kierunku rozkładania (system strzałek),

Odp.: Tak.

20. Pytanie nr 3 – dotyczy Pakietu nr 30

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie niżej opisanego zestawu nieznacznie różniącego się od opisanego w SWZ?

Zestaw do operacji ginekologicznych, jałowy wykonany z min. dwuwarstwowego, pełnobarierowego, nieprzemakalnego, niepyłającego laminatu (zgodność z normą EN 13795), gramatura w części podstawowej min.60g/m², Skład zestawu:

1 serweta na stół do instrumentarium 150 x 190 cm chłonna, nieprzemakalna , chłonna na powierzchni 75-80-185-190 cm

1 osłona na do instrumentarium 75-80 x 145-150 cm, wzmocniona w części roboczej 65x85cm, piaskowana , składana w sposób ułatwiający założenie z zachowaniem zasad aseptyki,

- organizator na przewody 2,5-30 cm

1 serweta ginekologiczna 60x120 z otworem 9x12 i torebką na płyny


1 serweta ginekologiczna 270/230x260 cm z otworem 24x21 cm zintegrowana z nogawicami min.2 ręczniki do rąk min. 30-40 x 30-40

Opakowanie typu folia-papier. Na opakowaniu minimum 2 repozycjonowalne etykiety samoprzylepne zawierające min. numer katalogowy, serię, datę ważności oraz nazwę marki służące do archiwizacji danych. W dobrze widocznej części opakowania umieszczona etykieta pokazująca obrazkowo elementy wchodzące w skład zestawu oraz ich rozmiary. Na zestawie powinno być wyraźne oznaczenie kierunku rozkładania (system strzałek).

Odp.: Nie.

21. Dotyczy zadania 28

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o wyrażenie zgody na zaoferowanie zestawu serwet



- 1 x niebieska osłona na stolik Mayo 80x145cm ze wzmocnieniem 60x145cm, składana teleskopowo
- 1 x serweta na stół instrumentariuszki 140x190cm, wzmocnienie 80x190cm
- 1 x serweta główna o wymiarach 200x320cm posiadająca elastometryczny, samouszczelniający otwór na nogę ø7, worek do przechwytywania płynów z zaworem spustowym i uchwyt („rzep”) do mocowania przewodów i drenów
- 1 x nieprzylepna serweta pod kończynę 150x150cm,
- 1 x osłona na kończynę 35x80cm,
- 2 x włókninowe taśmy samoprzylepne 9x50cm,
- 2 x ręczniki celulozowe wzmocniane nitką 30x40cm


składzie i parametrach jak poniżej:

Serwety z materiału dwuwarstwowego o dużej chłonności i wysokiej odporności na przeniknięcie cieczy, gramatura 62g/m². Produkt sterylny, pakowany w sposób gwarantujący aseptyczny sposób aplikacji zawartości pakietu. Materiał obłożenia spełnia wymogi normy EN 13795-1. Opakowanie typu folia-papier. Na opakowaniu 2 repozycjonowalne etykiety samoprzylepne zawierające min. numer katalogowy, serię, datę ważności oraz informację o producencie służące do archiwizacji danych. W dobrze widocznej części opakowania umieszczona etykieta pokazująca obrazkowo elementy wchodzące w skład zestawu oraz ich rozmiary. Na zestawie wyraźne oznaczenie kierunku rozkładania (system strzałek).

Odp.: Nie.

22. Dotyczy zadania 29

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o wyrażenie zgody na zaoferowanie zestawu serwet o składzie i parametrach jak poniżej:




- 1 x **osłona na stolik Mayo** 80x145cm ze wzmocnieniem 60x145cm, składana teleskopowo
- 1 x **serweta na stół instrumentariuszki** 140x190cm, wzmocnienie 80x190cm
- 1 x **serweta główna** 180x240cm, z samoprzylepnym wycięciem w kształcie "U" 7x65cm otoczonym wzmocnieniem na powierzchni 60x70cm
- 1 x **serweta przylepna** 200x240cm, ze wzmocnieniem 50x75cm, z przylepną taśmą na krótszym boku o wym. 5x90cm
- 1 x włókninowa **taśma samoprzylepna** 9x50cm,
- 1 x dwukomorowa foliowa, przylepna **kieszka na narzędzia** 30x40cm,
- 2 x **ręczniki celulozowe** wzmacniane syntetyczną nitką 30x40cm

Serwety z materiału dwuwarstwowego o dużej chłonności i wysokiej odporności na przeniknięcie cieczy, gramatura 62g/m². Produkt sterylny, pakowany w sposób gwarantujący aseptyczny sposób aplikacji zawartości pakietu. Materiał obłożenia spełnia wymogi normy EN 13795-1. Opakowanie typu folia-papier. Na opakowaniu 2 repositionowalne etykiety samoprzylepne zawierające min. numer katalogowy, serię, datę ważności oraz informację o producencie służące do archiwizacji danych. W dobrze widocznej części opakowania umieszczona etykieta pokazująca obrazkowo elementy wchodzące w skład zestawu oraz ich rozmiary. Na zestawie wyraźne oznaczenie kierunku rozkładania (system strzałek).

Odp.: Nie.

23. Dotyczy zadania 30

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o wyrażenie zgody na zaoferowanie zestawu serwet o składzie i parametrach jak poniżej:



- 1 x **serweta na stół instrumentariuszki** 140x190cm, wzmocnienie 80x190cm,
- 1 x **czerwona osłona na stolik Mayo** 80x145cm ze wzmocnieniem 60x145cm, składana teleskopowo
- 1 x **główna serweta** 250/312x290cm, ze zintegrowanymi nogawicami i przyklepnym oknem 9x12 cm oraz trójkątną torbą do zbiórki płynów o wym. 68x50cm z sitem, zaworkiem spustowym i kształtownikiem,
- 1 x nieprzyklepna **serweta pod pośladki** 75x90cm,
- 1 x włókninowa **taśma samoprzylepna** 9x50cm,
- 1 x **ręcznik celulozowy** 30x40cm wzmocnione syntetyczną nitką

Serwety z materiału dwuwarstwowego o dużej chłonności i wysokiej odporności na przeniknięcie cieczy, gramatura 62g/m². Produkt sterylny, pakowany w sposób gwarantujący aseptyczny sposób aplikacji zawartości pakietu. Materiał obłożenia spełnia wymogi normy EN 13795-1. Opakowanie typu folia-papier. Na opakowaniu 2 repositionowalne etykiety samoprzylepne zawierające min. numer katalogowy, serię, datę ważności oraz informację o producencie służące do archiwizacji danych. W dobrze widocznej części opakowania umieszczona etykieta pokazująca obrazkowo elementy wchodzące w skład zestawu oraz ich rozmiary. Na zestawie wyraźne oznaczenie kierunku rozkładania (system strzałek).

Odp.: Tak.

24. Zadanie 26, poz. 1 – Czy Zamawiający dopuści myjkę do mycia ciała o gramaturze 90g/m²?

Odp.: Zamawiający dopuszcza.

25. Zadanie 26, poz. 1 – Czy Zamawiający dopuści myjkę do mycia ciała o gramaturze 60g/m²?

Odp.: Zamawiający nie dopuszcza.

26. Zadanie 26, poz. 1 – Czy Zamawiający dopuści myjkę do mycia ciała pakowaną a'10sztuk z jednoczesnym przeliczeniem zamawianych ilości?

Odp.: Zamawiający dopuszcza.

27. Zadanie 26, poz. 1 – Czy Zamawiający dopuści myjkę do mycia ciała pakowaną a'12sztuk z jednoczesnym przeliczeniem zamawianych ilości?

Odp.: Zamawiający dopuszcza.

28. Zadanie 27 - Czy Zamawiający dopuszcza próbki niesterylne?

Odp.: Zamawiający nie dopuszcza.

29. Zadanie 27, poz. 1 – Czy Zamawiający dopuści serwetę przyklepną w rozmiarze 150x240cm w miejsce serwety 180-190cm x 200-240cm?

Odp.: Zamawiający dopuszcza.

30. Zadanie 27, poz. 1 – Czy Zamawiający dopuści zestaw w opakowaniu folia-papier?

Odp.: Zamawiający dopuszcza.

31. Zadanie 27, poz. 2 – Czy Zamawiający dopuszcza zestaw o poniższym składzie:

1 x Serweta chirurgiczna 75cm x 90cm 2-warstwowa, z centralnym otworem przyklepnym o śr. 7cm

1 x Serweta chirurgiczna 75cm x 90cm 2-warstwowa

10 x Kompres z gazy 13N 8W 7,5cm x 7,5cm

1 x Chwytnak plastikowy 14cm (Kocher, Pean)?

Odp.: Zamawiający dopuszcza.

32. Zadanie 27, poz. 2 – Czy Zamawiający dopuszcza opakowanie zestawu w rękaw papierowo-foliowy?

Odp.: Zamawiający dopuszcza.

33. Zadanie 27, poz. 2 – Czy Zamawiający dopuszcza etykietę umieszczoną w widocznym miejscu opisującą skład zestawu wraz z rozmiarami w formie listy?

Odp.: Zamawiający dopuszcza.

34. Zadanie 27, poz. 3 - Czy Zamawiający dopuszcza serwetę dwuwarstwową o wymiarach 150cm x 100 cm?

Odp.: Zamawiający dopuszcza, pod warunkiem zachowania parametru gramatury.

35. Zadanie 27, poz. 3 - Czy Zamawiający dopuszcza opakowanie zestawu w rękaw papierowo-foliowy?

Odp.: Zamawiający dopuszcza.

36. Zadanie 27, poz. 3 - Czy Zamawiający dopuszcza etykietę umieszczoną w widocznym miejscu opisującą skład zestawu wraz z rozmiarami w formie listy?

Odp.: Zamawiający dopuszcza.

37. Zadanie 28 - Czy Zamawiający dopuści zestaw o składzie:

- 1 x serweta z samouszczelniającym się otworem o średnicy 7 cm o wymiarach 230 cm x 300 cm, wzmocnienie o wymiarach 100 cm x 50 cm
- 4 x ręcznik chłonny o wymiarach 30 cm x 30 cm
- 3 x taśma samoprzylepna o wymiarach 10 cm x 50 cm
- 1 x elastyczna osłona na kończyne o wymiarach 22 cm x 75 cm
- 1 x wzmocniona osłona (serweta) na stolik Mayo o wymiarach 80 cm x 145 cm

2 x serweta wzmocniona na stół instrumentalny stanowiąca owinięcie zestawu o wymiarach 150 cm x 190 cm?

Odp.: Zamawiający nie dopuszcza.

38. Zadanie 28 - Czy Zamawiający dopuści opakowanie typu Header Bag z foliową wstawką TYVEC?

Odp.: Zamawiający dopuszcza.

39. Zadanie 28 - Czy Zamawiający dopuści serwetę główną wykonaną z chłonnego i nieprzemakalnego laminatu dwuwarstwowego o gramaturze 60 g/m² w strefie krytycznej wyposażoną we wzmocnienie wysokochłonne 80 g/m², zintegrowaną z dwoma podwójnymi organizatorami przewodów. Łączna gramatura w strefie krytycznej 140 g/m² ?

Odp.: Zamawiający dopuszcza.

40. Zadanie 30 - Czy Zamawiający dopuści zestaw o składzie:

- 1 x serweta o wymiarach 160/240 cm x 180 cm zintegrowana z osłonami na kończyne, z otworem samoprzylepnym w okolicy krocza o wymiarach 10 cm x 15 cm zintegrowana z torbą na płyny o wymiarach 35 x 50cm. W serwecie dodatkowa taśma samoprzylepna w rozmiarze 6cm x 38cm.
- 1 x serweta bez przylepca o wymiarach 75cm x 90cm wykonana z chłonnego i nieprzemakalnego laminatu dwuwarstwowego o gramaturze 56 g/m²
- 4 x ręcznik chłonny o wymiarach 30 cm x 30 cm
- 1 x taśma samoprzylepna o wymiarach 10 cm x 50 cm
- 1 x wzmocniona osłona (serweta) na stolik Mayo o wymiarach 80 cm x 145 cm

1 x serweta wzmocniona na stół instrumentalny stanowiąca owinięcie zestawu o wymiarach 150 cm x 190 cm?

Odp.: Zamawiający dopuszcza.

41. Zadanie 30 - Czy Zamawiający dopuści serwety wykonane z hydrofobowej włókniny trójwarstwowej typu SMS o gramaturze 50 g/m², w strefie krytycznej wyposażone we wzmocnienie wysokochłonne o gramaturze 80 g/m², zintegrowane z organizatorami przewodów?

Odp.: Zamawiający nie dopuszcza.

42. Zadanie 30 - Czy Zamawiający dopuści zestaw w opakowaniu TYVEC?

Odp.: Zamawiający dopuszcza.

43. Zadanie 31 - Czy Zamawiający dopuści osłonę na kończyne z 1 taśmą w komplecie oraz jedną pakowaną osobno?

Odp.: Zamawiający dopuszcza, pod warunkiem zachowania wymiarów podanych w SWZ.

44. Zadanie nr 2, pozycja 2

Czy Zamawiający dopuści balon 5-10ml?

Odp.: Zamawiający dopuszcza.

45. Zadanie nr 2, pozycja 3

Czy Zamawiający dopuści balon 30-50ml?

Odp.: Zamawiający dopuszcza.

46. Zadanie nr 2, pozycja 5

Czy Zamawiający dopuści cewniki Tiemana CH 6-24?

Odp.: Zamawiający dopuszcza.

47. Zadanie nr 2, pozycja 5

Czy Zamawiający dopuści cewniki Tiemana o powierzchni gładkiej, konektor kolorowy nieprzezroczysty?

Odp.: Zamawiający dopuszcza.

48. Zadanie nr 5, pozycja 1 i 2

Czy Zamawiający dopuści dreny tlenowe posiadające śladowe ilości ftalanów?

Odp.: Zamawiający nie dopuszcza.

49. Zadanie nr 5, pozycja 1 i 2

Czy Zamawiający dopuści dreny tlenowe sterylne?

Odp.: Zamawiający dopuszcza.

50. Zadanie nr 5, pozycja 2

Czy Zamawiający dopuści dreny tlenowe o długości 4,26m?

Odp.: Zamawiający dopuszcza.

51. Zadanie nr 13, pozycja 1-3

Czy Zamawiający dopuści wycenę za op.a'10szt. z odpowiednim przeliczeniem zamawianej ilości?

Odp.: Zamawiający dopuszcza.

52. Zadanie nr 15, pozycja 1, 2

Czy Zamawiający dopuści wycenę za op.a'100szt. z odpowiednim przeliczeniem zamawianej ilości?

Odp.: Zamawiający dopuszcza.

53. Zadanie nr 20, pozycja 6

Czy Zamawiający dopuści dreny T-Kehra 45x9x9?

Odp.: Zamawiający nie dopuszcza.

54. Zadanie nr 20, pozycja 7

Czy Zamawiający dopuści dreny Ulmera o długości 750mm, długość perforacji 120mm?

Odp.: Zamawiający dopuszcza.

55. Zadanie nr 20, pozycja 8

Czy Zamawiający dopuści butelki z nasadką umożliwiającą dopasowanie drenów Ch 8-16?

Odp.: Zamawiający nie dopuszcza.

56. Zadanie nr 20, pozycja 10

Czy Zamawiający dopuści długość drenu 210 cm lub 400cm?

Odp.: Zamawiający dopuszcza dren o długości 400 cm.

57. Zadanie nr 20, pozycja 12

Czy Zamawiający dopuści dren o długości 450mm?

Odp.: Zgodnie z SWZ.

58. Zadanie nr 20, pozycja 13

Czy Zamawiający dopuści dren o długości 340mm?

Odp.: Zgodnie z SWZ.

59. Zadanie nr 20, pozycja 13

Czy Zamawiający dopuści dren o długości 400mm?

Odp.: Zgodnie z SWZ.

60. Zadanie nr 20, pozycja 15

Czy Zamawiający dopuści cewnik do karmienia, skalowany, długość 500mm?

Odp.: Zamawiający nie dopuszcza.

61. Zadanie nr 22, pozycja 1 i 2

Czy Zamawiający dopuści kraniki w kolorze niebieskim?

Odp.: Zamawiający dopuszcza.

62. Zadanie nr 22, pozycja 1-3

Czy Zamawiający dopuści wycenę za op.a'50szt. z odpowiednim przeliczeniem zamawianej ilości?

Odp.: Zamawiający dopuszcza.

63. Zadanie nr 24, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści przyrządy wyposażone w filtr 0,1 µm, samozamykający się korek portu bez zastawki zwrotnej?

Odp.: Zgodnie z SWZ.

64. Czy Zamawiający w pozycji 1,2 pakiet 12 dopuści do postępowania cewnik dializacyjny dwuświatłowy wysokoprzepływowy (High Flow), z poliurteanu o średnicy 11 Fr i 13 Fr ramiona proste lub zagięte i długościach :

dla pozycji 1 - 15 cm, 17,5 cm

dla pozycji 2 - 20 cm?

Charakterystyka cewnika:

- termoplastyczny poliuretan Tecoflex
- radiocieniujący szaft cewnika
- końcówka bez bocznych otworów zmniejszająca ryzyko powstawania zakrzepu
- przednie otwory zmniejszające ryzyko powstawania zakrzepów
- obrotowy pierścień do szycia pozwalający uniknąć podrażnienia skóry
- zacisk bezpieczeństwa z zabezpieczeniami bocznymi chroniącymi rurkę końcówki przed wyslizgnięciem się
- wskaźniki wypełnienia, rozmiar i długość
- kompatybilny z MRI
- odporna na odkształcenia prowadnica „J” 0,98 mm x 700 mm/0,97 mm x 700 mm z wysoką zawartością tytanu zapewniająca wyjątkowo wysoką elastyczność i odporność na odkształcenia , dodatkowy komfort zapewnia powłoka z PTFE, która gwarantuje gładką powierzchnię i najwyższy poślizg
- igła wprowadzająca 18G
- rozszerzadło 11Fr/ 13 Fr
- nasadki iniekcyjne Luer Lock
- opakowanie zawiera 3 szt.

Odp.: Zgodnie z SWZ.

65. Pytanie 1

Dotyczy zapisów umowy § 5 ust. 5

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisu na następujący:

„Dostawca zobowiązuje się do nie zbywania osobie trzeciej długów Zamawiającego bez jego pisemnej zgody. Zgody takiej nie można bezpodstawnie odmówić.”

Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody.

66. Pytanie 2

Dotyczy zapisów umowy § 6 ust. 2

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisu na następujący:

„..., Zamawiający pozostawia go do dyspozycji Dostawcy z jednoczesnym pisemnym powiadomieniem o zaistniałym fakcie (e-mail lub fax)

Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody.

67. Pytanie 3

Dotyczy zapisów umowy § 6 ust. 3

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisu na następujący:

„..., w terminie 5 dni roboczych od dnia uznania reklamacji za zasadną”?

Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody.

68. Pytanie 4

Dotyczy zapisów umowy § 6 ust. 4

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisu na następujący:

„W przypadku niedokonania wymiany towaru reklamowanego na wolny od wad, a także w przypadku niezrealizowania zamówienia w wyznaczonym terminie, po wcześniejszym pisemnym wezwaniu Dostawcy do należytego wykonania umowy, Zamawiający może dokonać zakupu”?

Odp.: Zamawiający wyraża zgodę.

69. Pytanie 5

Dotyczy zapisów umowy § 7 ust. 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na obniżenie kary umownej z 10% na 7%?

Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody.

70. Pytanie 6

Dotyczy zapisów umowy § 7 ust. 2

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisu na następujący:

„..., nie stanowią podstawy uzasadniającej rozwiązanie umowy, o ile zaległości nie będzie większa niż 45 dni”?

Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody.

71. Pytanie 7

Dotyczy zapisów umowy

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie następującego zapisu i wprowadzenie go do umowy:

„Wykonawca ma prawo do wstrzymania realizacji kolejnych zamówień w przypadku zwłoki w płatnościach (należności wymagalnych) powyżej 30 dni od terminu płatności (wymagalności) wskazanego na fakturze”?

Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody.

72. Pytanie 8

Dotyczy zapisów umowy § 10 ust. 2

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisu na następujący:

„Zamawiający może wypowiedzieć niniejszą umowę, po wcześniejszym pisemnym wezwaniu do należytej realizacji umowy, szczególnie w przypadku:...”

Odp.: Zamawiający wyraża zgodę.

73. Pakiet 1 pozycja 1,2:

Czy zamawiający dopuści kaniulę neonatologiczną, która nie posiada systemu potwierdzenia wypływu krwi?

Odp.: Zamawiający nie dopuszcza.

74. Pakiet 22 pozycja 2:

Czy zamawiający dopuści kranik trójdrożny z pokrętłem w kolorze białym?

Odp.: Zamawiający dopuszcza.

75. Pakiet 24:

Czy zamawiający dopuści:

Przyrząd do wielokrotnego pobierania leków z fiolek wielodawkowych

Posiada filtr bakteryjny, łącznik Luer-Lock z zatyczką zapewniającą szybkie otwieranie i szczelne zamknięcie

Wyprofilowany uchwyt, ostro zakończony kolec.

Odp.: Zgodnie z SWZ.

76. Pakiet 21 pozycja 5

Prosimy zamawiającego o dopuszczenie osłony na głowice USG w rozmiarze 15cm x 61 cm, pozostałe zapisy zgodnie z SWZ.

Odp.: Zamawiający dopuszcza.

77. Pakiet 21 pozycja 11

Prosimy zamawiającego o potwierdzenie, czy zamawiający wymaga cewnik do żył centralnych pięciokanałowy 12F o średnicy światel cewnika 16G/18G/18G/18G/12G? Zamawiający podał średnice światel cewnika do cewnika trzykanałowego.

Odp.: Tak.

78. Pakiet 21 pozycja 13

Czy zamawiający dopuści zestaw do ciągłego odsysania powietrza lub płynów z opłucnej i klatki piersiowej zawierający

- cienkościenna kaniula punkcyjna z krótkim szlifem 3,35 x 78 mm
- cewnik (2,7 x 450 mm) wykonany z poliuretanu
- kontrastuje w promieniach RTG
- koreczek zamykający
- folia ochronna na cewniku
- podwójna zastawka antyrefluksowa z łącznikiem do cewnika
- kranik trójdrożny Discifix

Odp.: Dla pozycji 13 Zamawiający wymaga zestawu do płukania otrzewnej typu Peritofix.

79. Pakiet 7 poz. 3

Czy Zamawiający zgodzi się na obwód oddechowy rozciągliwy do maksymalnie 180 cm, spełniający pozostałe wymagania?

Odp.: Tak.

80. Pakiet 7 poz. 4

Czy Zamawiający zgodzi się na obwód z rurą dodatkową do worka rozciągliwą do maksymalnie 75 cm spełniający pozostałe wymagania?

Odp.: Nie.

Przedmiot zamówienia:

81. Zadanie nr 28: 33 344

Czy można zaoferować zestaw o następującym składzie:

1 serweta na stolik instrumentariuszki 150 cm x 190 cm

2 ręczniki 30 cm x 40 cm

1 serweta na stolik Mayo 80 cm x 145 cm wzmocniona 1 osłona ortopedyczna na kończynę 33 cm x 55 cm

1 taśma foliowa samoprzylepna 10 cm x 50 cm 1 serweta operacyjna 180 cm x 150 cm 1 serweta na

kończynę 225 cm x 320 cm z samouszczelniającym się otworem o średnicy 7 cm i dwoma

zintegrowanymi uchwytami do mocowania przewodów i drenów

Obłożenie pacjenta wykonane z laminatu dwuwarstwowego: włóknina polipropylenowa i folia

polietylenowa. Gramatura laminatu podstawowego 57 g/m² (+/-0,5g/m²). Wokół pola operacyjnego

polipropylenowa łąta chłonna. Całkowita gramatura laminatu podstawowego i łąty chłonnej 109 g/m²

(+/-0,5g/m²).

Oferowane obłożenie spełnia wymagania wysokie normy EN 13795-2019. Na opakowaniu znajdują się

min. 2 etykiety samoprzylepne zawierające wymagane dane oraz etykiety pokazujące obrazkowo

elementy wchodzące w skład zestawu i ich rozmiary. Na zestawach znajdują się wyraźne oznaczenie

kierunku otwierania w postaci strzałek.

Odp.: Nie.

82. Zadanie 29: 33 310

Czy można zaoferować zestaw o następującym składzie:

1 serweta na stolik instrumentariuszki 150 cm x 190 cm ze wzmocnieniem 190 x 7 5cm 2 ręczniki 30 cm x 40 cm

1 serweta na stolik Mayo 80 cm x 145 cm ze wzmocnieniem 75cm x 90cm

1 taśma samoprzylepna 9 cm x 50 cm

1 serweta samoprzylepna 75 cm x 90 cm

1 serweta samoprzylepna z wycięciem "U" wzmocniona 225 cm x 260 cm wycięcie 10 cm x 100 cm z padem chłonnym w rozmiarach 110cm x 50cm, serweta posiada pasek samoprzylepny zabezpieczony trzyczęściowym papierem silikonowanym, każda część zakończona fingerliftem o szerokości 2 cm w celu ułatwienia aplikacji

1 serweta samoprzylepna 150 cm x 240 cm, serweta posiada pasek samoprzylepny o szerokości 5cm zabezpieczony trzyczęściowym papierem silikonowanym, każda część zakończona fingerliftem o szerokości 2 cm w celu ułatwienia aplikacji

Zestaw pakowany sterylnie w opakowanie typu papier - folia.

Oferowane obłożenie spełnia wymagania wysokie normy EN 13795-2019. Na opakowaniu znajdują się min. 2 etykiety samoprzylepne zawierające wymagane dane oraz etykiety pokazujące obrazkowo elementy wchodzące w skład zestawu i ich rozmiary. Na zestawach znajdują się wyraźne oznaczenie kierunku otwierania w postaci strzałek.

Odp.: Nie.

83. Zadanie 30: 33 365

Czy można zaoferować zestaw o następującym składzie:

1 serweta na stolik instrumentariuszki 150 cm x 190 cm ze wzmocnieniem 190x75cm

2 ręczniki 30 cm x 40 cm

1 serweta na stolik Mayo 80 cm x 145 cm wzmocniona

1 taśma samoprzylepna 9 cm x 50 cm

1 serweta samoprzylepna (folia PE) 50 cm x 50 cm

1 serweta ginekologiczna wzmocniona 230 cm x 240/260 cm ze zintegrowanymi osłonami na kończyny dolne, z otworem na krocze 10 cm x 15 cm, ze zintegrowaną torbą na płyny z sitkiem i zaworem.

Serweta ginekologiczna wykonana z laminatu dwuwarstwowego: włóknina polipropylenowa i folia polietylenowa. Gramatura laminatu podstawowego 57 g/m² (+/-0,5/m²) ze wzmocnieniem wokół pola .Całkowita gramatura laminatu podstawowego i łąty chłonnej 109 g/ m² (+/-0,5g/ m²)

Oferowane obłożenie spełnia wymagania wysokie normy EN 13795-2019. Na opakowaniu znajdują się min. 2 etykiety samoprzylepne zawierające wymagane dane oraz etykiety pokazujące obrazkowo elementy wchodzące w skład zestawu i ich rozmiary. Na zestawach znajdują się wyraźne oznaczenie kierunku otwierania w postaci strzałek.

Odp.: Tak.

84. Zadanie 31: 33 107

Czy można zaoferować osłonę na kończynę w rozmiarach 33cm x 110cm?

Pozostałe parametry zgodne z wymogami s.w.z.

Odp.: Tak.

85. Zadanie 28: Czy można zaoferować zestaw z oddzielnie pakowanymi: 1 taśmą samoprzylepną oraz z 2 ręcznikami do osuszania rąk?

Odp.: Tak.

86. Zadanie 29:

Czy można zaoferować zestaw z oddzielnie pakowanymi : 2 ręcznikami do osuszania rąk oraz z 2 organizatorami przewodów?

Odp.: Tak.

87. Zadanie 30:

Czy można zaoferować zestaw z oddzielnie zapakowanym organizatorem przewodów 2,5x20/24cm?

Odp.: Tak.

Przedmiot zamówienia

ZADANIE NR 28

88. Poz. nr 1- czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania zestawu do operacji kończyny o następującym składzie:

1 x serweta na stół narzędziowy wzmocniona	150 x 190 cm
1 x serweta na stolik Mayo	80 x 145 cm
4 x ręczniki celulozowe	33 x 30 cm

2 x taśma przyklepna	10 x 50 cm
1 x serweta 2- warstwowa z padem chłonnym, U przyklepne 10 x 95 cm (pad z wiskozy)	245 x 280 cm
1 x serweta 2- warstwowa z padem chłonnym przyklepna	300 x 170 cm
1 x serweta 2- warstwowa nieprzyklepna	90 x 75 cm
1 x serweta na stół narzędziowy wzmocniona złożona	190 x 150 cm
1 x osłona na kończyne	35 x 120 cm

Serwety z materiału dwuwarstwowego o dużej chłonności i wysokiej odporności na przeniknięcie cieczy, gramatura min. 55g/m². Produkt sterylny, pakowany w sposób gwarantujący aseptyczny sposób aplikacji zawartości pakietu. Materiał obłożenia spełnia wymogi normy PN-EN 13795

Opakowanie typu papier-folia. Na opakowaniu minimum 2 rezykjonowalne etykiety samoprzylepne zawierające min. numer katalogowy, serię, datę ważności oraz informację o producencie służące do archiwizacji danych. Na opakowaniu nadrukowana etykieta główna pokazująca obrazkowo elementy wchodzące w skład zestawu oraz ich rozmiary

Odp.: Nie.

ZADANIE NR 29

89. Poz. nr 1- czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania zestawu do operacji żyłaków o następującym składzie:

1 x serweta na stół narzędziowy wzmocniona (opakowanie zestawu)	150 x 190 cm
1 x serweta na stolik Mayo (wzmocnienie min. 60 x 145 cm)	80 x 145 cm
4 x ręczniki celulozowe	33 x 30 cm
1 x taśma przyklepna	10 x 50 cm
1 x serweta 2- warstwowa z padem chłonnym, U przyklepne 15 x 95 cm (pad chłonny z wiskozy) bez organizatorów przewodów	200 x 260 cm
1 x serweta 2- warstwowa przyklepna bez organizatorów przewodów	250 x 170 cm
1 x serweta 2- warstwowa nieprzyklepna bez organizatorów przewodów	200 x 150 cm
1 x osłona 2- warstwowa krocza przyklepna	20 x 37,5 cm

Opakowanie typu papier-folia. Na opakowaniu minimum 2 rezykjonowalne etykiety samoprzylepne zawierające min. numer katalogowy, serię, datę ważności oraz informację o producencie służące do archiwizacji danych. Na opakowaniu nadrukowana etykieta główna pokazująca obrazkowo elementy wchodzące w skład zestawu oraz ich rozmiary

Odp.: Nie.

ZAPISY SWZ

PROJEKT UMOWY

90. § 6, ust. 4- wnosimy o modyfikację zapisów umowy poprzez wykreślenie zapisów w/w ustępu i zastąpienie ich następującymi:

„W przypadku stwierdzenia przez Wykonawcę braku towaru, objętego danym zamówieniem, skutkującego brakiem możliwości zrealizowania konkretnego zamówienia, Wykonawca będzie uprawniony do dostarczenia Zamawiającemu wyrobów medycznych równoważnych do tych, które zostały wskazane w zamówieniu. W przypadku, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, Wykonawca będzie zobowiązany do wskazania zamiennego wyrobu medycznego w terminie 24 godzin od momentu złożenia zamówienia przez Zamawiającego“

Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody.

91. § 7, ust. 1- wnosimy o zmianę zapisów umowy dotyczących zastrzegania kar umownych i obniżenie ich wysokości do kwoty 5% wartości niezrealizowanej części umowy,

Należy się zgodzić ze stanowiskiem Sądu Najwyższego, który traktuje karę umowną wprowadzoną do umowy w ramach swobody kontraktowania, jako tę której celem jest zapewnienie skuteczności więzi powstałej między stronami w ramach zawartej umowy, a także służy realnemu wykonaniu zobowiązań (Wyrok SN z 08.08.2008 r., V CSK 85/08, LEX nr 457785). Tenże zaznacza jednak, że „W sytuacji, gdy

kara umowna równa się bądź zbliżona jest do wysokości wykonanego z opóźnieniem zobowiązania, w związku z którym ją zastrzeżono, można ją uważać za rażąco wygórowaną” (Wyrok SN z 20.05.1980 r., I CR 229/80, LEX nr 2534), także wtedy kara umowna może zostać uznana za rażąco wygórowaną, gdy „w zastrzeżonej wysokości jawić się będzie jako nieadekwatna” (Wyrok SA w Katowicach z 17.12.2008 r., V ACa 483/08, LEX nr 491137). Kara umowna ma na celu zdyscyplinowanie wykonawcy, jednakże określenie jej przez Zamawiającego na rażąco wysokim poziomie prowadzi do naruszenia zasady współzycia społecznego i powoduje nadmierną nierówność stron.
Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody.

Specyfikacja Warunków Zamówienia, rozdział XI

92. Dotyczy pakietu nr 8 - Artykuły medyczne specjalistyczne

Pytanie nr 1. Prosimy Zamawiającego o odstąpienie od możliwości zażądania próbek materiałów medycznych będących przedmiotem postępowania celem sprawdzenia zgodności zaoferowanego asortymentu z opisem zawartym w SWZ w przypadku zaoferowania wyrobów medycznych rekomendowanych przez producenta respiratora OSIRIS.

W przypadku zaoferowania wyrobów rekomendowanych i w pełni kompatybilnych z urządzeniami prod. Air Liquide Medical Systems nie zachodzi ryzyko dostarczanie niekompatybilnego asortymentu. Ponadto, oryginalny asortyment jest znany Zamawiającemu z uwagi na to, iż był dostarczany w latach ubiegłych.

Odp.: Tak.

Załącznik nr 1 do SWZ - Przedmiot zamówienia

93. Dotyczy pakietu nr 8 - Artykuły medyczne specjalistyczne

Pytanie nr 2. Czy Zamawiający oczekuje zaoferowania układu oddechowego jednoramiennego o długości 180cm z zastawką wydechową?

Odp.: Tak.

Załącznik nr 1 do SWZ - Przedmiot zamówienia

94. Dotyczy pakietu nr 8 - Artykuły medyczne specjalistyczne

Pytanie nr 3. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dostarczenie układów oddechowych w oryginalnym zbiorczym opakowaniu producenta zawierającym 20 sztuk układów oddechowych (1 op. = 20szt.)? Zwracamy uwagę, iż dostawa asortymentu na sztuki znacząco podniesie cenę oferty z uwagi na konieczność przepakowania asortymentu oraz kalkulację kosztów transportu oszacowaną dla każdego układu osobno.

Odp.: Tak.

Pytania dot. przedmiotu zamówienia:


95. Zadanie 27, poz. 1:

Pakiet 13: Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania zestaw o składzie:

- 1 SZT. Serweta dwuwarstwowa polipropylenowo-polietylenowa o gramaturze 56g/m² 240X150CM Z PRZYLEPCEM 60CM
- 1 SZT. Serweta dwuwarstwowa polipropylenowo-polietylenowa o gramaturze 56g/m² 180X170CM Z PRZYLEPCEM 60CM
- 2 SZT. Serweta dwuwarstwowa polipropylenowo-polietylenowa o gramaturze 56g/m² 90X75CM Z PRZYLEPCEM 60CM
- 2 SZT. KOMPRES WŁÓKNINOWY 40G 4W 10X20CM
- 1 SZT. POKROWIEC PE NA STOLIK MAYO PROSTOKĄT 145X80CM 24GSM 50MIC Z WARSTWĄ CHŁONNĄ 76X85CM NIEBIESKI
- 1 SZT. SERWETA NA STÓŁ INSTRUM 190X150CM
- 1 SZT. TAŚMA MEDYCZNA BP 9X50CM PRZYLEPNA

Opakowanie typu blister. Na opakowaniu minimum 2 repozycjonowalne etykiety samoprzylepne zawierające min. numer katalogowy, serię, datę ważności oraz informację o producencie służące do archiwizacji danych. W dobrze widocznej części opakowania umieszczona etykieta pokazująca

obrazkowo elementy wchodzące w skład zestawu oraz ich rozmiary.




Odp.: Tak.

96. Zadanie 27, poz. 2:

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania zestaw o składzie:

- Serweta włókninowa FB 42g/m² w rozmiarze 75x75 cm - 1 sztuka
- Serweta SMS o gramaturze 35g/m² w rozmiarze 80cmx60cm z otworem o średnicy 8 cm z przyklepcem - 1 sztuka
- Kompresy gazowe 7,5x7,5 cm - 7 sztuk
- Kleszczyki plastikowe pean 13 cm - 1 sztuka

Opakowanie typu torebka papierowo-foliowa. Zestaw posiada etykietę typu TAG składającą się z części nieusuwalnej, na której znajduje się m.in. nazwa wyrobu, skład zestawu, informacja dodatkowa, rejestracja zagraniczna, indeks wyrobu; dwóch elementów - naklejek, które można bez naruszania struktury całej etykiety odkleić z opakowania i wkleić do dokumentacji bloku operacyjnego i dokumentacji pacjenta. Na naklejkach znajduje się: indeks wyrobu, numer lot, data ważności, identyfikacja producenta. W dobrze widocznej części opakowania umieszczona etykieta pokazująca obrazkowo elementy wchodzące w skład zestawu oraz ich rozmiary.




Odp.: Tak.

97. Zadanie 27, poz. 3:

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania zestaw o składzie:

- Serweta włókninowa 80x60 cm - 1 sztuka
- Serwetka włókninowa 30x30 cm - 6 sztuk
- Kompres z gazy 17 nitek 8 warstw 10x10 cm - 20 sztuk
- Serweta z gazy 17nitkowa 4warstwowa z nitką RTG oraz tasiemką - 2 sztuki
- Zacisk plastikowy do pępowiny 5,5 cm - 1 sztuka
- Serweta dwuwarstwowa polipropylenowo-polietylenowa o gramaturze 56g/m² 150x90cm - 1 sztuka
- Fartuch chirurgiczny wzmocniony rozmiar XL - 1 sztuka
- Podkład chłonny 60x60 cm - 1 sztuka
- Podkład chłonny 60x90 cm - 1 sztuka

Zestaw zapakowany w opakowanie typu torebka papierowo-foliowa. Zestaw posiada etykietę typu TAG składającą się z części nieusuwalnej, na której znajduje się m.in. nazwa wyrobu, skład zestawu, informacja dodatkowa, rejestracja zagraniczna, indeks wyrobu; dwóch elementów - naklejek, które można bez naruszania struktury całej etykiety odkleić z opakowania i wkleić do dokumentacji bloku operacyjnego i dokumentacji pacjenta. Na naklejkach znajduje się: indeks wyrobu, numer lot, data ważności, identyfikacja producenta. W dobrze widocznej części opakowania umieszczona etykieta pokazująca obrazkowo elementy wchodzące w skład zestawu oraz ich rozmiary.

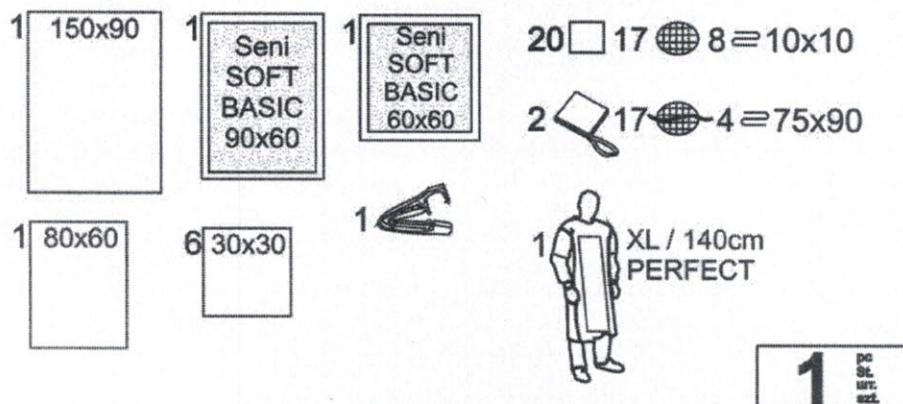


Odp.: Tak.

98. Zadanie 30, poz. 1:

Czy Zamawiający dopuści do zaferowania zestaw jałowy wykonany z min. dwuwarstwowego, pełnobarierowego, nieprzemakalnego, niepyłącego laminatu (zgodność z normą EN 13795), o składzie:

- Serweta dwuwarstwowa polipropylenowo-polietylenowa o gramaturze 56g/m² w rozmiarze 245cmx180cm z otworem przylepnym 15cmx10cm wyposażona w zintegrowane nogawice oraz worek na płyny - 1 sztuka
- Serweta dwuwarstwowa polipropylenowo-polietylenowa o gramaturze 56g/m² w rozmiarze 90cmx75cm - 1 sztuka
- Serwetki celulozowe w rozmiarze 40cmx30cm - 4 sztuki
- Serweta na stół instrumentarium 190cmx150cm nieprzemakalna, wzmocnienie w rozmiarze 190x66 cm - 1 sztuka
- Taśma medyczna przylepna 50cmx9cm - 1 sztuka

Zestaw zapakowany w opakowanie typu torebka papierowo-foliowa i opakowanie zbiorcze typu dispenser. Zestaw posiada etykietę typu TAG składającą się z części nieusuwalnej, na której znajduje się m.in. nazwa wyrobu, skład zestawu, informacja dodatkowa, rejestracja zagraniczna, indeks wyrobu; dwóch elementów - naklejek, które można bez naruszania struktury całej etykiety odkleić z opakowania i wkleić do dokumentacji bloku operacyjnego i dokumentacji pacjenta. Na naklejkach znajduje się: indeks wyrobu, numer lot, data ważności, identyfikacja producenta. W dobrze widocznej części opakowania umieszczona etykieta pokazująca obrazkowo elementy wchodzące w skład zestawu oraz ich rozmiary.



Odp.: Tak.

99. **Pakiet nr 2, pozycja nr 1** – Czy zamawiający dopuści standardowy cewnik foley z zakończeniem typu nelaton z dwoma otworami bocznymi z balonikiem uszczelniającym, z drugiej strony z rozwidleniem. Jedna końcówka z możliwością podłączenia strzykawki typu luer / luer lock, druga końcówka prosta do podłączenia worka na mocz z opisem rozmiaru/pojemności balona. Opakowanie podwójne: wew folia, zew papier folia?

Odp.: Zamawiający dopuszcza.

100. **Pakiet nr 2, pozycja nr 2** – Czy zamawiający dopuści standardowy cewnik foley z zakończeniem typu nelaton z dwoma otworami bocznymi z balonikiem uszczelniającym, z drugiej strony z rozwidleniem. Jedna końcówka z możliwością podłączenia strzykawki typu luer / luer lock, druga końcówka prosta do podłączenia worka na mocz z opisem rozmiaru/pojemności balona. Opakowanie podwójne: wew folia, zew papier folia?

Odp.: Zamawiający dopuszcza.

101. **Pakiet nr 2, pozycja nr 2** – Czy zamawiający dopuści foley bez rozmiaru ch 26?

Odp.: Zamawiający dopuszcza.

102. **Pakiet nr 2, pozycja nr 3** – Czy zamawiający dopuści cewnik foley w rozmiarach ch20-ch24 z balonem 5-15ml?

Odp.: Zamawiający nie dopuszcza.

103. **Pakiet nr 2, pozycja nr 5** – Czy zamawiający dopuści cewnik z całkowicie barwnym konektorem w rozmiarach ch8-ch24? Bez rozmiaru ch26.

Odp.: Zamawiający dopuszcza.

104. **Pakiet nr 2, pozycja nr 6** – Czy zamawiający dopuści cewnik z całkowicie barwnym konektorem?

Odp.: Zamawiający dopuszcza.

105. **Pakiet nr 5, pozycja nr 1- 2** – Czy zamawiający dopuści dren sterylny?

Odp.: Zamawiający dopuszcza.

106. **Pakiet nr 5, pozycja nr 1- 2** – Czy zamawiający dopuści śladowe ilości ftalanów?

Odp.: Zamawiający nie dopuszcza.

107. **Pakiet nr 5, pozycja nr 2** – Czy zamawiający dopuści dren o długości 426cm?

Odp.: Zamawiający dopuszcza.

108. **Pakiet nr 7, pozycja nr 2** – Czy zamawiający dopuści łącznik o długości 15cm?

Odp.: Zamawiający dopuszcza.

109. **Pakiet nr 7, pozycja nr 2** – Czy zamawiający dopuści łącznik o złączu 15F/22M-22F?

Odp.: Zamawiający dopuszcza.

110. **Pakiet nr 7, pozycja nr 3** – Czy zamawiający dopuści obwód oddechowy z rurami o długości 160cm oraz dodatkową rurą o długości 100cm?

Odp.: Zamawiający dopuszcza.

111. **Pakiet nr 7, pozycja nr 3** – Czy zamawiający dopuści układ sterylny?

Odp.: Zamawiający dopuszcza.

112. **Pakiet nr 7, pozycja nr 3** – Czy zamawiający dopuści oświadczenie producenta dotyczące użytkowania na 7 dni?

Odp.: Zamawiający dopuszcza.

113. **Pakiet nr 7, pozycja nr 4** – Czy zamawiający dopuści obwód oddechowy z rurami o długości 160cm oraz dodatkową rurą o długości 100cm?

Odp.: Zamawiający dopuszcza.

114. **Pakiet nr 7, pozycja nr 4** – Czy zamawiający dopuści układ sterylny lub mikrobiologicznie czysty?

Odp.: Zamawiający dopuszcza.

115. **Pakiet nr 7, pozycja nr 4** – Czy zamawiający dopuści oświadczenie producenta dotyczące użytkowania na 7 dni?

Odp.: Zamawiający dopuszcza.

116. Pakiet nr 7, pozycja nr 5 – Czy zamawiający dopuści obwód oddechowy z rurami o długości 200cm?

Odp.: Zamawiający dopuszcza.

117. Pakiet nr 9, pozycja nr 1 – Czy zamawiający dopuści czujnik do pulsoksymetru do pomiaru SpO₂ dla Noworodków/ dorosłych poniżej 3kg lub powyżej 40kg lub niemowlęcia poniżej 3kg?

Odp.: Zgodnie z SWZ.

118. Pakiet nr 9, pozycja nr 2 – Czy zamawiający dopuści jednoczęściowe mocowanie do czujników w rozmiarze 1,8cm x 10 cm?

Odp.: Zamawiający dopuszcza.

119. Pakiet nr 19, pozycja nr 3 – Czy zamawiający dopuści kołnierz dostępny w dwóch rozmiarach – dla dorosłych oraz dla dzieci?

Odp.: Zgodnie z SWZ.

120. Pakiet nr 20, pozycja nr 1 – Czy zamawiający dopuści cewnik w rozmiarach ch6-ch10? Bez rozmiaru ch 4.

Odp.: Zamawiający dopuszcza.

121. Pakiet nr 20, pozycja nr 3-4 – Czy zamawiający dopuści zgiębnik z linia rtg?

Odp.: Zamawiający dopuszcza.

122. Pakiet nr 20, pozycja nr 5 – Czy zamawiający dopuści rozmiary Ch 12-34?

Odp.: Zgodnie z SWZ.

123. Pakiet nr 20, pozycja nr 6 – Czy zamawiający dopuści długość ramion 450 mm x 180 mm?

Odp.: Zamawiający nie dopuszcza.

124. Pakiet nr 20, pozycja nr 7 – Czy zamawiający dopuści perforacja na długości 12 cm od dystalnego końca?

Odp.: Zamawiający dopuszcza.

125. Pakiet nr 20, pozycja nr 11 – Czy zamawiający dopuści zatyczkę mikrobiologicznie czystą?

Odp.: Zamawiający nie dopuszcza.

126. Pakiet nr 20, pozycja nr 13 – Czy zamawiający dopuści długość 400 mm?

Odp.: Zgodnie z SWZ.

127. Pakiet nr 20, pozycja nr 16 – Czy zamawiający dopuści cewnik w rozmiarze ch3,54 lub ch6?

Odp.: Zgodnie z SWZ – ch/F 6.


128. Pakiet nr 20, pozycja nr 14 – Czy zamawiający wymaga sondy trójdrożnej, wykonanej z medycznego PCV, w kolorze pomarańczowym, jednokierunkową, z dwoma kanałami do pompowania balonów celem powstrzymania krwotoków?

Odp.: Zamawiający wymaga sondy z dwoma kanałami do pompowania balonów i jednym kanałem do irygacji i odsysania.

129. Pakiet nr 24, pozycja nr 1 – Czy zamawiający dopuści bezigłowy przyrząd do pobierania leków z fiolek z gumowym korkiem oraz butelek o opisie:

- Dwuświatłowy
- Przeznaczone do wielokrotnych aspiracji
- Wyposażone w hydrofobowy i lipofobowy filtr odpowietrzający (bakteryjny) 0,2µm z możliwością zamknięcia klapką
- Możliwość aktywacji 300 razy przez 96 godzin
- Nie wymagają stosowania koreczków zabezpieczających
- Pasują do standardowych złączy luer oraz luer-lock
- W pełni szczelne i bezpieczne połączenie
- Możliwość stosowania z lekami cytostatycznymi
- Specjalne zakończenie kolca biorczego umożliwiającego całkowite opróżnienie butelki/fiolki

- Płaska powierzchnia membrany
- Dezynfekcja membrany poprzez przetarcie gazikiem z alkoholem
- Bez lateksu, PCV oraz DEHP
- Sterylizowane tlenkiem etylenu
- Opakowanie papier-folia



Odp.: Zamawiający nie dopuszcza.

130. Pakiet nr 26, pozycja nr 1 – Czy zamawiający dopuści gramaturę 100g/m² (część przednia) + 70g/m² (część tylna)?

Odp.: Zamawiający dopuszcza.

131. PAKIET 26 pozycja 1 Czy Zamawiający dopuści myjkę wykonaną z dwóch warstw włókien: molton 120 g nasączona jednostronnie mydłem dermatologicznym o neutralnym pH 5,5 oraz molton 100 g (bez mydła), pozostałe wymagania zgodnie z SWZ?

Odp.: Zamawiający nie dopuszcza.

132. PAKIET 28 pozycja 1 Czy Zamawiający dopuści poniższy skład zestawu:

- 1 serweta na stolik instrumentariuszki 150 x 190 cm;
- 1 osłona na stolik Mayo 80 x 145 cm;
- 1 osłona na kończynę z elastyczną tuniką, TPE i dzianinowa siatka poliestrowa, 30 x 90 cm;
- 1 serweta główna 230 x 320 cm, z samouszczelniającym otworem (Ø 7 cm) i padem chłonnym 50 x 50 cm wokół otworu.

Dodatkowo 2 zintegrowane z serwetą organizatory przewodów w formie rzepów.

- 2 włókninowe OP Taśmy 10 x 50 cm;
- 4 ręczniki 30 x 40 cm;

Pozostałe wymagania zgodnie z SWZ?

Odp.: Zamawiający dopuszcza.

133. PAKIET 30 pozycja 1 Czy Zamawiający dopuści poniższy zestaw ginekologiczny z osłoną Mayo?

• Serwety z materiału dwuwarstwowego Biflex, o dużej chłonności i wysokiej odporności na przenikanie cieczy

- Gramatura serwet 65g/m²
- Zgodność z normą PN-EN 13795

Skład

- 1 serweta na stolik instrumentariuszki 150 x 190 cm;
- 1 osłona na stolik Mayo 80 x 145cm;
- 1 serweta 100 x 100 cm;
- 1 uchwyt samoprzylepny typu Velcro 2,5 x 23 cm;
- 1 serweta główna w kształcie litery T 180/255 x 200 cm, ze zintegrowanymi osłonami na kończynie, samoprzylepnym otworem 12 x 25 cm oraz trójkątnym zbiornikiem na płyny wyposażonym w kształtkę (szywnik), separator części stałych od płynnych i zawór do odprowadzania płynów z możliwością podłączenia ssaka;
- 2 ręczniki 30 x 40 cm

Opakowanie zgodnie z SWZ?

Odp.: Zamawiający dopuszcza.

134. PAKIET 30 pozycja 1 Czy Zamawiający dopuści poniższy zestaw do zabiegów brzuszno-kroczych:

- Serwety z materiału dwuwarstwowego Biflex, o dużej chłonności i wysokiej odporności na przenikanie cieczy
- Gramatura serwet 65g/ m²
- Zgodność z normą PN-EN 13795

Skład

- 1 serweta na stolik instrumentariuszki 150 x 190 cm;
- 1 osłona na stolik Mayo 80 x 145 cm;
- 1 przylepna kieszeń dwukomorowa 2 x 15 x 40 cm
- 1 włókninowa OP taśma 10 x 50 cm;
- 1 serweta główna w kształcie litery T 180/240 x 280 cm, ze zintegrowanymi osłonami na kończynie, otworem przylepnym 30 x 30 cm wypełnionym folią chirurgiczną i otoczonym padem chłonnym 50 x 55 cm oraz otworem przylepnym 12 x 15 cm otoczonym padem chłonnym z płachtą umożliwiającą zakrycie otworu. Dodatkowo 4 zintegrowane z serwetą organizatory przewodów w formie rzepów.

Opakowanie zgodnie z SWZ?

Odp.: Zamawiający nie dopuszcza.

135. PAKIET 31 pozycja 1 Czy Zamawiający dopuści osłonę na kończynę z jedną taśmą 10x50 cm?

Odp.: Zamawiający nie dopuszcza.

136. Czy Zamawiający w Pakiecie nr 7, poz. 3 dopuści Układ oddechowy anestezyjologiczny dla dorosłych o długości do 180cm, pozostałe parametry zgodnie z swz?

Odp.: Zamawiający dopuszcza.

137. Pytanie: Pakiet 32 Materace przeciwodleżynowe

Czy Zamawiający dopuści materac przeciwodleżynowy z zakresem ciśnienia 50-120mmHg, reszta parametrów zgodna ze specyfikacją?

Odp.: Zamawiający dopuszcza.

Zamawiający informuje, że odpowiedzi na wnioski Wykonawców, a także wyjaśnienia stają się integralną częścią specyfikacji i są wiążące dla wszystkich Wykonawców ubiegających się o udzielenie przedmiotowego zamówienia przy składaniu ofert.

Zamawiający udostępnia na stronie internetowej prowadzonego postępowania wyjaśnienia i odpowiedzi na wnioski Wykonawców, bez dodatkowego wyodrębnienia wprowadzonych zmian.

WIFIOSPECJALISTYCZNY SPRAWI
w Ostrowcu Świętokrzyskim

DYREKTOR NACZELNY
Dariusz Tumulec

Dariusz Tumulec