



SZPITAL POWIATOWY W CHRZANOWIE

32-500 Chrzanów
ul. Topolowa 16

Sekretariat
☎ 32 624 70 29
☎ 32 623 94 28

Centrala
☎ 32 624 77 77

www.szpital-chrzanow.pl

✉ sekretariat@szpital-chrzanow.pl

DZP ⁵⁸⁹ 221/11/2020

Chrzanów, dnia 09.11.2020

Wykonawcy

Dotyczy: odpowiedzi na zapytania do siwz Dostawa sprzętu do rehabilitacji – przetarg 100/2020.

1. Prosimy Zamawiającego o wyłączenie do oddzielnego pakietu Zestawu do rehabilitacji kardiologicznej. Pozwoli to na złożenie ofert większej ilości oferentów, a co za tym idzie nie będzie ograniczało zasady konkurencyjności Prawa Zamówień Publicznych.

Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody – zgodnie z siwz.


2. **dotyczy punktu 7 tabeli Zestawu do Rehabilitacji Kardiologicznej:** Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie do postępowania wysokiej klasy system do Rehabilitacji Kardiologicznej z możliwością automatycznego sterowania ergometrami – do 16 ergometrów lub bieżni. Uzasadnienie: Stosowanie wymogu w obecnym brzmieniu nie ma przesłanek diagnostycznych. Grupy treningowe liczą maks. ok. 10 osób wykonujących ćwiczenia w tym samym czasie co pozwala na sprawne kontrolowanie przebiegu całego badania jak również stanu medycznego poszczególnych pacjentów. Większe grupy treningowe ograniczają w znacznym stopniu te możliwości.

Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody – zgodnie z siwz.

3. **dotyczy punktu 7 tabeli Zestawu do Rehabilitacji Kardiologicznej:** Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie, w jakim celu stosuje zapis o sterowaniu maks. 24 urządzeniami skoro w pkt. 1 wymaga dostarczenia systemu Rehabilitacji Kardiologicznej z licencją na 4 stanowiska, a w dalszych zapisach tabeli, dot. ergometrów, Zamawiający wymaga dostarczenia tylko 4 cykloergometrów.

Odp.: Możliwość rozbudowy.

4. **dotyczy punktu 7 tabeli Zestawu do Rehabilitacji Kardiologicznej:** Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o zmianę zapisu w pkt. 7 tabeli z 24 rowerów lub bieżni na 16 rowerów lub bieżni. Uzasadnienie: Pozostawienie zapisu w obecnym brzmieniu, w połączeniu z pozostałymi zapisami, zwłaszcza z punktów 63-65, jednoznacznie i ponad wszelką wątpliwość wskazuje na jednego Wykonawcę: firma BTL, co jest sprzeczne z obecnie obowiązującymi zapisami o PZP i może narazić Zamawiającego na konsekwencje prawne.



Chel



SZPITAL POWIATOWY W CHRZANOWIE

32-500 Chrzanów
ul. Topolowa 16

Sekretariat
☎ 32 624 70 29
☎ 32 623 94 28

Centrala
☎ 32 624 77 77

www.szpital-chrzanow.pl

✉ sekretariat@szpital-chrzanow.pl

Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody – zgodnie z siwz.

5. dotyczy punktu 16 tabeli Zestawu do Rehabilitacji Kardiologicznej: Prosimy o wyjaśnienie co Zamawiający ma na myśli jako Algorytm SpO2 w trybie stałego obciążenia?

Odp.: Obciążenie zmienne w zależności od SpO2.

6. dotyczy punktu 32 tabeli Zestawu do Rehabilitacji Kardiologicznej: Prosimy Zamawiającego o odstąpienie od wymogu cyfrowego wyświetlacza wysokości siedziska.

Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody – zgodnie z siwz.

7. dotyczy punktu 46-48 tabeli Zestawu do Rehabilitacji Kardiologicznej: Zwracamy się z prośbą o wykreślenie zapisu w pkt. 46-48 w całości, ponieważ zapisy te odnoszą się do sterowania ergometrami z pozycji oprogramowania zainstalowanego na komputerze, a nie samego ergometru. Uzasadnienie: W pkt. 17-19 tabeli, w części dot. oprogramowania Zamawiający zawarł już te zapisy. Ponadto, w pkt. 7 w części dot. oprogramowania, Zamawiający wymaga automatycznego sterowania ergometrami z pozycji oprogramowania. w związku z tym bezcelowe jest ich powielanie w zapisach dot. ergometrów.

Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody – zgodnie z siwz.


8. dotyczy punktu 49 tabeli Zestawu do Rehabilitacji Kardiologicznej: Prosimy o dopuszczenie do postępowania możliwość ręcznej zmiany obciążenia z pozycji oprogramowania do Rehabilitacji Kardiologicznej. Uzasadnienie: Zamawiający w pkt. 1-29 opisuje oprogramowanie do sterowania Rehabilitacją Kardiologiczną i zarządzania pacjentami, badaniami, itp. Pozostawienie tego zapisu w kontekście do pozostałych w niniejszej tabeli jest bezzasadne.

Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody – zgodnie z siwz.

9. dotyczy punktu 50 tabeli Zestawu do Rehabilitacji Kardiologicznej: Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie w jakim celu stosuje się zapis dot. wyświetlania tętna HR w ergometrze skoro ten sam parametr Zamawiający wymaga w części dotyczącej oprogramowania do kontroli Rehabilitacji Kardiologicznej?

Odp.: W celu podglądu przy cykloergometrze.

10. dotyczy punktu 50 tabeli Zestawu do Rehabilitacji Kardiologicznej: Prosimy o odstąpienie od wymogu z pkt. 50 zapisu: tętna HR. Uzasadnienie: Zamawiający w pkt. 1-29 wymaga dostarczenia oprogramowania do Rehabilitacji Kardiologicznej pozwalającego m.in. na: rejestrację EKG pacjentów - zwłaszcza w pkt. 9 tabeli SIWZ, Zamawiający wymaga, aby oprogramowanie umożliwiała: Zapis oraz archiwizację istotnych parametrów (obciążenie, HR, krzywe EKG, ciśnienie krwi). Pozostawienie zapisu w pkt. 50 w obecnym brzmieniu pozostaje bezzasadne.



Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy KRS, Nr 0000015881, NIP 628 19 16 916, REGON 000310108
Nr konta: BANK PEKAO S.A. 38 1240 4748 1111 0000 4877 1892

Handwritten signature



SZPITAL POWIATOWY W CHRZANOWIE

32-500 Chrzanów
ul. Topolowa 16

Sekretariat
☎ 32 624 70 29
☎ 32 623 94 28

Centrala
☎ 32 624 77 77

www.szpital-chrzanow.pl

✉ sekretariat@szpital-chrzanow.pl

Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody – zgodnie z siwz.

11. dotyczy punktu 52 tabeli Zestawu do Rehabilitacji Kardiologicznej: Co Zamawiający ma na myśli jako „zintegrowana klawiatura”?

Odp.: Wbudowana klawiatura.

12. dotyczy punktu 52 tabeli Zestawu do Rehabilitacji Kardiologicznej: Czy Zamawiający dopuszcza do postępowania wysokiej klasy cykloergometr wyposażony w duży, czytelny wyświetlacz dotykowy?

Odp.: Zamawiający dopuszcza.

13. dotyczy punktu 52 tabeli Zestawu do Rehabilitacji Kardiologicznej: Czy Zamawiający dopuszcza przyciski membranowe przy wyświetlaczu, do ręcznej obsługi ergometru?

Odp.: Zamawiający dopuszcza.

14. dotyczy punktu 53 tabeli Zestawu do Rehabilitacji Kardiologicznej: Prosimy o wykreślenie tego zapisu w całości. Uważamy, że pozostawienie tego zapisu stoi w sprzeczności z wcześniej postawionymi wymogami, dotyczącymi dostarczenia systemu Rehabilitacji Kardiologicznej z automatycznym sterowaniem cykloergometrami oraz z prezentacją trendów, wykresów i krzywych w oprogramowaniu do Rehabilitacji kardiologicznej (pkt. 7-14 oraz 21-23). Ponadto pozostawienie tego zapisu może skutkować błędami w przygotowaniu ofert przez Wykonawców oraz brakiem możliwości dokładnego porównania złożonych ofert.

Odp.: Zapisy bez zmian.

15. dotyczy punktu 55-57 tabeli Zestawu do Rehabilitacji Kardiologicznej: Prosimy o dopuszczenie do postępowania system Rehabilitacji Kardiologicznej z cykloergometrami, wyposażony w bezprzewodowe nadajniki 3-kan. EKG (po 1 na każdy cykloergometr) z odbiornikiem do 100m. Każdy z nadajników wyposażony będzie w pas piersiowy oraz adapter do zastosowania elektrod przylepnych (zamiennie z pasem piersiowym). Uzasadnienie: Oferowane rozwiązanie jest zdecydowanie nowocześniejsze. Pozwala na monitorowanie EKG pacjenta niezależnie od urządzenia treningowego (również poza nim). Ponadto monitorowanie EKG może być prowadzone przed, w trakcie jak i po treningu. Zastosowanie monitorowania 3 kan. EKG zwiększa również możliwości diagnostyczne. Pozostawienie zapisów w pkt. 55-57 oraz w połączeniu z pozostałymi zapisami SIWZ, zwłaszcza z pkt. 58, jednoznacznie i ponad wszelką wątpliwość wskazuje na jednego Wykonawcę: firma BTL, co jest sprzeczne z obecnie obowiązującymi zapisami o PZP i może narazić Zamawiającego na konsekwencje prawne.

Odp.: Zamawiający dopuszcza.



Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy KRS, Nr 0000015881, NIP 628 19 16 916, REGON 000310108
Nr konta: BANK PEKAO S.A. 38 1240 4748 1111 0000 4877 1892

ohes



SZPITAL POWIATOWY W CHRZANOWIE

32-500 Chrzanów
ul. Topolowa 16

Sekretariat
☎ 32 624 70 29
☎ 32 623 94 28

Centrala
☎ 32 624 77 77

www.szpital-chrzanow.pl

✉ sekretariat@szpital-chrzanow.pl

16. dotyczy punktu 58 tabeli Zestawu do Rehabilitacji Kardiologicznej: Zwracamy się z prośbą o odstąpienie od wymogu zawartego w punkcie 58 tabeli. Uzasadnienie: Stosowanie elektrod przyssawkowych nie ma zastosowania w Rehabilitacji Kardiologicznej – nie jest powszechnie obowiązującą metodą. Ponadto, szereg systemów stosuje metody dużo wygodniejsze dla Użytkownika i Pacjenta – np. pas piersiowy z wbudowanymi punktami elektrod. Pozostawienie zapisu w obecnym brzmieniu, w połączeniu z pozostałymi zapisami SIWZ – zwłaszcza z pkt. 55-57, jednoznacznie i ponad wszelką wątpliwość wskazuje na jednego Wykonawcę: firma BTL, co jest sprzeczne z obecnie obowiązującymi zapisami o PZP i może narazić Zamawiającego na konsekwencje prawne.

Odp.: Dopuszcza się.

17. dotyczy punktu 61 tabeli Zestawu do Rehabilitacji Kardiologicznej: Prosimy o dopuszczenie do postępowania cykloergometr o wymiarach (dł. x sz. x wys.): 1010 x 535 (z kierownicą) x 1270 (mm).

Odp.: Dopuszcza się.

18. dotyczy punktu 62 tabeli Zestawu do Rehabilitacji Kardiologicznej: Zwracamy się z prośbą o wykreślenie z zapisu w części dot. interfejsu: EKG, zdalne uruchomienie EKG i dopuszczenie do postępowania system Rehabilitacji Kardiologicznej z bezprzewodowymi nadajnikami EKG. Uruchomienie rejestracji EKG może odbywać się automatycznie (po założeniu nadajnika na klatkę piersiową pacjenta) lub ręcznie przez Użytkownika – z poziomu oprogramowania. Uzasadnienie: W pkt. 1-29, w części dot. oprogramowania Zamawiający wymaga pełnej kontroli EKG łącznie z rejestracją krzywych EKG z pozycji oprogramowania. Zastosowanie oferowanego rozwiązania, pozwoli nie tylko kontrolować przebiegiem treningu na cykloergometrze, jak również umożliwi prowadzenie treningów poza urządzeniem treningowym.





Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody – zgodnie z siwz.

19. dotyczy punktu 63 tabeli Zestawu do Rehabilitacji Kardiologicznej: Zwracamy się z prośbą o odstąpienie od wymogu zawartego w punkcie 63 tabeli. Uzasadnienie: Pozostawienie zapisu w obecnym brzmieniu, w połączeniu z pozostałymi zapisami SIWZ, jednoznacznie i ponad wszelką wątpliwość wskazują na jednego Wykonawcę: firma BTL co jest sprzeczne z obecnie obowiązującymi przepisami o PZP i może narazić Zamawiającego na konsekwencje prawne.

Odp.: zgodnie z siwz.

20. dotyczy punktu 63 tabeli Zestawu do Rehabilitacji Kardiologicznej: Prosimy o dopuszczenie bezprzewodowego modułu pacjenta o wymiarach 14x93x52 mm i wadze 269g. Ani wymiary ani waga nie są istotne diagnostycznie.

Odp.: Dopuszcza.



Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy KRS, Nr 0000015881, NIP 628 19 16 916, REGON 000310108
Nr konta: BANK PEKAO S.A. 38 1240 4748 1111 0000 4877 1892



SZPITAL POWIATOWY W CHRZANOWIE

32-500 Chrzanów
ul. Topolowa 16

Sekretariat
☎ 32 624 70 29
☎ 32 623 94 28

Centrala
☎ 32 624 77 77

www.szpital-chrzanow.pl

✉ sekretariat@szpital-chrzanow.pl

21. **dotyczy punktu 63 tabeli Zestawu do Rehabilitacji Kardiologicznej:** Prosimy o dopuszczenie do postępowania moduł bezprzewodowego EKG bez wbudowanego wyświetlacza, zasilany z 2 szt. baterii AA (lub akumulatorów NiMH). O wymiarach: i wadze: z możliwością podglądu sygnału ze wszystkich odprowadzeń na ekranie komputera. Uzasadnienie: Stosowanie ograniczenia w postaci wielkości wyświetlacza modułu EKG do 3", zwłaszcza przy wymogu bezprzewodowej transmisji badania jest bezcelowe. Zasadą i celem działania bezprzewodowego modułu EKG jest prezentacja w czasie rzeczywistym zapisu EKG na monitorze komputera. Ponadto, duża przekątna monitora komputera, min. 21" pozwala dokładnie obejrzeć krzywą EKG.

Odp.: Dopuszcza.


22. **dotyczy punktu 63 tabeli Zestawu do Rehabilitacji Kardiologicznej:** Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie do postępowania 12 kanałowy, bezprzewodowy moduł EKG, o wymiarach: 115 x 75 x 18 (mm) i wadze 140 g, z informacją diodową o: podłączeniu/odłączeniu elektrod i zapisem EKG wyświetlanym na monitorze komputera min. 21". Uzasadnienie: W pkt. 65 Zamawiający wymaga, aby sygnał z bezprzewodowego modułu EKG był zapisywany w kompleksowej platformie medycznej pozwalającej na analizę. Stosowanie wymogu w postaci wyświetlacza do 3" nie pozwoli Zamawiającemu na dokładną i rzetelną analizę sygnału EKG ze względu na małe rozmiary wyświetlacza. Większe znaczenie diagnostyczne miałyby możliwość wyświetlania w czasie rzeczywistym, sygnału EKG na monitorze, np. komputera min. 21". Ponadto, platforma medyczna, poza wyświetlaniem zapisu EKG pozwala pełną analizę, pomiary oraz przygotowania raportu po badaniu (np. dla pacjenta). Prosimy wziąć również pod uwagę, że zapisy w pkt. 63, w połączeniu z zapisami w pkt. 64-65 i innymi w tabeli SIWZ, jednoznacznie i ponad wszelką wątpliwość wskazują na jednego Wykonawcę.

Odp.: Dopuszcza.

23. **dotyczy punktu 64 tabeli Zestawu do Rehabilitacji Kardiologicznej:** Zwracamy się do Zamawiającego o dopuszczenie do postępowania 12 kanałowy, bezprzewodowy moduł EKG wyposażony w ładowalny akumulator (ładowarka w zestawie) pozwalający na pracę z modulem do 10 godz., bez określenia pojemność baterii/akumulatora. Uzasadnienie: Większe znaczenie dla Użytkownika ma czas pracy, w którym może dokonywać badania EKG, a nie pojemność baterii. Duża pojemność baterii nie musi jednocześnie oznaczać długiego czasu pracy modułu. Czas pracy zależy jest bardziej od zużycia energii w trakcie badania, niż samej pojemności baterii/akumulatora. Ponadto zapis w pkt. 64, w połączeniu z pozostałymi zapisami SIWZ jednoznacznie wskazuje na jednego Wykonawcę


Odp.: Dopuszcza.

24. **dotyczy punktu 64 tabeli Zestawu do Rehabilitacji Kardiologicznej:** Prosimy o dopuszczenie do postępowania moduł wyposażony w wymienne baterie AA (2 szt.). Jeden



Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy KRS, Nr 0000015881, NIP 628 19 16 916, REGON 000310108
Nr konta: BANK PEKAO S.A. 38 1240 4748 1111 0000 4877 1892



SZPITAL POWIATOWY W CHRZANOWIE

32-500 Chrzanów
ul. Topolowa 16

Sekretariat
☎ 32 624 70 29
☎ 32 623 94 28

Centrala
☎ 32 624 77 77

www.szpital-chrzanow.pl

✉ sekretariat@szpital-chrzanow.pl

komplet baterii pozwala na przeprowadzenie kilkudziesięciu testów wysiłkowych. Ponadto, wymiana baterii umożliwia ponowne wykorzystanie modułu bez konieczności oczekiwania na naładowanie akumulatora. Dzięki temu, moduł jest znacznie szybciej gotowy do ponownego użycia.

Odp.: zgodnie z siwz.

25. dotyczy punktu 65 tabeli Zestawu do Rehabilitacji Kardiologicznej: Prosimy o odstąpienie od wymogu zawartego w punkcie 63 tabeli. Jego pozostawienie w obecnym brzmieniu, w połączeniu z pozostałymi zapisami SIWZ jednoznacznie i ponad wszelką wątpliwość wskazuje na jednego Wykonawcę, co jest sprzeczne z obecnie obowiązującymi zapisami o PZP.

Odp.: zgodnie z siwz.

26. dotyczy punktu 65 tabeli Zestawu do Rehabilitacji Kardiologicznej: Prosimy o dopuszczenie do postępowania wysokiej klasy moduł bezprzewodowego EKG (12-kan.) do Prób Wysiłkowych oraz EKG Spoczynkowego, wyposażony w dedykowaną bazę pacjentów bez konieczności spełnienia pozostałej części zapisu w pkt. 65.

Odp.: zgodnie z siwz.

27. dotyczy punktu 65 tabeli Zestawu do Rehabilitacji Kardiologicznej: Prosimy o wyjaśnienie, czy Zamawiający wymaga, aby razem z systemem do Rehabilitacji Kardiologicznej, cykloergometrami i bezprzewodowym modułem 12-kanalowego EKG dostarczyć również systemy do Holterów, Próby Wysiłkowej, Spirometrii i Ergospirometrii? Jeżeli TAK, prosimy o informacje na temat konstrukcji technicznej i użytkowej wymienionych systemów. Jeżeli NIE, prosimy o odstąpienie od tego wymogu, gdyż jego pozostawienie, w połączeniu z pozostałymi zapisami SIWZ, a zwłaszcza z pkt. 63-65, jednoznacznie i ponad wszelką wątpliwość wskazuje na jednego Wykonawcę, co jest sprzeczne z obecnie obowiązującymi zapisami o PZP.

Odp.: zgodnie z siwz.

28. dotyczy punktu 65 tabeli Zestawu do Rehabilitacji Kardiologicznej: Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie, czy dopuści do postępowania platformę medyczną z Rehabilitacją Kardiologiczną, cykloergometrami i bezprzewodowym modułem 12-kanalowego EKG do Spoczynkowego i Wysiłkowego EKG, bez wymogu dot. Holterów, Holtera ABPM, Spirometrii i Ergospirometrii. Platforma ma możliwość późniejszej rozbudowy o wszystkie, wymienione oprogramowania/analizy.

Odp.: zgodnie z siwz.



Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy KRS, Nr 0000015881, NIP 628 19 16 916, REGON 000310108
Nr konta: BANK PEKAO S.A. 38 1240 4748 1111 0000 4877 1892



SZPITAL POWIATOWY W CHRZANOWIE

32-500 Chrzanów
ul. Topolowa 16

Sekretariat
☎ 32 624 70 29
☎ 32 623 94 28

Centrala
☎ 32 624 77 77

www.szpital-chrzanow.pl

✉ sekretariat@szpital-chrzanow.pl

29. **dotyczy punktu 65 tabeli Zestawu do Rehabilitacji Kardiologicznej:** Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie do postępowania wysokiej klasy platformę medyczną bez wymogu analizy sygnału pod kątem nagłej śmierci sercowej, według aktualnych kryteriów Seattle i International.

Odp.: zgodnie z siwz.

30. **dotyczy punktu 74 tabeli Zestawu do Rehabilitacji Kardiologicznej:** Prosimy o wyjaśnienie, czy nie zaszła omyłka pisarska w ilości ergometrów do podłączenia. Uzasadnienie: Zgodnie z zapisami SIWZ, Zamawiający wymagał dostarczenia systemu wyposażonego w 4 cykloergometry, a w pkt. 74 Zamawiający wymaga portów COM do podłączenia ergometrów.

Odp.: Zapis bez zmian.

31. **dotyczy punktu 74 tabeli Zestawu do Rehabilitacji Kardiologicznej:** Prosimy o doprecyzowanie ile ergometrów ma zostać dostarczonych razem z systemem do Rehabilitacji Kardiologicznej: 4 czy 5?

Odp.: 4 cykloergometry.

32. **dotyczy punktu 74 tabeli Zestawu do Rehabilitacji Kardiologicznej:** W związku z tym, że Zamawiający we wcześniejszych zapisach tabeli wymagał dostarczenia 4 cykloergometrów razem z systemem do Rehabilitacji Kardiologicznej, a pkt. 74 tejże tabeli SIWZ wskazuje ilość 5 ergometrów – prosimy o wyjaśnienie, czy Zamawiający posiada już 1 ergometr, który ma zostać dołączony do zamawianego systemu Rehabilitacji Kardiologicznej. Jeżeli TAK, prosimy o określenie jaki to ergometr (typ, producent, itp.) oraz czy tym samym wymaga dostarczenia licencji na 5 stanowisk zamiast 4 (jak wskazano w pkt. 1 tabeli SIWZ)?

Odp.: Zamawiający nie oczekuje od wykonawcy dołączania posiadanych ergometrów.

33. **dotyczy terminu realizacji:** Prosimy Zamawiającego o wydłużenie terminu realizacji do 30 dni od podpisania umowy. Sprzęt będący przedmiotem postępowania nie jest sprzętem ratującym życie.

Odp.: Nie - zgodnie z siwz.

34. **dotyczy wzoru umowy:** Prosimy o zmianę zapisu § 9 ust. 2 wzoru umowy na:

„Zamawiający ma prawo do naliczania i egzekwowania kar umownych w następujących wypadkach i wysokościach:

- za opóźnienie w dostarczeniu przedmiotu umowy – w wysokości 100 zł za każdy dzień opóźnienia liczony od terminu wykonania umowy,
- za opóźnienie w usunięciu wad stwierdzonych w okresie rękojmi lub gwarancji w wysokości 50 zł za każdy dzień opóźnienia liczony od dnia wyznaczonego na ich usunięcie,



Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy KRS, Nr 0000015881, NIP 628 19 16 916, REGON 000310108
Nr konta: BANK PEKAO S.A. 38 1240 4748 1111 0000 4877 1892

ohus



SZPITAL POWIATOWY W CHRZANOWIE

32-500 Chrzanów
ul. Topolowa 16

Sekretariat
☎ 32 624 70 29
☎ 32 623 94 28

Centrala
☎ 32 624 77 77

www.szpital-chrzanow.pl

✉ sekretariat@szpital-chrzanow.pl

c) za odstąpienie od umowy z przyczyn, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność w wysokości 5 % wynagrodzenia brutto ustalonego w umowie.”

Uzasadnienie: Sprzęt będący przedmiotem zamówienia nie jest sprzętem ratującym życie.

Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody – zgodnie z siwz.

POZ. 4 ZESTAW DO REHABILITACJI KARDIOLOGICZNEJ ZESTAWIENIE PARAMETRÓW I WARUNKÓW WYMAGANYCH :

35. **(pkt. 63)** : Czy Zamawiający dopuści wysokiej klasy, zestaw do rehabilitacji kardiologicznej z mniejszym i lżejszym, 12 kanałowym, bezprzewodowym modułem EKG o wymiarach 90x58x20mm i wadze 115g?

Odp.: Dopuszcza.

36. **(pkt. 64)** : Czy Zamawiający dopuści wysokiej klasy, zestaw do rehabilitacji kardiologicznej z modułem wyposażonym w 2 ładowane akumulatory o pojemności łącznej 5400 mAh?

Odp.: Dopuszcza.

Pakiet nr 1- Sprzęt na potrzeby Zakładu Rehabilitacji Ruchowej

Przedmiot zamówienia: Wirówka kończyn dolnych:

37. Czy Zamawiający dopuści wirówkę o wymiarach 890x880x750mm? Tak niewielka różnica w wymiarach w żaden sposób nie wpływa na jakość zabiegu

Odp.: Dopuszcza.





38. Czy Zamawiający dopuści wirówkę posiadającą 10-12 dysz z regulacją kierunku wypływu strumienia wody z dodatkową funkcją napowietrzania strumienia wody (tzw. bierny masaż perełkowy) i płynną regulacją wydajności dysz i stopnia napowietrzania? Rozwiązanie takie zwiększa efektywność zabiegu.

Odp.: zgodnie z siwz.

Przedmiot zamówienia: Wirówka kończyn górnych:

39. Czy Zamawiający dopuści wirówkę o wymiarach 950x1100x1070mm? Tak niewielka różnica w wymiarach w żaden sposób nie wpływa na jakość zabiegu

Odp.: Dopuszcza.



Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy KRS, Nr 0000015881, NIP 628 19 16 916, REGON 000310108
Nr konta: BANK PEKAO S.A. 38 1240 4748 1111 0000 4877 1892

dm



SZPITAL POWIATOWY W CHRZANOWIE

32-500 Chrzanów
ul. Topolowa 16

Sekretariat
☎ 32 624 70 29
☎ 32 623 94 28

Centrala
☎ 32 624 77 77

www.szpital-chrzanow.pl

✉ sekretariat@szpital-chrzanow.pl

40. Czy Zamawiający wymaga, aby wirówka posiadała na wyposażeniu specjalną obręcz do masażu limfatycznego dla pacjentów onkologicznych(w szczególności dla kobiet po mastektomii) z regulacją siły strumienia wody?


Odp.: zgodnie z siwz.


41. Czy Zamawiający wymaga, aby wirówka posiadała bardzo ważną funkcję powiadamiania o konieczności odkamieniania systemu dysz i przewodów po wykonaniu określonej liczby zabiegów co zapobiega odkładaniu się kamienia w instalacji oraz zobowiązuje personel do regularnego dbania o urządzenie?

Odp.: zgodnie z siwz.

Z poważaniem

Sporządził:

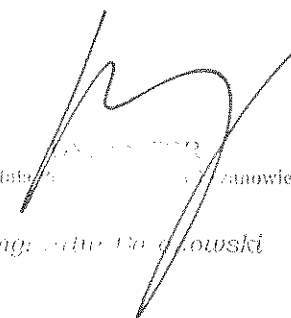
Szpital Powiatowy w Chrzanowie
mgr. Aneta Pawłowska

STARSZY SPECJALISTA
ds. Zamówień Publicznych

mgr. Aneta Pawłowska

