

**Do wszystkich wykonawców**

Dotyczy postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego: **Dostawa sprzętu medycznego – 3 części.**

Działając w oparciu o zapisy art. 135 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2023r. poz. 1605 z późn. zm.) Zamawiający informuje, że w niniejszym postępowaniu wpłynęły następujące zapytania:

**Pytanie Nr 1**

Dotyczy: Część 1 – Fotel do pobierania krwi – 3 szt.

Czy Zamawiający dopuści fotel do pobierania krwi, który posiada obustronne podłokietniki obrotowe z regulacją wysokości w zakresie od 240 do 350 mm, która mierzona jest od siedziska ?  
Pozostałe parametry wg OPZ

**Odpowiedź:**

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

**Pytanie Nr 2**

Dotyczy: Część 3 – Parawan lekarski 3 – częściowy – 2 szt.


Czy Zamawiający dopuści zaproponowany poniżej parawan w zamian za opisany w OPZ?



Trzyczęściowy parawan metalowy stanowi niezbędne wyposażenie każdego gabinetu lekarskiego i kosmetycznego. Wykonany z metalowych rurek parawan jest stabilny, nie tracąc przy tym na lekkości, kółka pozwalają na swobodne przenoszenie w dowolne miejsce bez ryzyka poślizgu.

- Szerokość: 282 cm
- Wysokość: 165 cm

- Głębokość: 48 cm
- Grubość płyty PCV: 5 mm

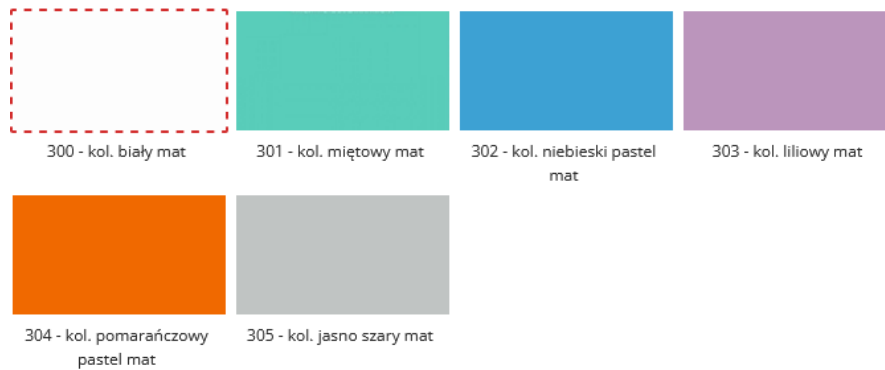

**Odpowiedź:**

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

**Pytanie Nr 3**

Dotyczy: Część 1 – Fotel do pobierania krwi – 3 szt.

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania fotel do krwi, gdzie podłokietniki obrotowe z regulacją wysokości 0-20 cm, kąt nachylenia podłokietników w zakresie -45° do +80°, zakres obrotu podłokietników w płaszczyźnie poziomej 180°, tapicerowane siedzisko usytuowane na wysokości 54 cm od podłoża, max obciążenie 130 kg, całkowita długość 1000 mm, szerokość podstawy 770 mm, całkowita wysokość 1250 mm, zakres regulacji pleców w zakresie od 93° (oparcie uniesione) do 180° (oparcie położone na płasko)? (Zdjęcie proponowanego fotela w załączeniu)



**Odpowiedź:**

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

**Pytanie Nr 4**

Dotyczy: Przedmiotowe środki dowodowe - Część 3 – Parawan lekarski 3- częściowy

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie możliwości przedstawienia katalogów/ulotek autoryzowanego dystrybutora w języku polskim, zawierających szczegółowe informacje na temat oferowanego sprzętu. Pragniemy zauważyć, iż większość oryginalnych folderów producenta nie zawiera szczegółowych parametrów technicznych, gdyż stanowią one w większości jedynie reklamę

sprzętu. Producenci nie są w stanie zawrzeć wszystkich informacji w katalogu, w związku z czym dystrybutorzy w danym kraju zajmują się przygotowaniem ulotek uwzględniających kompleksowo informacje uzyskane z różnych katalogów, kart technicznych, rycin, rysunków technicznych oraz prospektów udostępnionych przez producenta sprzętu. W związku z powyższym prosimy Zamawiającego o zgodę na przedłożenie katalogów autoryzowanego dystrybutora oraz stosowną korektę zapisów specyfikacji warunków zamówienia.

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza.

**Pytanie Nr 5**

**Część 3 – Parawan lekarski 3- częściowy**

Prosimy Zamawiającego o rezygnację z wymogu przeszkolenia pracowników w zakresie obsługi i racjonalnej eksploatacji dostarczonego sprzętu medycznego. Oferowane parawany są bardzo proste w obsłudze, wykwalifikowany personel medyczny nie powinien mieć najmniejszych problemów z ich obsługą w oparciu o wcześniejsze zapoznanie się z instrukcją obsługi (w jęz. polskim, dostarczanej wraz z dostawą), zawierającą wszystkie niezbędne informacje potrzebne Użytkownikom, czy personelowi technicznemu. Konieczność realizacji powyższego wymogu dla oferowanych wózków przyczyni się jedynie do bezzasadnego zawyżenia ceny ofertowej.

**Odpowiedź:**

Zamawiający rezygnuje w zakresie części 3 tj. parawan lekarski 3- częściowy z wymogu przeszkolenia pracowników w zakresie obsługi i racjonalnej eksploatacji dostarczonego sprzętu.

**Pytanie Nr 6**

**Umowa § 5 ust. 3 ust. a), umowa § 5 ust. 10-12 - Część 3 – Parawan lekarski 3- częściowy**

Prosimy Zamawiającego o odstąpienie od wymogu przeprowadzania przeglądów gwarancyjnych w zakresie parawanów, z uwagi na fakt, iż producent nie przewiduje dla owego wyrobu wykonywania przeglądów gwarancyjnych.

**Odpowiedź:**

Zamawiający odstępuje w zakresie części 3 tj. parawan lekarski 3 - częściowy od wymogu przeprowadzania przeglądów gwarancyjnych.

**Pytanie Nr 7**

**Umowa § 5 ust. 3 ust. d) - Część 3 – Parawan lekarski 3- częściowy**

Prosimy Zamawiającego o wykreślenie § 5 ust. 3 ust. d) z projektu umowy dla Części 3 – Parawan lekarski 3- częściowy, ponieważ nie dotyczy dostarczanego sprzętu.

**Odpowiedź:**

Zamawiający wykreśli § 5 ust. 3 pkt. d) z umowy dla części 3 tj. parawan lekarski 3- częściowy.

**Pytanie Nr 8**

**Umowa § 5 ust. 4**

Prosimy Zamawiającego o wydłużenie czasu reakcji, licząc od momentu zgłoszenia awarii, (przyjęcie zgłoszenia, podjęcie naprawy) serwisu gwarancyjnego do 48 godzin.

**Odpowiedź:**

§ 5 ust. 4 - Projektowane postanowienia umowy, otrzymuje brzmienie: „ Czas reakcji, licząc od momentu zgłoszenia awarii, (przyjęcie zgłoszenia, podjęcie naprawy) serwisu gwarancyjnego w ciągu 48 godzin.

#### **Pytanie Nr 9**

##### **Umowa § 5 ust. 5**

Prosimy Zamawiającego o wydłużenie czasu skutecznej naprawy niewymagającej użycia części zamiennych licząc od momentu zgłoszenia awarii do 5 dni roboczych.

##### **Odpowiedź:**

§ 5 ust. 5 - Projektowane postanowienia umowy, otrzymuje brzmienie: „Czas skutecznej naprawy niewymagającej użycia części zamiennych licząc od momentu zgłoszenia awarii w ciągu 5 dni roboczych.”

#### **Pytanie Nr 10**

##### **Umowa § 5 ust. 6**

Prosimy Zamawiającego o wydłużenie czasu skutecznej naprawy z użyciem części zamiennych licząc od momentu zgłoszenia awarii do 15 dni roboczych.

##### **Odpowiedź:**

§ 5 ust. 6 - Projektowane postanowienia umowy otrzymuje brzmienie: „Czas skutecznej naprawy z użyciem części zamiennych licząc od momentu zgłoszenia awarii w ciągu 10 dni roboczych.”

#### **Pytanie Nr 11**

##### **Umowa § 6 ust. 2**

Prosimy Zamawiającego o zmniejszenie wysokości kary umownej za każde rozpoczęte 12 godzin zwłoki do 0,1% łącznego wynagrodzenia brutto określonego w § 3 ust. 1 umowy, w § 5 ust. 5 za każdy rozpoczęty 1 dzień zwłoki do 0,1 % łącznego wynagrodzenia brutto określonego w § 3 ust.1 umowy, zaś w § 5 ust. 6 za każdy rozpoczęty 1 dzień zwłoki 0,1 % łącznego wynagrodzenia brutto określonego w § 3 ust.1 umowy. W innych niż wskazanych powyżej przypadkach nienależytego wykonania umowy przez Wykonawcę, przez co rozumie się wykonanie przedmiotu umowy w sposób niezgodny z jej postanowieniami Zamawiający uprawniony jest do dochodzenia od Wykonawcy kary umownej do wysokości 1 % łącznego wynagrodzenia brutto określonego w § 3 ust.1 umowy, za każde naruszenie. W ocenie Wykonawcy proponowana wysokość kar jest znacząco zawyżona.

##### **Odpowiedź:**

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

#### **Pytanie Nr 12**

##### **Część 3 – Parawan lekarski 3- częściowy – 2 szt.**

Pkt. 4\_Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie wysokości od podłogi do szczytu parawanu wynoszącej 165 cm.

##### **Odpowiedź:**

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

#### **Pytanie Nr 13**

##### **Część 3 – Parawan lekarski 3- częściowy – 2 szt.**

Pkt.6 Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie szerokości całkowitej parawanu po jego rozłożeniu wynoszącej 140 cm.

**Odpowiedź:**

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

**Pytanie Nr 14**

**Część 3 – Parawan lekarski 3- częściowy – 2 szt.**

Pkt.7, pkt. 13 Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie szerokości całkowitej parawanu po jego złożeniu wynoszącej 52 cm.

**Odpowiedź:**

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

**Pytanie Nr 15**

**Część 3 – Parawan lekarski 3- częściowy – 2 szt.**

Pkt.8 Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie skrzydeł parawanu z płyt z poliwęglanu odpornego na zadrapania oraz uderzenia, niezapalnego (materiał zgodny z normą EN13501-1, B-s1 d0).

**Odpowiedź:**

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

**Pytanie Nr 16**

**Część 3 – Parawan lekarski 3- częściowy – 2 szt.**

Pkt.10 Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie podstawy jezdnej wyposażonej w cztery dwubieżniowe kółka jezdne z hamulcami, oraz 2 segmenty boczne również z takimi kółkami (1 kółko na panel), co zwiększa stabilność parawanu.

**Odpowiedź:**

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

**Pytanie Nr 17**

**Część 3 – Parawan lekarski 3- częściowy – 2 szt.**

Pkt.11 Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie powierzchni zajmowanej przez wózek wynoszącej 50x48 cm.

**Odpowiedź:**

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

**Pytanie Nr 18**

**Część 3 – Parawan lekarski 3- częściowy – 2 szt.**

Pkt.11 Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie parawanu bez uchwytu do jego przemieszczania, z uwagi iż nie jest on niezbędny do prowadzenia parawanu.

**Odpowiedź:**

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

**Pytanie Nr 19**

**Część 3 – Parawan lekarski 3- częściowy – 2 szt.**

Pkt. 16 Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie parawanu bez uchwytu do jego przemieszczania, z uwagi iż nie jest on niezbędny do prowadzenia parawanu.

**Odpowiedź:**

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

**Pytanie Nr 20**

**Część 3 – Parawan lekarski 3- częściowy – 2 szt.**

Pkt. 17 Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie parawanu bez aluminiowych uchwytów w formie rączek na zewnętrznych segmentach parawanu, z uwagi iż nie są one niezbędny do składania, rozkładania i przemieszczania parawanu.

**Odpowiedź:**

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

**Pytanie Nr 21**

Pkt. 18 Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie parawanu o wadze 15,6 kg, co jest parametrem lepszym od wymaganego. Oferowany parawan jest lżejszy i wygodniejszy do obsługi i prowadzenia.

*(Zdjęcie poglądowe oferowanego parawanu)*



**Odpowiedź:**

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.