



ZPZ – 2353 –3199/24

Olsztyn, dnia 08.07.2024r.

**Do wszystkich
uczestników postępowania**

ZPZ-19/04/24 Przetarg nieograniczony pn. „Dzierżawa analizatorów laboratoryjnych wraz z dostawą odczynników laboratoryjnych”

W związku z zapytaniami uczestników postępowania na dzierżawa analizatorów laboratorium wraz z dostawą odczynników laboratoryjnych, Zamawiający działając na podstawie art. 135 ust. 2 oraz 137 ust. 1 Ustawy Prawo zamówień publicznych, wyjaśnia Specyfikację Warunków Zamówienia w następujący sposób:

Pytanie nr 1

Do pakietu 3

Czy w pozycji 1 zamawiający zaakceptuje zestaw przeznaczony do pracy wyłącznie z próbkami surowicy?

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na powyższe.

Pytanie nr 2

Do pakietu 4

Czy w pozycji 1 zamawiający zaakceptuje zestaw przeznaczony do pracy wyłącznie z próbkami surowicy?

Czy w pozycji 3 zamawiający zaakceptuje zestaw przeznaczony do pracy wyłącznie z próbkami surowicy?

Czy w pozycji 4 zamawiający zaakceptuje zestaw przeznaczony do pracy wyłącznie z próbkami surowicy?

Czy w pozycji 5 zamawiający zaakceptuje zestaw przeznaczony do pracy wyłącznie z próbkami surowicy i płynu mózgowo-rdzeniowego?

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na powyższe.

Pytanie nr 3

Pytania do Pakietu NR 2

Dzierżawa analizatora do białek specyficznych wraz z zakupem odczynników na 36 miesięcy

Dotyczy: Załącznik nr 2 do SWZ, pakiet 2, pkt 10

Czy Zamawiający zgodzi się na krótszy czas trwałości odczynników dla testów SAA i Ceruloplazmina, które pozostawione w chłodzonym rotorze odczynnikowym analizatora zachowują trwałość krótszą niż 4 tygodnie.

W/w odczynniki zakrecone i przechowywane przez użytkownika w lodówce po zakończeniu pracy bez ograniczenia czasu pracy w ciągu dnia, utrzymują trwałość do 3 miesięcy po otwarciu dla Ceruloplazminy i 4 tygodnie dla SAA.

Testy te będą wykonywane przez Zamawiającego rzadko i jak najdłuższa trwałość odczynnika po otwarciu dostarcza Zamawiającemu wymiernych korzyści związanych z ekonomicznym zarządzaniem tymi odczynnikami. Dlatego prosimy o odstąpienie od wymogu trwałości 4 tygodni na pokładzie dla tych dwóch odczynników.

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na powyższe.

Pytanie nr 4

Dotyczy: Załącznik 2 do SWZ Tabela nr 1; warunki wymagane pkt 2, pakiet 2.

Czy Zamawiający zgodzi się na zmianę terminu ważności dostarczanych odczynników z 9 miesięcy na termin do 5 miesięcy.

Opakowania oferowanych zestawów są niewielkie od 50 do 100 testów, to zapewnia użytkownikowi wykorzystanie odczynnika bez strat, mając na względzie podane w Formularzu Cenowym zapotrzebowanie Zamawiającego. W oparciu o doświadczenie pracy z oferowanymi odczynnikami możemy zapewnić, że

zmiana ta nie dostarczy jakichkolwiek strat odczynnika oraz materiałów dodatkowych, których przyczyną miałyby być brak możliwości wykorzystania odczynnika w terminie ważności.

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na powyższe.

Pytanie nr 5

Dotyczy: SWZ i Załącznik nr 6b w odniesieniu do pakietu nr 2.

Prosimy o ujednoczenie wymagań. W dwóch źródłach załącznika 6b Umowa dla zadań 1-2 i SWZ pkt 21.4 podane są odmienne dopuszczalne terminy dostaw odczynników i terminy rozpatrzenia reklamacji.

Termin realizacji dostaw w SWZ 21.4: do 3 dni roboczych 10 pkt dla części 1-7 do 6 dni roboczych 5 pkt.

W załączniku 6b §5 ust. 4- 2-3 dni robocze.

Termin rozpatrzenia reklamacji w SWZ 21.4: do 3 dni roboczych 10 pkt dla części 1-7 do 6 dni roboczych 5 pkt. W załączniku 6b §10 ust. 9 2-3 dni robocze.

Zwracamy się z prośbą o zachowanie dla części 2 warunków zapisanych w SWZ 21.4. czyli termin realizacji dostaw 3 lub 5 dni roboczych, i termin rozpatrzenia reklamacji do 3 lub 6 dni roboczych.

Odpowiedź:

Zamawiający modyfikuje zapisy umowy uwzględniając ujednoczenie zapisów – patrz zmodyfikowany wzór umowy.

Pytanie nr 6

Dotyczy: Załącznik nr 6b §10 ust. 1, w odniesieniu do pakietu nr 2

Wykonawca prosi o przyjęcie zapisu czasu reakcji serwisu tj. przybycia serwisu do Zamawiającego w terminie, do 48 godzin, i nadanie poniższego brzmienia dla Załącznik nr 6b §10 ust. 1, pakiet 2.

„W razie stwierdzenia wad lub usterek (awarii) dostarczonego urządzenia reakcja serwisu tj. przybycie serwisu do zamawiającego i usunięcie awarii wyniesie maksymalnie do 48 godzin od chwili zgłoszenia w dni robocze. Czas naprawy może wydłużyć się do 5 dni roboczych, a w przypadku konieczności importu części 10 dni roboczych.”

Odpowiedź:

Zamawiający modyfikuje zapisy umowy – patrz zmodyfikowany wzór umowy.

Pytanie nr 7

Dotyczy Załącznika nr 6b Wzór Umowy pakiet 5: Czy Zamawiający dopuszcza dokonanie zmian w umowie w taki sposób, że treść umowy będzie następująca:

Par. 11 ust. 1 pkt 1: Strony ustalają następujące kary umowne: 1) W przypadku nie dotrzymania terminu, o którym mowa § 4 ust. 1 Wykonawca zapłaci zamawiającemu karę umowną, w wysokości 0,1 % wartości umowy określonej w § 6 ust. 2 za każdy dzień zwłoki w zależności od części zamówienia, w której ta zwłoka wystąpiła.

Par. 11 ust. 1 pkt 2: za każdy dzień zwłoki w stosunku do terminu ustalonego w § 4 ust. 2 Wykonawca zapłaci zamawiającemu karę umowną, w wysokości 0,1 % wartości umowy określonej w § 6 ust. 2 w zależności od części zamówienia, w której ta zwłoka wystąpiła;

Par. 11 ust. 1 pkt 3: za każdy dzień zwłoki w stosunku do ustalonych w § 5 ust. 4 terminów dostaw odczynników, materiałów dodatkowych, materiałów eksploatacyjnych Wykonawca zapłaci zamawiającemu karę umowną, w wysokości 0,1 % wartości niezrealizowanej dostawy.

Par. 11 ust. 1 pkt 4: za każdy dzień zwłoki w stosunku do ustalonego w § 10 ust. 1 terminu usunięcia awarii i w stosunku do terminu ustalonego § 10 ust. 2 dotyczącego urządzenia zastępczego wykonawca zapłaci zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,1% wartości umowy określonej w § 6 ust. 2 w zależności od części zamówienia, w której ta zwłoka wystąpiła.

Par. 11 ust.1 pkt 5: za każdy dzień zwłoki w stosunku do terminu ustalonego w § 10 ust. 11 wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną, w wysokości 0,1 % wartości umowy określonej w § 6 ust. 2 w zależności od części zamówienia, w której ta zwłoka wystąpiła;

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie nr 8

Dotyczy Załącznika nr 6 Wzór Umowy pakiet 16: czy Zamawiający dopuszcza dokonanie zmian w umowie w taki sposób, że treść umowy będzie następująca:

Par. 7 ust. 2: Strony ustalają, że za każdy dzień zwłoki w stosunku do ustalonego w § 3 ust. 2 lub § 9 ust. 3 i 5 terminu Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,1% wartości niezrealizowanej dostawy.

Par.7 ust. 3: „...W sytuacji opisanej powyżej wykonawca nie będzie zobowiązany do dostarczenia zamawiającemu wyrobu objętego zakupem interwencyjnym, natomiast będzie zobowiązany do zapłaty kary umownej w wysokości 1% wartości niezrealizowanej dostawy brutto w części, w którym zakup interwencyjny wstąpił lub zwrotu zamawiającemu różnicy pomiędzy ceną zakupu interwencyjnego, a ceną wyrobu wynikającą z umowy jeżeli szkoda przekroczy wartość kary umownej...”

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie nr 9

Dotyczy Pakietu nr 5, Tabela nr 1:

Zwracamy się z zapytaniem, czy podane ilości badań zawierają oznaczenia na kontrole, czy należy je doliczyć? Prosimy również o podanie harmonogramu oznaczeń kontrolnych.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż podane ilości badań nie zawierają oznaczeń kontrolnych.

W przypadku badań, których jest powyżej 260/rok - kontrolę będziemy wykonywać na 2 poziomach naprzemiennie 5 razy w tygodniu.

W przypadku badań, których jest poniżej 260 /rok - kontrolę będziemy wykonywać w dniu wykonania badania na 2 poziomach.

Pytanie nr 10

Dotyczy Załącznika nr 2 do SWZ / załącznik nr 1 do umowy – formularz cenowy i parametrów technicznych i użytkowych dla Pakietu 16 Odczynniki do wykonywania badań laboratoryjnych na analizatorach koagulologicznych: Sysmex CS-2500 i Sysmex CA-660 - 24 miesiące:

W związku z tym, że użytkowane przez Zamawiającego urządzenia stanowią przedmiot dzierżawy i są własnością Siemens Healthcare Sp. z o.o. , czy Zamawiający wymaga od wykonawcy zapewnienia wsparcia aplikacyjnego (minimum dwuletnie doświadczenie w zakresie hemostazy poświadczony certyfikatem producenta odczynników) dla odczynników wraz z zapewnieniem serwisu dla urządzeń w zakresie zaoferowanego asortymentu (przeglądy i serwis) ?

Prosimy o wprowadzenie wymogu, dla Wykonawców, że w przypadku zużycia i uszkodzenia posiadanych urządzeń Sysmex CS-2500 i Sysmex CA-660 i podzespołów wynikających z użycia zaoferowanych przez innego Wykonawcę odczynników i mat. eksploatacyjnych oraz ewentualnego ich uszkodzenia wynikającego z dodatkowej eksploatacji pokryje on koszty serwisu (usługi naprawy, części , przegląd) w ramach umowy na odczynniki?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie nr 11

Dotyczy Umowy:

Czy Zamawiający dopuści możliwość podpisania umowy w formie elektronicznej kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez osobę uprawnioną, zgodnie z formą reprezentacji Wykonawcy określoną w rejestrze sądowym lub innym dokumencie, właściwym dla danej formy organizacyjnej Wykonawcy, albo przez osobę umocowaną (na podstawie pełnomocnictwa) przez osoby uprawnione?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza taką możliwość.

Pytanie nr 12

Dotyczy Zał. nr 1 do SWZ (Formularz oferty); pkt 14_ Pakiet 10:

Uprzejmie prosimy Zamawiającego o możliwość wskazaniach dwóch kontaktów z ramienia Wykonawcy do składania reklamacji. Pozwoli to ulepszenie kontaktu oraz dostępności po stronie Wykonawcy.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza taką możliwość.

Pytanie nr 13

Dotyczy SWZ, Rozdział 13.1, pkt a):

Czy Zamawiający wyraża zgodę, aby dla Pakietu nr 10 materiały informacyjne były dokumentami sporządzanymi przez dostawcę oferowanych przeciwciał w jęz. angielskim?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie nr 14

Dotyczy SWZ Rozdział 13.1, pkt 2 oraz Zał. nr 2 do SWZ_ Pakiet 10, pkt 4 pod tabelą:

Czy Zamawiający wyraża zgodę, aby dla Pakietu nr 10 karty charakterystyki substancji niebezpiecznych dla odczynników były dokumentami sporządzanymi przez dostawcę oferowanych przeciwciał w jęz. angielskim?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie nr 15

Dotyczy Zał. nr 2 do SWZ (Formularz cenowy i parametrów technicznych), pakiet 10, pkt 1 pod tabelą:

Uprzejmie prosimy Zamawiającego o skorygowanie omyłki pisarskiej poprzez zmianę zapisu na: „z wyłączeniem odczynników RUO (*pozycje nr 47 i 48*) i odczynników chemicznych, które nie są wyrobami medycznymi” zgodnie z formularzem cenowym.

Odpowiedź:

Zamawiający koryguje zapisy pod formularzem cenowym w pakiecie nr 10 tab. 1. Patrz zmodyfikowany formularz cenowy,

Pytanie nr 16

Dotyczy SWZ Rozdział 13.1, pkt c) oraz Zał. nr 5 (6) do SWZ - Wzór umowy dla części 8 - 15 zamówienia, § 1 ust. 4:

Czy Zamawiający potwierdza, że dla Pakietu nr 10 nie wymaga Deklaracji zgodności CE IVD w stosunku do produktów RUO wskazanych w tabeli dla pakietu 10 pozycja 47 i 48 oraz usług udziału w kontroli zewnętrznej z pozycji 49 - 51 w formularzu cenowym - załącznika nr 2 do SWZ Pakiet 10?

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza, iż nie wymaga w pakiecie nr 10 Deklaracji zgodności CE IVD w stosunku do produktów RUO wskazanych w tabeli dla pakietu 10 pozycja 47 i 48 oraz usług udziału w kontroli zewnętrznej z pozycji 49 - 51 w formularzu cenowym.

Pytanie nr 17

Dotyczy Zał. nr 2 do SWZ (Formularz cenowy i parametrów technicznych), pakiet 10, pkt 1 w tabel; Zał. nr 5 (6) do SWZ - Wzór umowy dla części 8 - 15 zamówienia, §1 ust. 4:

Uprzejmie prosimy Zamawiającego o skorygowanie pomyłki pisarskiej w poz. 1 dla Pakietu 10 i zmianę z zapisu „CE-IVDruc” na „CE-IVD”. Obecny zapis uniemożliwia Wykonawcy poprawne zaferowanie asortymentu oraz wskazanie stawki vat.

Odpowiedź:

Zamawiający koryguje zapisy formularza cenowego w poz. 1 pakietu nr 10. Patrz zmodyfikowany formularz cenowy,

Pytanie nr 18

Dotyczy Zał. nr 2 do SWZ (Formularz cenowy i parametrów technicznych), Pakiet 10, pkt 1 pod tabelą; Zał. nr 5 (6) do SWZ - Wzór umowy dla części 8 - 15 zamówienia, §1 ust. 4:

Uprzejmie prosimy Zamawiającego o potwierdzenie, że zapis ten nie dotyczy pozycji 49 -51 tabeli asortymentowej, gdyż jako usługa objęte są stawką 23% vat i nie mogą być ujęte jako wyroby medyczne.

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza.

Pytanie nr 19

Dotyczy Zał. nr 2 do SWZ (Formularz cenowy i parametrów technicznych), pakiet 10, pkt 2 pod tabelą; Zał. nr 5 (6) do SWZ - Wzór umowy dla części 8 - 15 zamówienia, §1 ust. 5:

Uprzejmie prosimy, aby Zamawiający wyraził zgodę dla Pakietu 10 na dostawę przeciwciał z minimum 8 miesięcznym okresem przydatności.

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie nr 20

Dotyczy Zał. nr 2 do SWZ (Formularz cenowy i parametrów technicznych), Pakiet 10, pkt 5 pod tabelą:

Uprzejmie prosimy Zamawiającego o uzupełnienie zapisu w pkt 5 o zapis mówiący o sumie godzin przeznaczonych na konsultację merytoryczną na miejscu lub online: „*Wsparcie merytoryczne zostanie udzielone w dni robocze podczas wizyt u Zamawiającego w wymiarze do 3 wizyt o wymiarze 6 godzin na wizytę potwierdzone podpisaniem stosownego raportu z konsultacji. Dopuszcza się udzielanie wsparcia merytoryczne także w formie hybrydowej i/lub online z zachowaniem szacowanej sumarycznej liczby 18 godzin przeznaczonych na wizyty*”.

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie nr 21

Dotyczy Zał. nr 2 do SWZ (Formularz cenowy i parametrów technicznych), Pakiet 10:

Uprzejmie prosimy Zamawiającego, aby dla Pakietu 10 wyraził zgodę na wydłużenie czasu dostawy dla przeciwciał o statusie RUO z pozycji 47 i 48 do 20 dni roboczych.

Uzasadnienie:

Przeciwciała o statusie RUO są produkowane i wysyłane na indywidualne zamówienie klienta. Przeciwciała te nie są produkowane i magazynowane ze względu na zbyt szeroki wachlarz ofertowy produktów. W związku z koniecznością produkcji ich pod zamówienie jest konieczność dłuższej dostawy. Wykonawca dołoży wszelkich starań, aby czas realizacji był możliwie jak najkrótszy.

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie nr 22

Dotyczy Zał. nr 2 do SWZ (Formularz cenowy i parametrów technicznych), Pakiet 10; Zał. nr 5 (6) do SWZ - Wzór umowy dla części 8 – 15 zamówienia, §4:

Uprzejmie prosimy Zamawiającego, aby dla Pakietu 10 wyraził zgodę na dodanie punktu z zapisem „*Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć przedmiot umowy w powyżej wyznaczonym terminie, przy czym w sytuacjach uzasadnionych Zamawiający dopuszcza możliwość przedłużenia tego terminu na wniosek Wykonawcy wraz ze wskazaniem przyczyny przez Wykonawcę z jakich termin dostawy nie jest możliwy do dotrzymania oraz ewentualnymi dokumentami źródłowymi na potwierdzenie przyczyn niezależnych od Wykonawcy*”.

Zapis ten pozwoli Wykonawcy na rzetelne wykonanie dostawy odczynników z zachowaniem możliwości wystąpienia okoliczności niezależnych od Wykonawcy.

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie nr 23

Dotyczy Zał. nr 5 (6) do SWZ – Wzór umowy dla części 8 – 15 zamówienia, §2 ust. 6 i 7:

Uprzejmie prosimy Zamawiającego, aby dla Pakietu 10 dodał zapis „*na czas nie dłuższy jednak niż 6 miesięcy.*”, zgodnie z zapisem z §3 ust. 1.

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie nr 24

Dotyczy Zał. nr 5 (6) do SWZ – Wzór umowy dla części 8 – 15 zamówienia, §1 ust. 4:

Uprzejmie prosimy Zamawiającego, aby dla Pakietu 10 dodał zapis „*jeśli dotyczy*”.

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na powyższe. Patrz: zmodyfikowany wzór umowy.

Pytanie nr 25

Dotyczy Zał. nr 5 (6) do SWZ – Wzór umowy dla części 8 – 15 zamówienia, §6 ust. 1:

Uprzejmie prosimy Zamawiającego, aby dla Pakietu 10 wyraził zgodę na nie umieszczanie numeru zamówienia na fakturze ze względu na ograniczone możliwości oprogramowania.

Wykonawca korzysta z automatycznego wystawiania faktur na podstawie zleconej dostawy odczynników i nie ma możliwości każdorazowego, ręcznego wprowadzania numeru zamówienia do faktury z zamówień cząstkowych.

Uprzejmie prosimy o wyrażenie zgody na usunięcie tego wymogu dla Pakietu nr 10.

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na powyższe. W związku powyższym modyfikuje zapis §6 ust. 1 wzoru umowy dla pakietu 8-15, który otrzymuje brzmienie: Wykonawca jest zobowiązany do wystawiania odrębnej faktury do każdego zamówienia,. W przypadku otrzymania nieprawidłowo wystawionej faktury Zamawiający zwróci się do Wykonawcy z żądaniem wystawienia korekty. Żądanie, o którym mowa w zdaniu drugim zostanie przesłane wykonawcy pocztą elektroniczną na wskazany w umowie adres e-mail.

Pytanie nr 26

Dotyczy Zał. nr 5 (6) do SWZ - Wzór umowy dla części 8 – 15 zamówienia, §9 ust. 5:

Uprzejmie prosimy Zamawiającego, aby dla Pakietu nr 10 wyraził zgodę, aby termin dostawy odczynników po reklamacji jakościowej i ilościowej Zamawiającego liczony był od dnia uznania reklamacji przez Wykonawcę.

Uzasadnienie:

Wymienione odczynniki w Pakiecie 10 są produktami produkowanymi przez Producenta poza terytorium Polski. Wszelkie reklamacja, zwłaszcza jakościowe, muszą zostać skonsultowane i wymagają sprawdzenia przez dział jakości producenta w miejscu produkcji. Pragnę podkreślić, iż samo sprawdzenie nowych pozycji może zająć do 10 dni roboczych szczególnie w przypadku konieczności wyprodukowania nowego numeru LOT. W związku z powyższym, uprzejmie prosimy, aby termin dostawy odczynników po reklamacji ilościowej i jakościowej liczony był od dnia uznania reklamacji przez Wykonawcę, a Wykonawca dołoży wszelkich starań, aby dostarczyć sondy w możliwie najkrótszym czasie.

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie nr 27

Dotyczy Zał. nr 5 (6) do SWZ - Wzór umowy dla części 8 – 15 zamówienia, §5 ust. 5:

Uprzejmie prosimy o usunięcie wskazanego zapisu.

Ewentualne ceny promocyjne są ustalane indywidualnie i zależą od warunków danego kontraktu.

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie nr 28

Dotyczy Zał. nr 5 (6) do SWZ - Wzór umowy dla części 8 – 15 zamówienia, §6 ust. 2:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dostarczenie faktury VAT na wskazany adres poczty elektronicznej?

Jeżeli tak prosimy o zmianę ww. postanowienia poprzez dodanie zapisu „Zamawiający wyraża zgodę na przesyłanie faktur elektronicznych na następujący adres poczty elektronicznej.....”.

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie nr 29

Dotyczy Zał. nr 5 (6) do SWZ - Wzór umowy dla części 8 – 15 zamówienia, §7 ust. 3:

Prosimy o zastąpienie słów: „opóźnienia” na „zwłoki”.

W obecnym brzmieniu zapisu Wykonawca nie ma wpływu na dokonanie zakup interwencyjnego przez Zamawiającego – nie zależy to od jego należytej staranności.

Uprzejmie prosimy również o tożsamą modyfikację w §14 ust. 3 i zastąpienie wyrażenia „opóźnienie dostaw” zwrotem „zwłoka w dostawie”.

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie nr 30

Dotyczy Zał. nr 5 (6) do SWZ - Wzór umowy dla części 8 – 15 zamówienia, §12 ust. 1 pkt 8):

Wykonawca wskazuje, iż długotrwały okres obowiązywania umowy zawartej w wyniku udzielenia przedmiotowego zamówienia, czyni umowę szczególnie podatną na oddziaływania czynników cenotwórczych. Prosimy zatem o dodanie §12 ust. 1 pkt 8) w brzmieniu:

„W przypadku zmiany przepisów dotyczących wysokości podatku VAT ceny brutto ulegną zmianie stosownie

do tych przepisów, natomiast ceny netto pozostają nie zmienione. Zmiana ta nie wymaga dokonywania zmian w treści niniejszej umowy w formie aneksu”.

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie nr 31

§ 7 ust. 3 – Czy Zamawiający wyraża zgodę na obniżenie potencjalnej kary w razie skorzystania z zakupu interwencyjnego, a tym samym modyfikację postanowienia w niżej zaproponowany sposób: „W razie opóźnienia w dostawie zamówionych wyrobów lub niemożności wykonania zamówienia przez Wykonawcę, Zamawiający może zrezygnować z dostawy tych wyrobów i nabyć od podmiotów trzecich taką samą ilość wyrobów lub wyrobów równoważnych, jak wskazana w złożonym zamówieniu (zakup interwencyjny). W sytuacji opisanej powyżej Wykonawca nie będzie zobowiązany do dostarczenia Zamawiającemu wyrobu objętego zakupem interwencyjnym, natomiast będzie zobowiązany do zapłaty kary umownej w wysokości 3 % wartości niezrealizowanej dostawy brutto w części, w którym zakup interwencyjny wstąpił lub zwrotu Zamawiającemu różnicy pomiędzy ceną zakupu interwencyjnego, a ceną wyrobu wynikającą z umowy jeżeli szkoda przekroczy wartość kary umownej”?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie nr 32

Pytanie do przedmiotu zamówienia 2. Dotyczy Formularz cenowego – Czy nie nastąpiła omyłka i Zamawiający poprawi opis w pakiecie nr 15 w kolumnie nr 2 zgodnie z nazwą aparatu dotyczącą wskazanego pakietu?

Odpowiedź:

Zamawiający poprawia opis w tabeli. Patrz: zmodyfikowany formularz cenowy.

Pytanie nr 33

Dotyczy Pakietu nr 9,11

Pytania do umowy

§ 7 ust. 2 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmniejszenie kary umownej za zwłokę w dostawie produktów do wysokości 0,5% wartości netto niezrealizowanego zamówienia za każdy dzień zwłoki?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie nr 34

§ 7 ust. 3 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmniejszenie kary umownej w przypadku dokonania zakupu interwencyjnego do 1 % wartości niezrealizowanego zamówienia brutto?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie nr 35

Pytania do SWZ – rozdział 13 – Przedmiotowe środki dowodowe

13.1 a,b,c - Czy Zamawiający odstąpi od wymogu przesłania dokumentów wymienionych w punkcie a,b,c?

Dokumenty te są dostępne na stronie internetowej Wykonawcy i możliwe jest ich pobranie przez Zamawiającego w dowolnym momencie.

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie nr 36

13.1 Czy Zamawiający odstąpi od wymogu przesłania dokumentów wraz z ofertą? Nie ma możliwości przesłania tak dużej ilości plików za pośrednictwem platformy. Dokumenty są dostępne na stronie internetowej Wykonawcy.

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie nr 37

Pytania do formularza cenowego

Zwracamy się z prośbą o zmianę zapisu dotyczącego okresu ważności z co najmniej 9 miesięcy na co najmniej 6 miesięcy od daty dostawy do Zamawiającego. Wyszpecyfikowane w opisie przedmiotu zamówienia produkty są specyficzne i zapis pozostający w takim brzmieniu uniemożliwi nam złożenie oferty, a tym samym będzie stanowił ograniczenie konkurencji.

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na powyższe. Patrz: zmodyfikowany formularz cenowy.

Pytanie nr 38

Proszę o zmianę pkt 13 znajdującego się w załączniku nr 2 do SWZ (pakiet nr 6) poprzez wskazanie, że termin ważności odczynników wynosi 6 miesięcy od daty dostawy oraz o usunięcie zapisu znajdującego się pod tabelą: *Termin ważności min. 6 miesięcy po otwarciu opakowania*. Wskazujemy, że Wykonawca nie jest w stanie zapewnić terminu ważności 10 miesięcy od daty dostawy, gdyż maksymalny termin ważności odczynników wynosi 12 miesięcy od daty produkcji, a Wykonawca będzie potrzebował także czasu na sprowadzenie odczynników z zagranicy od producenta. Terminem ważności odczynników, jaki Wykonawca może zagwarantować, wynosi 6 miesięcy od daty dostawy.

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na powyższe. Patrz: zmodyfikowany formularz cenowy.

Pytanie nr 39

Prosimy o potwierdzenie, że w przypadku, gdy wszystkie parametry oferowanego przedmiotu zamówienia nie będą wynikały z katalogów/folderów/ulotek, Zamawiający dopuści złożenie przez Wykonawcę oświadczenia potwierdzającego spełnienie przez oferowany przedmiot zamówienia wszystkich parametrów wymaganych przez Zamawiającego. Wskazujemy, że ulotki, foldery, katalogi to dokumenty producenta, które nie są przygotowywane do konkretnego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego i mogą one nie odzwierciedlać wszystkich parametrów wskazanych w opisie przedmiotu zamówienia załączonym do SWZ.

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na powyższe.

Pytanie nr 40

Proszę o zmianę pkt 21.7. SWZ, w którym wskazano, że w kryterium „czas reakcji serwisu” Wykonawca może uzyskać 20 pkt za zaoferowanie czasu reakcji do 24 godzin, podczas gdy zgodnie z treścią tego samego punktu oraz zgodnie z treścią załącznika nr 2 do SWZ (pakiet nr 6) maksymalna ilość punktów w tym kryterium wynosi 10. Ponadto w niniejszym punkcie wskazano, że za zaoferowanie czasu reakcji do 48 godzin, Wykonawca otrzyma maksymalnie 10 pkt, w sytuacji gdy w treści załącznika nr 2 do SWZ (pakiet nr 6) wskazano, że za czas reakcji 48 godzin Wykonawca otrzyma 5 pkt.

Odpowiedź:

Zamawiający modyfikuje oczywistą omyłkę:

Pkt 21.7.SWZ otrzymuje brzmienie:

Zasady oceny ofert w kryterium „**czas reakcji serwisu**”:

W ramach kryterium „**czas reakcji serwisu**” każdy z wykonawców może otrzymać maksymalnie **10 pkt.**, zgodnie z wagą tego kryterium.

Wykonawca zobowiązany jest wskazać w ofercie jaki czas reakcji serwisu oferuje, opisany szczegółowo we wzorze umowy.

Ilość punktów oferty badanej za wskazany termin czasu reakcji serwisu przedstawia się następująco:

- do 24 godzin od zgłoszenia usterki – 10 pkt;

- do 48 godzin od zgłoszenia usterki – 5 pkt;

- do 96 godzin od zgłoszenia usterki – 0 pkt

Uwaga- Jeżeli Wykonawca w Formularzu Ofertowym nie zaznaczy **przez postawienie znaku „x”** w wymaganym polu, to zamawiający uzna, że wykonawca deklaruje spełnienie parametrów maksymalnych wskazanych przez zamawiającego –tj. czas reakcji serwisu do 96 godzin od zgłoszenia usterki.

Pytanie nr 41

Proszę o zmianę §6 ust. 3 pkt 6 projektu umowy poprzez nadanie mu brzmienia: „Ubezpieczenie przedmiotu dzierżawy na okres trwania umowy”. Wskazujemy, że klauzula ubezpieczenia wskazana w niniejszym postanowieniu umowy jest obszerna, czego skutkiem jest konieczność dokonania rewizji postanowień umowy ubezpieczenia, zawartej przez Wykonawcę, co z kolei może także doprowadzić do wzrostu ceny

oferty, w sytuacji konieczności rozszerzenia ochrony ubezpieczeniowej. Wskazujemy, że przedmiot dzierżawy będzie ubezpieczony, a wszelkie wady wynikłe z przyczyn tkwiących w rzeczy będą usuwane przez Wykonawcę w celu zapewnienia ciągłości pracy aparatu.

Odpowiedź:

Zamawiający wykreśla ze wzoru umowy §6 ust. 3 pkt 6 w umowach dot. pakietów 1-5 i 6-7.

Pytanie nr 42

Dotyczy pakietu nr 8, poz.nr 24 – Czy Zamawiający miał na myśli klon SK7 ?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ. Zamawiający wymaga przeciwciał opisanych szczegółowo w formularzu cenowym.

Pytanie nr 43

Dotyczy punktu 3.7 .1 SWZ. Zwracamy się z prośbą o ujednoczenie zapisu SWZ z innymi zapisami w załącznikach do SWZ poprzez dopisanie „o ile dotyczy” w punkcie 3.7.1. Nie wszystkie wyspecyfikowane produkty są wyrobami medycznymi. Zamawiający w oświadczeniach, które ma złożyć Wykonawca oraz we wzorze umowy, jak również w formularz cenowych dopuszcza składanie oferty na produkty nie będące wyrobem medycznym.

Odpowiedź:

Zamawiający modyfikuje zapisy pkt. 3.7 SWZ, który otrzymuje brzmienie:

„Wykonawca dostarczy produkty spełniające wymogi i wytworzone zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności z:

- 1) *Ustawą z dnia 7 kwietnia 2022 r. o wyrobach medycznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 974) – jeśli dotyczy;*
- 2) *wszystkie wyroby medyczne muszą być oznaczone znakiem CE IVD i spełniać wymagania zasadnicze określone dla tych wyrobów – jeśli dotyczy;*
- 3) *Wykonawca zobowiązany jest do bezwzględnego zagwarantowania spełnienia warunków jakościowych określonych w zezwoleniu na produkcję lub innych ustalonych przez Ministerstwo Zdrowia w oparciu, o które zostały dopuszczone do obrotu oraz przestrzegania terminów ważności na dostarczony towar.”*

Pytanie nr 44

Dotyczy §7 ust. 3 wzoru umowy dla pakietu 8, 13. Zwracamy się z prośbą o wykreślenie kary umownej. Sam zakup interwencyjny u innego dostawcy jest dla Wykonawcy karą, ponieważ utraci on zyski ze sprzedaży, dodatkowo zostanie obciążony różnicą w cenie.

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie nr 45

Dotyczy przedmiotowych środków dowodowych dla pakietu nr 8 i 13 – karty charakterystyki. Zwracamy się z prośbą o odstąpienie od dostarczenia kart charakterystyki w zamian za udostępnienie strony www do samodzielnego pobierania przez Zamawiającego dokumentów.

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie nr 46

Dotyczy przedmiotowych środków dowodowych dla pakietu 8 i 13 deklaracje zgodności CE. Zwracamy się z prośbą o odstąpienie od dostarczania dokumentów wraz z ofertą w zamian za złożenie oświadczenia, że Wykonawca jest w posiadaniu dokumentów i dostarczy je na każde wezwanie Zamawiającego w terminie 3 dni roboczych.

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie nr 47

Dotyczy przedmiotowych środków dowodowych – dokumenty opisowe – dla pakietu nr 8. Zwracamy się z prośbą o odstąpienie od wymogu dostarczania specyfikacji technicznych, kart danych, ulotek w zamian za udostępnienie strony www do samodzielnego pobierania dokumentów przez Zamawiającego.

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie nr 48

Dotyczy przedmiotowych środków dowodowych – dokumenty opisowe – dla pakietu nr 8. W przypadku negatywnej odpowiedzi na pytanie powyżej zwracamy się z prośbą o wyrażenie zgody na dostarczenie dokumentów do produktów niebędących wyrobami medycznymi w języku angielskim.

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie nr 49

Dotyczy §6 ust. 1 wzoru umowy dla pakietu nr 8 i 13. Zwracamy się z prośbą o modyfikację zapisu na „wykonawca jest zobowiązany do wystawienia odrębnej faktury do każdej zrealizowanej dostawy, w której będzie wpisany numer zamówienia Apteki Szpitalnej”.

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie nr 50

Dotyczy §3 ust. 2 wzoru umowy. Zwracamy się z prośbą o ograniczenie miejsca dostawy do Magazynu.

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie nr 51

Pakiet 13, Dotyczy pozycji 1, Probówki przezroczyste bezbarwne, bez korka Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego wyszczególnienie jakich probówek Zamawiający oczekuje. Wszystkie probówki niezbędne do procedur używanych łącznie ze spektrometrem, zostały podane przez Zamawiającego w pozycji 13 i 16.

Odpowiedź:

Zamawiający doprecyzowuje parametry asortymentu w poz. 1 pakiet nr 13 – i wymaga probówek przezroczystych, bezbarwnych, bez korka, niesterylne, polistyrenowe, okrągłodenne o pojemności 5 ml, 12x75 mm. Patrz zmodyfikowany formularz cenowy.

Pytanie nr 52**Pakiet 13, Dotyczy pozycji 8,**

Etylowy alkohol bezwodny 99,8% CZDA, ODCZ. FP oczywiście z POCh (Avantor) - 500 ml

Zwracamy się do Zamawiającego o dopuszczenie produktu równoważnego o pojemności 1000 ml.

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na powyższe pod warunkiem odpowiedniego przeliczenia zamawianych ilości zgodnie z SWZ. Patrz zmodyfikowany formularz cenowy.

Pytanie nr 53**Pakiet 13, Dotyczy pozycji 14,**

Chusteczki bezpyłowe 280 szt/ op

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie opakowania pakowanego po 100 sztuk.

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na powyższe, odpowiednim przeliczeniem ilości w górę.

Pytanie nr 54**Pakiet 13, Dotyczy pozycji 15**

Patyczki do nakładania 1000 szt./op. - 65 x 2 mm

Czy Zamawiający dopuści wykałaczki w rozmiarze długość/Wysokość: 6,8 cm Zmiana pozostaje bez wpływu na wynik i wygodę prowadzenia badania.

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na powyższe.

Pytanie nr 55

Pakiet 13, W celu przygotowania prawidłowej wyceny i wyliczenia ilości odczynników chemicznych, niezbędnych do pracy aparatu, prosimy Zamawiającego o udzielenie odpowiedzi czy będzie sam przygotowywał własny OS?

Odpowiedź:

Zamawiający oświadcza, że będzie korzystał z oryginalnego odczynnika OS. Nie będzie sam przygotowywać odczynnika OS.

Pytanie nr 56

Pakiet 13, Prosimy Zamawiającego o podanie średniej długości serii badań ID nastawianych jednorazowo na płytce spektrometru MALDI, w celu obliczenia liczby niezbędnych Zamawiającemu spotów na płytkach i w konsekwencji liczby płytek niezbędnych w okresie przetargu. Do podanej przez Zamawiającego liczby oczekiwanych badań, należy doliczyć oznaczenia kontrolne (BTS dla każdej serii badań), zajmujące osobne miejsca na płytkach.

Prosimy o podanie średniej długości cyklu przy uwzględnieniu badań bezpośrednio z dodatniej butelki.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż zużywa jednorazowo na jednej płytce ok. 50 miejsc (łączeni z BTS) plus badania bezpośrednio z dodatniej próbki krwi – średnio 2 badania w tygodniu.

Pytanie nr 57

Pakiet 13, Prosimy o potwierdzenie posiadania przez Zamawiającego adaptera do płytek jednorazowych, który nie jest wymagany w przetargu a konieczny dla użycia płytek jednorazowego użytku.

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza, że posiada adapter do płytek jednorazowych.

Pytanie nr 58

Pakiet 13, Prosimy o sprecyzowanie, czy Zamawiający wymaga jedynie płytek jednorazowych dla całości badań co opisane jest w formularzu cenowym w punkcie 17, czy też częściowo płytek wielorazowych co opisane jest pod formularzem cenowym.

Odpowiedź:

Zamawiający wyjaśnia, iż Laboratorium posiada płytki wielorazowe. Wymagamy zaoferowania jedynie płytek jednorazowych i dokonania wyliczenia odczynników wg zapisu pkt 2 pod tabelą asortymentową.

Pytanie nr 58

Pakiet 13, Czy Zamawiający wymaga zapewnienia wsparcia aplikacyjnego przez 7 dni w tygodniu online?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie nr 60

Pakiet 13, Czy wraz z dostawą odczynników Zamawiający będzie wymagał zapewnienia corocznych szkoleń personelu z obsługi i aktualizacji systemu.

Odpowiedź:

Zamawiający będzie wymagał warunków wyłącznie opisanych w SWZ.

Pytanie nr 61

Pakiet 13, Czy Zamawiający w ramach dostawy odczynników do aparatu, będzie wymagał wsparcia aplikacyjnego min. 9 osób, dostępnego przez kontakt telefoniczny i online przez bezpieczne łącze internetowe, oraz bezpośrednio w siedzibie Zamawiającego, obsługa w języku polskim? W przypadku takiego wymogu, do oferty zostanie dołączona lista osób aplikacyjnych wraz z numerami telefonów i maili

Odpowiedź:

Zamawiający będzie wymagał warunków wyłącznie opisanych w SWZ.

Pytanie nr 62

Pakiet 13, Czy Zamawiający, z uwagi na ciągły postęp w zakresie szybkiej diagnostyki sepsy i mikrobiologii, oczekuje przeprowadzenia szkoleń przez osoby aplikacyjne posiadające certyfikat nadany przez producenta systemu?

W przypadku takiego wymogu wraz z ofertą zostanie dołączona lista osób posiadających odpowiedni.


Odpowiedź:

Zamawiający będzie wymagał warunków wyłącznie opisanych w SWZ.

Pytanie nr 63

Czy zamawiający udostępni w swoich zasobach dostęp do sieci lokalnej w celu zapewnienia integracji z LIS oraz dostępu do internetu ?

Oferowane analizatory oraz systemy wymagają do pracy stałego połączenia z internetem. Jest to związane z aktualizacją licencji oprogramowania, pobieraniem danych o odczynnikach, kontrolach, kalibratorach, serwisem zdalnym oraz połączeniem z LIS. Wymagane jest połączenie z poniższymi serwerami na spacyfikowanych portach. Poniżej schemat połączeń rozwiązań diagnostycznych (analizatorów)

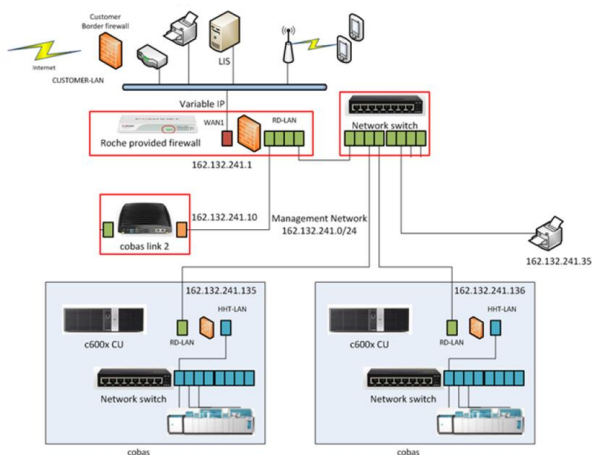

URL	IP	Port	Typ	Description
*.navify.com	193.58.155.0/24	443	CloudFlare	Main connections enabling Remote Service
*.navify.com	193.228.103.0/24	433 (514/541)	CloudFlare	Current/future setup using Cloudflare
remoteservice.roche.com	62.209.44.11	443	Direct	Dedicated connections enabling Remote Support
remoteservice-gas1.roche.com	62.209.44.21	443	Direct	Dedicated connections enabling Remote Support
remoteservice-gas2.roche.com	62.209.44.22	443	Direct	Dedicated connections enabling Remote Support
remoteservice-gas3.roche.com	209.202.167.19	443	Direct	Dedicated connections enabling Remote Support
remoteservice-gas4.roche.com	209.202.167.20	443	Direct	Dedicated connections enabling Remote Support
remoteservice-gas5.roche.com	120.136.45.231	443	Direct	Dedicated connections enabling Remote Support
remoteservice-gas6.roche.com	120.136.45.230	443	Direct	Dedicated connections enabling Remote Support
remoteservice-gas15.roche.com	35.76.193.4	443	Direct	Dedicated connections enabling Remote Support
remoteservice-gas16.roche.com	52.193.219.53	443	Direct	Dedicated connections enabling Remote Support
rln-cm-*.dia.roche.com	52.178.37.238	514 / 541	Direct	Dedicated connections enabling FortiGate management
teleservice.roche.com	196.3.50.39	443 / 80	HTTP	Dedicated connection to TSN
remoteservice-dr.roche.com	209.202.167.21	443	Direct	Axeda Disaster Recovery

Odpowiedź:

Zamawiający umożliwi otwarcie ruchu internetowego w zakresie niezbędnym do pracy urządzeń na określonych przez producenta adresach i portach.

Zamawiający pragnie dodać że wszelkie prace serwisowe prowadzone zdalnie powinny być możliwe tylko za pomocą dedykowanego połączenia VPN.

Czy Zamawiający wyraża zgodę na wydłużenie terminu podłączenia analizatora do sieci Zamawiającego (LIS) oferowanych urządzeń do 8 tygodni od daty podpisania umowy?

Uzasadnienie: Z uwagi na długie terminy realizacji podłączeń urządzeń przez dostawcę Państwa systemu LIS, które nie są zależne od nas jako Wykonawcy.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

Pytanie nr 64

Dotyczy Przedmiotowych środków dowodowych- pkt 13 SWZ

Dot. 13.1 a) i 13.1 b) Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby w miejsce wymaganych kart danych technicznych, ulotek oraz kart charakterystyk (dotyczy pozycji odczynnikowych i zużywalnych) załączyć oświadczenie do oferty o posiadaniu tych dokumentów oraz ich dostawie na każde żądanie Zamawiającego? Jednocześnie Wykonawca poda w ofercie adres strony internetowej, na której znajdują się wymagane dokumenty, z której Zamawiający może stale korzystać.

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie nr 65

Dotyczy Przedmiotowych środków dowodowych- pkt 13 SWZ

Dot. 13.2 c) Czy Zamawiający odstąpi od wymogu załączenia certyfikatów do oferty i w ich miejsce załączenia do oferty oświadczenia o posiadaniu certyfikatów oraz przesyłania tych dokumentów na żądanie Zamawiającego? (w punkcie 13.1.d -jest takie oświadczenie wymagane).

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie nr 66

Pakiet nr 1: Załącznik nr 2 do SWZ / załącznik nr 1 do umowy - formularz cenowy i parametrów technicznych i użytkowych: I. Immunochemia Tabela nr 1 Odczynniki i II Biochemia Tabela nr 4 Odczynniki

Zwracamy się z prośbą o określenie, w jaki sposób zostanie wykonany podział badań pomiędzy analizatorem nr 1 a analizatorem nr 2 (rodzaj badań i ilości oznaczeń).

Odpowiedź;

Zamawiający podaje poniżej podział badań :

Analizator 1 - rok produkcji – nie starszy niż 2020

Analizator 2 – aparat nowy, nie starszy niż 2023 /2024

Analizator 1		Analizator 2
Biochemia		
Rodzaj badań		Ilość oznaczeń na <u>12m-cy</u>
Albuminy	2100	5040
Alkohol etylowy	435	1040
Amikacyna	66	--
Aminotransferaza Alaninowa	11834	28400
Aminotranferaza asparaginowa	11067	26560
Amoniak	200	--
Antystreptolizyna O	100	--
Białko C-reaktywne	8667	20800
Białko całkowite	1567	3760
Białko w moczu/PMR	1167	2800
Bilirubina bezpośrednia	600	--
Bilirubina całkowita	10167	24400
CKMB akt.	400	--
CRP hs	500	--
Chlorki	11734	28160
Cholesterol całkowity	2167	5200
Cholesterol HDL	800	1920
Cholesterol LDL	1167	2800
Dehydrogenaza mleczanowa	2467	5920
Fosfataza zasadowa	2167	5200
Fosforany nieorganiczne	1900	4560
GGTP	1434	3440
Glukoza	6667	16000
HbA1c	1100	--
Homocysteina	300	--
kinaza Kreatynowa	267	640
Kreatynina (met. enzymatyczna)	200	--
kreatynina met. Jaffe	21334	51200
Kwas moczowy	2900	6960
Lipaza	1267	3040
Mocznik	7167	17200
Magnez	2434	5840
Mleczany	200	--
Potas	17334	41600
Rozpuszczalne receptory		

transferyny	200	--
Sód	16834	40400
Transferyna	100	--
Trójglicerydy	1667	4000
UIBC	1000	--
Wankomycyna	66	--
Wapń	4734	11360
Amylaza	1100	2640
Żelazo	1200	2880

Analizator 1

Analizator 2

Immunochemia

Rodzaj badań

Ilość oznaczeń na 12m-cy

FSH	433	--
LH	266	--
ACTH	300	--
Anty-SARS-COV2(ilościowe)	400	--
TRAB	--	300
Ca 125	434	1732
Ca 15,3	166	--
Ca 72,4	166	--
CMV IgG	266	--
CMV IgM	266	--
Cyklosporyna	100	--
DHEAS	300	--
EBV VCA IgG	200	--
EBV IgM	200	--
Estradiol	433	--
FT3	887	3546
FT4	1147	4586
HbeAg	166	--
HbsAg	413	1653
betaHCG	234	933
HIV Ag/Ab gen.4	654	2612
Kortyzol	450	--
NT-proBNP	514	2052
PSA całkowite	1300	5200
PSA wolne	300	--
PTH (1-84)	107	426
Progesteron	133	--
Prokalcytonina	1800	7200
Prolaktyna	200	--
Sirolimus	100	--
TSH	2400	9600
Takrolimus	100	--
Toxo IgG	166	--
Toxo IgM	166	--
Troponina hs	1320	5280
Anty-Hbe	166	--
Anty-Hbs	466	--
Anty-HCV	734	2932
AFP	--	800
Anty-TPO	--	600
Anty-TG	--	466
Ca19,9	--	2600

CEA	--	4266
Ferrytyna	--	3100
HbsAg- test potwierdzenia	25	175
Insulina	--	200
IL-6	--	266
Kwas foliowy	--	1933
Syfilis	--	950
Testosteron	--	933
Witamina B12	--	2233
Witamina D (25-OH)	--	1633
Anty-CCP	--	166
Anty-Hbc	--	733

Pytanie nr 67

Pakiet nr 1: Załącznik nr 2 do SWZ / załącznik nr 1 do umowy - formularz cenowy i parametrów technicznych i użytkowych: I. Immunochemia Tabela nr 1 Odczynniki i II Biochemia Tabela nr 4 Odczynniki

Czy dla rzadko wykonywanych testów (poniżej 1500 testów w ciągu 36 miesięcy) Zamawiający zgodzi się na zaoferowanie ilości odczynników umożliwiających wykonanie założoną ilość badań, bez uwzględnienia trwałości odczynników? Przeliczenie odczynników z uwzględnieniem trwałości testów na pokładzie przy tak rzadkich testach znacząco może podnieść wartość oferty

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na powyższe.

Pytanie nr 68

Dot. I. Immunochemia; 1. Tabela nr 1 Odczynniki (dotyczy analizatora nr 1 i nr2):

W celu prawidłowego oszacowania ilości opakowań kontroli prosimy o podanie ilości poziomów kontroli dla poz 7., 13., 29., 30., 31., 32., 37., 38., 43., 44., 45., 46., 47., 49., 51., 52., 53., 54., 55., 56., 57

Prosimy o potwierdzenie, że tabela nr 1 nie zawiera wiersza nr 50.

Odpowiedź: Zamawiający podaje dane jak poniżej:

Ilość kontroli dla poz. 7 i 13 – kontrola 5x w tyg. na 1 poziomie

Ilość kontroli dla poz 29, 30, 31, 32, 37, 38, 46, 49, 54, 55, - kontrola 2x w tyg na 1 poziomie

Ilość kontroli dla poz 43, 44, 45, 47, 51, 52, 53 – kontrola na 2 poziomach w dniu badania.

Tabela nr 1 nie zawiera wiersza nr 50.

Pytanie nr 69

Dot. II Biochemia; Tabela nr 4 Odczynniki: (dotyczy analizatora nr 1 i nr 2):

- Prosimy o potwierdzenie, że tabela nr 4 nie zawiera wierszy: 27, 28, 29, 41, 42, 44, 45, 49
- Prosimy o możliwość zmiany numeru wiersza dla parametru Transferyna z 46 na 45, ponieważ wiersz dla parametru UIBC ma numer 46.,

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza, iż tabela nr 4 nie zawiera wierszy: 27, 28, 29, 41, 42, 44, 45, 49, jednocześnie zmienia nr wiersza dla parametru Transferyna z 46 na 45.

Pytanie nr 70

Dotyczy Pakiet nr 1, Analizator nr 2, III Część Biochemiczna, pkt. 8 wymaganych właściwości i parametrów analizatora 2, Załącznik nr 2 do SWZ:

Czy Zamawiający dopuści aby dla 4 parametrów stabilność na pokładzie wynosiła 28 - 42 dni? Dla pozostałych parametrów stabilność na pokładzie wynosi od 8 do 26 tygodni.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na powyższe.

Pytanie nr 71

Dotyczy Pakiet nr 1, Załącznik nr 2 do SWZ, (dotyczy analizatora nr 1 i nr 2):

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie jednego odczynnika (TRAb) który posiada komponenty w formie liofilizatu do jednorazowej rekonstrukcji? Po rekonstrukcji odczynnik jest już w formie płynnej i gotowej do użycia.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na powyższe.

Pytanie nr 72

Dotyczy Pakiet nr 1, Załącznik nr 2 do SWZ, Parametry punktowane, punkt 2:

Prosimy o wyjaśnienie i uściślenie, czy opis kalibracja i rekalkibracja parametrów przy użyciu nie więcej niż 2 kalibratorów dotyczy części immunochemicznych oferowanych analizatorów?

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza iż opis kalibracja i rekalkibracja parametrów przy użyciu nie więcej niż 2 kalibratorów dotyczy części immunochemicznych oferowanych analizatorów.

Pytanie nr 73

Dotyczy Pakiet nr 1, Załącznik nr 2 do SWZ, (dotyczy analizatora nr 1 i nr 2):

pkt 8 część Immunochemiczna:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę aby termin ważności oferowanych odczynników zamkniętych wynosił min. 3-6 miesięcy?

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę, aby termin ważności wynosił min. 5 miesięcy.

Pytanie nr 74

Dotyczy Pakiet nr 1, Załącznik nr 2 do SWZ, Tabela nr 1 Odczynniki (dotyczy analizatora nr 1 i nr 2):

Czy Zamawiający wymaga, aby oferowany test do oznaczania troponiny był testem wysokoczułym, zgodnym z obowiązującymi zaleceniami i wymogami Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego PTK oraz Europejskiego Towarzystwa Kardiologicznego ESC i umożliwiał zastosowanie szybkiego 1-godzinnego algorytmu diagnostyki zawału mięśnia sercowego? Pozwoli to Zamawiającemu na prowadzenie wiarygodnej i szybkiej diagnostyki kardiologicznej zgodnie z najnowszymi rekomendacjami.

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga aby oferowany test do oznaczania troponiny był testem wysokoczułym, zgodnym z obowiązującymi zaleceniami i wymogami Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego PTK oraz Europejskiego Towarzystwa Kardiologicznego ESC i umożliwiał zastosowanie szybkiego 1-godzinnego algorytmu diagnostyki zawału mięśnia sercowego

Pytanie nr 75

Czy Zamawiający wymaga aby metoda oznaczania prokalcytoniny była wystandaryzowana wobec metody referencyjnej BRAHMS PCT, co umożliwi wykorzystanie do interpretacji wyników punktów odcięcia do diagnostyki sepsy ustalonych dla wszystkich testów oznaczających prokalcytoninę w oparciu o licencję i standaryzację Brahms PCT?

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga aby metoda oznaczania prokalcytoniny była wystandaryzowana wobec metody referencyjnej BRAHMS PCT, co umożliwi wykorzystanie do interpretacji wyników punktów odcięcia do diagnostyki sepsy ustalonych dla wszystkich testów oznaczających prokalcytoninę w oparciu o licencję i standaryzację Brahms PCT.

Pytanie nr 76

Czy Zamawiający oczekuje aby oferowane odczynniki do oznaczania TSH, fT4, fT3, anty-TPO i anty-Tg posiadały określone przez producenta odczynników specyficzne wartości referencyjne dla populacji noworodków, niemowląt, dzieci i kobiet w ciąży w poszczególnych trymestrach, co pozwoli prawidłowo interpretować wyniki oznaczeń tych parametrów?

Odpowiedź: Zamawiający nie wymaga ale dopuszcza takie rozwiązanie.

Pytanie nr 77

Prosimy o wyjaśnienie i uściślenie, czy Zamawiający zamierza stosować test beta-HCG wyłącznie jako test ciążyowy, czy także jako marker nowotworowy?

Odpowiedź: Zamawiający będzie stosował test beta-HCG jako test ciążyowy oraz marker nowotworowy.

Pytanie nr 78

Prosimy o wyjaśnienie i uściślenie czy oferowany test do oznaczania przeciwciał EBV IgG ma być testem EBV EBNA IgG czy EBV VCA IgG?

Odpowiedź: Zamawiający wyjaśnia, iż oferowany test do oznaczania przeciwciał EBV IgG ma być testem EBV VCA IgG

Pytanie nr 79

Czy Zamawiający oczekuje aby oferowany odczynnik do oznaczania prolaktyny będzie posiadał zwalidowaną metodykę i możliwość różnicowania obecności makroprolaktyny, co umożliwi wiarygodną interpretację wyników u pacjentów z makroprolaktynemią?

Odpowiedź: Zamawiający nie wymaga ale dopuszcza takie rozwiązanie.

Pytanie nr 80

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na składanie zamówień oraz na zgłaszanie reklamacji odczynników i awarii aparatu przez aplikację Wykonawcy (strona internetowa)? *Uzasadnienie: Składanie zamówień, zgłaszanie reklamacji odczynników i awarii aparatu przez aplikację Wykonawcy umożliwi Zamawiającemu przeglądanie historii wpisów, śledzenie statusu zgłoszeń i wysyłki zamówień.*

Wykonawca nie będzie ponosił odpowiedzialności za opóźnienie instalacji, które wynika ze zmian podjętych przez klienta już w trakcie trwania instalacji w szczególności: zmiana konfiguracji lub umiejscowienia aparatów w pomieszczeniu laboratorium.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na zgłaszanie reklamacji odczynników i awarii aparatu przez aplikację Wykonawcy (strona internetowa), natomiast składanie zamówień – zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 81

Dotyczy: zał. nr 5 (6b na umowie) projektowane postanowienia umowy

par. 2 ust. 5 (po ust. 9) Czy Zamawiający wyraża zgodę na przesyłanie wskazanych w niniejszym postanowieniu dokumentów drogą elektroniczną i mógłby podać adres mailowy, na który można dokumenty w tej formie wysłać?

Ponadto, prosimy o doprecyzowanie numerów postanowień niniejszego paragrafu. Po ust. 9 ponownie występuje ust. 5 oraz ust. 6.

Ponadto, Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby dostarczyć instrukcję obsługi i paszport techniczny w formie elektronicznej tj. pliku przesyłanego w email lub udostępnionego na stronie internetowej (w przypadku instrukcji obsługi)? Rozwiązanie takie należy uznać za optymalniejsze z punktu widzenia zrównoważonego rozwoju, zapewniające Zamawiającemu bieżący i nieograniczony dostęp, zwłaszcza wobec postępującego procesu elektronicznej.

Odpowiedź: Zamawiający wyjaśnia, iż w warunkach umowy nie precyzuje formy i czasu przesłania dokumentów zawartych w paragrafie. Jednocześnie dopuszcza przesłanie dokumentów drogą elektroniczną na etapie realizacji umowy i wtedy poda adres email. Jednocześnie Zamawiający poprawia numerację paragrafu 2 wzoru umowy

Pytanie nr 82

par. 4 ust. 2 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zamianę słowa "dni" na "dni robocze"?

par. 6 ust. 3 pkt 6 Czy Zamawiający odstąpi od wymogu ubezpieczenia aparatury określonego w niniejszym postanowieniu umowy?

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na powyższe. Patrz zmodyfikowany wzór umowy – pakiety 1-5.

Pytanie nr 83

par. 7 ust. 1 Czy Zamawiający wyraża zgodę na przesyłanie faktur drogą elektroniczną i mógłby podać adres mailowy, na który można fakturę w tej formie wysłać?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie nr 84

par. 7 ust. 8 Zapis w obecnym brzmieniu stanowi klauzulę abuzywną zgodnie z Art. 433 pkt 3) Ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo Zamówień Publicznych.

Dlatego prosimy o modyfikację zapisów poprzez dodanie zdania: /

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie:

„nie dotyczy okoliczności, gdy Zamawiający zalega z płatnościami za dostarczony towar ponad 30 dni licząc od terminu zapłaty. Wówczas Wykonawca będzie uprawniony do powstrzymania się ze spełnieniem obowiązku kolejnych dostaw do dnia zapłaty całości zaległych należności”?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie nr 85

par. 8 ust. 2 pkt 6 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na modyfikację niniejszego postanowienia, tak aby Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1, mogło się zmienić w wyniku zastosowania wszystkich Waloryzacji o maksymalnie 50% pierwotnej wartości Umowy?

par. 10 ust. 6 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę niniejszego postanowienia tak, aby skorzystanie z wykonania zastępczego wykluczało zastosowanie kar umownych?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie nr 86

Czy Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację tego postanowienia poprzez dodanie w jego treści, że Zamawiający może skorzystać z prawa do wykonania zastępczego „po bezskutecznym upływie przynajmniej 5- dniowego dodatkowego terminu wyznaczonego Wykonawcy do realizacji zobowiązania”?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie nr 87

Ponadto, czy Zamawiający wyraża zgodę na wykreślenie z niniejszego postanowienia “Zamawiający nie ma obowiązku uiszczania czynszu, o którym mowa w § 7 ust. 1 niniejszej umowy, należnego za okres, w którym nie mógł bez zakłóceń korzystać z przedmiotu dzierżawy.”?

Zamawiający szczegółowo określił w ust. 1 oraz ust. 2 niniejszego paragrafu zasady postępowania w przypadku awarii analizatora. Wykonawca w sytuacji przedłużającej się awarii jest zobowiązany do dostarczenia analizatora zastępczego bądź pokrycia różnicy kosztów związanych z koniecznością wykonania badań poza Laboratorium.

Ponadto, konsekwencje finansowe nieprawidłowego wykonania umowy zostały już szczegółowo określone poprzez zastrzeżenie kar umownych a także rozszerzenie odpowiedzialności na zasadach ogólnych w przypadku poniesienia szkody wyższej niż te kary.

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie nr 88

par. 10 ust. 11 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zamianę słowa "dni" na "dni robocze"?

par. 11 ust. 1 pkt 1, pkt 2 oraz pkt 4 Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby wysokość kary umownej była liczona od wartości sumy czynszu dzierżawnego?

Wskazujemy, iż wszelkie ryzyka finansowe związane z możliwością obciążenia Wykonawcy karami umownymi będą podlegały w kalkulowaniu do ceny ofertowej, co nie jest finalnie zjawiskiem korzystnym dla Zamawiającego.

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie nr 89

par. 11 ust. 1 pkt 5 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na modyfikację niniejszego postanowienia wzoru umowy w taki sposób, aby wysokość kary umownej naliczana była od wartości niezrealizowanej w terminie dostawy częściowej, a nie od wynagrodzenia za cały przedmiot umowy?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie nr 90

par. 11 ust. 2 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę wyrażenia "z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy" na "z przyczyn zawinionych przez Wykonawcę"?

Zgodnie z art. 471 k.c. dłużnik odpowiada za nienależyte wykonanie umowy jeżeli wynika ono z przyczyn za które ponosi odpowiedzialność.

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie nr 91

par. 11 ust. 3 Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby łączna wysokość kar umownych wynosiła 10% wartości umowy?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie nr 92

par. 12 Czy Zamawiający wyraża zgodę na dodanie "do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody"?

Ewentualnie dodanie: „wyłączona jest odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu utraconych korzyści”

par. 16 ust. 2 oraz ust. 3 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie na końcu postanowienia fragmentu

„po uprzednim wezwaniu dodatkowym i wyznaczeniu Wykonawcy dodatkowego terminu co najmniej 5 dni roboczych do należytego wykonania umowy.”? Odstąpienie, nawet częściowe, może skutkować po stronie Zamawiającego potrzebą zmiany wykonawcy. Jednocześnie procedura naprawcza może skutecznie zapobiegać tego rodzaju przypadkom, umożliwiając dokończenie współpracy stron.

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie nr 93

par. 21 Czy Zamawiający wyraża zgodę na zawarcie umowy w formie elektronicznej przy wykorzystaniu kwalifikowanego podpisu elektronicznego przez Wykonawcę?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza taką możliwość.

Pytanie nr 94

Brak regulacji w umowie: Czy Zamawiający jako administrator danych osobowych, które mogą znajdować się na aparatach będących przedmiotem zamówienia i do których w związku z prawidłową realizacją obowiązków wynikających z umowy o udzielenie zamówienia publicznego, tj. przyłączenie do sieci, dokonywanie przeglądów, świadczenie usług serwisowych może mieć dostęp Wykonawca, wyrazi zgodę na zawarcie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych? Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych zawarta zostałaby z Wykonawcą jako procesorem wg załączonego wzoru.

Odpowiedź:

Zamawiający wprowadza umowę powierzenia danych osobowych – dotyczy pakietów 1-7.

W załączeniu:

- zmodyfikowany formularz cenowy;
- wzór umowy powierzenia danych osobowych;
- wzory umów dostawy – (pakiet 1- 5; pakiet 6-7; pakiet 8-15)

Zastępca Dyrektora d.s Techniczno-Logistycznych
SK MSWiA z W-MCO w Olsztynie
Jolanta Grabińska
/podpis na oryginale/