

Wałbrzych, dnia 21.08.2023r.

DZPZ-530 - Zp/55/PN/23

Wykonawcy – wszyscy

Dotyczy: Dostawy sprzętu do hemodializy oraz dializy otrzewnowej - Zp/55/PN/23

Specjalistyczny Szpital im. dra Alfreda Sokołowskiego w Wałbrzychu zgodnie z art. 135 ust. 1 i 2 ustawy Pzp odpowiada na pytania Wykonawcy w przedmiotowym postępowaniu.

Pytanie nr 1 dot. pakietu nr 3

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie dializatora o powierzchni 1,8m², z błoną helixonową, pozostałe parametry bez zmian?

Odp. Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 2 dot. pakietu nr 5

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie dializatora o powierzchni 2,2m², pozostałe parametry bez zmian?

Odp. Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 3 dot. pakietu nr 8

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie dializatora wysokoprzepływowego o powierzchni 1,8m² z błoną helixonową, pozostałe parametry bez zmian?

Odp. Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 4 dot. pakietu nr 3

Czy Zamawiający w pakiecie numer 3 dopuści dializatory z błony polieterosulfon (PES), pozostałe wymagania zgodne z SWZ?

Odp. Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 5 dot. pakietu nr 4

Czy Zamawiający w pakiecie numer 4 dopuści dializatory z błony polieterosulfon (PES), pozostałe wymagania zgodne z SWZ?

Odp. Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 6 dot. pakietu nr 5

Czy Zamawiający w pakiecie numer 5 dopuści dializatory z błony polieterosulfon (PES), o powierzchni równej 2,2m²?

Odp. Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 7 dot. pakietu nr 8

Czy Zamawiający w pakiecie numer 8 dopuści dializatory wysokoprzepływowe z błony polieterosulfon (PES), pozostałe wymagania zgodne z SWZ?

Odp. Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 8 dot. pakietu nr 3

Zwracam się z uprzejmą prośbą o: wyrażenie zgody na zaferowanie w Pakiecie nr 3 dializatorów z błoną polinefronową, sterylizowanych promieniami Gamma.

Odp. Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 9 dot. pakietu nr 4

Zwracam się z uprzejmą prośbą o: wyrażenie zgody na zaferowanie w Pakiecie nr 4 dializatorów z błoną polinefronową, sterylizowanych promieniami Gamma.

Odp. Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 10 dot. pakietu nr 5

Zwracam się z uprzejmą prośbą o: wyrażenie zgody na zaferowanie w Pakiecie nr 5 dializatorów z błoną polinefronową, sterylizowanych promieniami Gamma o pow. 2,1m².

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody, Zamawiający wymaga dializatorów o powierzchni $\geq 2,2$ m².

Pytanie nr 11 dot. pakietu nr 8

Zwracam się z uprzejmą prośbą o: wyrażenie zgody na zaferowanie w Pakiecie nr 8 dializatorów wysokoprzepływowych z błoną polinefronową, sterylizowanych promieniami Gamma.

Odp. Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 12 dot. pakietu nr 16 i 17

Pakiet 16 i 17, Czy zamawiający dopuści cewnik o tej samej lub lepszej funkcjonalności leczniczej zamiast 15 F dopuści 15,5 F lub 14 F zamiast 14,5

Zestaw cewnik naczyniowy permanentny zakładany metodą seldingera zamiast retrograde (funkcjonalność lecznicza pozostaje bez zmian), Wymagane rozmiary r i dł. do mufki 19cm, 23cm, 27cm zamiast 28cm , 31 lub 35 zamiast 33cm, 43 zamiast 44cm , 50 zamiast 55cm

Odp. Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 13 dot. pakietu nr 16, poz.1

Czy Zamawiający w pozycji 1 pakiet 16 dopuści do postępowania cewnik dwuświatłowy długoterminowy poliuretanowy Evolution Flow do implantacji metodą wsteczną (retrograde) z rozrywalną koszulką z opatentowaną konstrukcją końcówki, która umożliwi proste i precyzyjne umiejscowienie końcówki w prawym przedsionku, o stopniu recyrkulacji poniżej 1%, średnica 15,5 FR, ramiona proste i długości: 19/40 cm, 23/44 cm, 28/49 cm, 33/54 cm do wyboru przez Zamawiającego?

Charakterystyka zestawu:

- radiocieniujący cewnik
- silikonowe ramiona
- złącze typu PEEK odporne na ekstremalne obciążenia chemiczne i mechaniczne
- zacisk na cewnik ze skrzydełkami do mocowania na skórze
- wskaźniki wypełnienia, rozmiar i długość
- kompatybilny z MRI
- odporna na odkształcenia prowadnica „J” z wysoką zawartością tytanu zapewniająca wyjątkowo wysoką elastyczność i odporność na odkształcenia, dodatkowy komfort zapewnia powłoka z PTFE, która gwarantuje gładką powierzchnię i najwyższy poślizg
- adapter wypełniający
- zacisk cewnika ze skrzydełkami do mocowania na skórze
- igła wprowadzająca 18G
- rozszerzadło 12 Fr
- rozszerzadło 16 Fr z rozrywalną koszulką
- nasadki iniekcyjne Luer Lock
- kleszczyki – 2 szt.

Szczegółowe informacje o produkcie w załączeniu.

Odp. Zamawiający nie dopuszcza. Zamawiający wymaga cewników o rozmiarze 15FR, dostępność wszystkich długości do mufki 19cm, 23cm, 28cm, 33cm, 44cm ,55cm.

Pytanie nr 14 dot. pakietu nr 17, poz.1

Czy Zamawiający w pozycji 1 pakiet 17 dopuści do postępowania cewnik dwuświatłowy długoterminowy poliuretanowy Smooth Flow do implantacji metodą Anterograde z opatentowaną konstrukcją końcówki, która umożliwi proste i precyzyjne umiejscowienie końcówki w prawym przedsionku, o stopniu recyrkulacji poniżej 1%, średnica 15,5 FR i długościach cewnika: 19/36 cm, 23/40 cm, 38/45 cm, 33/50 cm do wyboru przez Zamawiającego?

Charakterystyka zestawu:

- radiocieniujący cewnik
- silikonowe ramiona
- złącze typu PEEK odporne na ekstremalne obciążenia chemiczne i mechaniczne
- zacisk na cewnik ze skrzydełkami do mocowania na skórze
- wskaźniki wypełnienia, rozmiar i długość
- kompatybilny z MRI
- odporna na odkształcenia prowadnica „J” z wysoką zawartością tytanu zapewniająca wyjątkowo wysoką elastyczność i odporność na odkształcenia , dodatkowy komfort zapewnia powłoka z PTFE, która gwarantuje gładką powierzchnię i najwyższy poślizg
- zacisk cewnika ze skrzydełkami do mocowania na skórze
- igła wprowadzająca 18G

- Trokar
- rozszerzadło 12 Fr
- rozszerzadło 16 Fr z rozrywalną koszulką
- nasadki iniekcyjne Luer Lock

Szczegółowe informacje o produkcie w załączeniu.

Odp. Zamawiający nie dopuszcza. Zamawiający wymaga wszystkich długości cewnika 19cm, 23cm, 28cm, 33cm, 44cm, 55cm.

Pytanie nr 15 dot. pakietu nr 12, poz.1

Czy w pakiecie nr 12 pozycja 1 Zamawiający oczekuje zestawu o minimalnym składzie do cewnikowania o szerokim świetle w rozmiarze 12Fr/12,12Ga/16cm wykonane z poliuretanu, przewodnica stalowa 0,035"/60 cm na powierzchni ze znacznikami informującymi o głębokości wprowadzenia z jednej strony końcówka J z drugiej strony miękka końcówka umieszczona w pochewce w kształcie koła, osłona, ułatwiająca wprowadzanie cewnika rozszerzadło, igła punkcyjna 18Ga/6,35, igła punkcyjna w miękkiej kaniuli, rozszerzadło, skalpel, serweta chirurgiczna, strzykawka Raulersona 5 ml, skrzydełka mocujące?

Odp. Minimalny skład zestawu został określony w SWZ i nie obejmuje on serwet i strzykawki. Jeśli w/w zestaw spełnia minimalne parametry wymagane w SWZ to Zamawiający dopuści.

Pytanie nr 16 dot. pakietu nr 13, poz.1

Czy Zamawiający w pakiecie nr 13 pozycja 1 dopuści zestaw do cewnikowania o szerokim świetle z przedłużkami z możliwością dowolnego formułowania w rozmiarze 12Fr/12,12Ga/16cm wykonane z poliuretanu, przewodnica stalowa 0,038"/60 cm na powierzchni ze znacznikami informującymi o głębokości wprowadzenia z jednej strony końcówka J z drugiej strony miękka końcówka umieszczona w pochewce w kształcie koła, osłona, ułatwiająca wprowadzanie cewnika rozszerzadło, igła punkcyjna 18Ga/6,35, rozszerzadło, strzykawka o poj 5 ml,?

Odp. Wykonawca nie sprecyzował co oznacza „przedłużki z możliwością dowolnego formułowania”.

Pytanie nr 17 dot. pakietu nr 14, poz.1

Czy w pakiecie nr 14 pozycja 1 Zamawiający oczekuje zestawu o minimalnym składzie do cewnikowania o szerokim świetle w rozmiarze 12Fr/12,12Ga/20cm wykonane z poliuretanu, przewodnica stalowa 0,035"/68 cm na powierzchni ze znacznikami informującymi o głębokości wprowadzenia z jednej strony końcówka J z drugiej strony miękka końcówka umieszczona w pochewce w kształcie koła, osłona, ułatwiająca wprowadzanie cewnika rozszerzadło, igła punkcyjna 18Ga/6,35, igła punkcyjna w miękkiej kaniuli, rozszerzadło, skalpel, serweta chirurgiczna, strzykawka Raulersona 5 ml, skrzydełka mocujące?

Odp. Minimalny skład zestawu został określony w SWZ i nie obejmuje on serwet, strzykawki i skalpela. Jeśli w/w zestaw spełnia minimalne parametry wymagane w SWZ to Zamawiający dopuści.

Pytanie nr 18 dot. pakietu nr 6

Czy zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie igieł do hemodializy w rozmiarze 16G oraz 17G? Pozostałe zapisy zgodne z SWZ.

Odp. Zamawiający nie dopuszcza. Zamawiający wymaga igieł do hemodializy w rozmiarze 16G i 18G.

Pytanie nr 19 dot. pakietu nr 22, 23

Czy Zamawiający dopuści próbki niesterylne?

Odp. Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 20 dot. pakietu nr 22, poz. 1

Pakiet 22, pozycja 1, podłączenie, Czy zamawiający dopuści serwetę laminowaną 60g/m², 45 x 45 cm?

Odp. Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 21 dot. pakietu nr 22, poz. 1

Pakiet 22, pozycja 1 rozłączenie, Czy zamawiający dopuści tolerancję rozmiaru opatrunki +/- 0,2 cm?

Odp. Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 22 dot. pakietu nr 23

Pakiet 23 podłączenie, Czy zamawiający dopuści serwetę laminowaną 60g/m², 45 x 45 cm?

Odp. Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 23 dot. pakietu nr 23

Pakiet 23 rozłączenie, Czy zamawiający dopuści serwetę laminowaną 60g/m², 45 x 45 cm?

Odp. Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 24 dot. projektu umowy

W celu zapewnienia równego traktowania stron umowy i umożliwienia Wykonawcy sprawdzenia zasadności reklamacji wnosimy o wprowadzenie w § 3 ust. 6 projektu umowy 5 dniowego terminu na rozpatrzenie reklamacji oraz zamianę słów „...od dnia powiadomienia o wadze” na „...od dnia uznania reklamacji”.

Odp. Zamawiający nie zmienia projektu umowy w w/w zakresie.

Pytanie nr 25 dot. projektu umowy

Czy Zamawiający uzupełni projekt umowy o zapis, że na podstawie art. 106n ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług udziela Wykonawcy zgody na wystawianie i przesyłanie faktur, duplikatów faktur oraz ich korekt, a także not obciążeniowych i not korygujących w formacie pliku elektronicznego PDF na wskazany przez siebie adres poczty e-mail, ze wskazanych w umowie adresów poczty e-mail Wykonawcy?

Odp. Zamawiający nie zmienia projektu umowy w w/w zakresie.

Pytanie nr 26 dot. projektu umowy

Czy w celu miarkowania kar umownych Zamawiający dokona modyfikacji postanowień projektu przysłej umowy w zakresie zapisów § 6 ust. 1:

Wykonawca zobowiązany jest do zapłaty Zamawiającemu następujących kar umownych:

- 1) za zwłokę w dostarczeniu poszczególnych partii Przedmiotu Zamówienia
- w wysokości 0,3% wartości netto zamówionej partii Przedmiotu Zamówienia za każdy dzień zwłoki Przedmiotu Zamówienia, **jednak nie więcej niż 10% wartości netto niedostarczonej w terminie partii Przedmiotu Zamówienia**
- 2) za zwłokę w wymianie wadliwego Przedmiotu Zamówienia na wolny od wad
- w wysokości 0,3% wartości netto **wadliwej części** Przedmiotu Zamówienia podlegającego wymianie za każdy dzień zwłoki, **jednak nie więcej niż 10% wartości netto wadliwej części zamówienia**
- 3) w przypadku nieprzedłożenia przez Wykonawcę w wyznaczonym terminie dokumentów, o których mowa w § 2 ust. 5 pkt 1), w wysokości **250 zł** (słownie: dwieście pięćdziesiąt złotych) za każdy przypadek,
- 4) w przypadku rozwiązania lub odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w wysokości **10%** wartości **niezrealizowanej części** wynagrodzenia netto określonego w § 5 ust. 2

Odp. Zamawiający nie zmienia projektu umowy w w/w zakresie.

Pytanie nr 27 dot. pakietu nr 22

Dotyczy pakietu nr 22 - Do podłączania i odłączania dializy – przetoka.

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie zestawu o poniższych parametrach, niegdyś z powodzeniem stosowany przez Zamawiającego.


Podłączenie :

- 1 szt. Serweta podfoliowana Hospidrape 38x45cm, 44g/m²
- 2 szt. Rękawiczki nitrylowe bezpudrowe, teksturowane, mankiety wywinęte rozmiar M
- 1 szt. Przyklepiec włókninowy pokryty hypoalergicznym klejem akrylowym 2,5cm - 4 paski - 15,5cm
- 6 szt. Kompresy włókninowe 7,5x7,5cm, 4 warstwy, 30g
- 2 szt. Hypoalergiczny opatrunek włókninowy z wkładem chłonnym do mocowania kaniul 6x8cm

Odłączenie :

- 2 szt. Rękawiczki nitrylowe bezpudrowe, teksturowane, mankiety wywinęte rozmiar M
- 1 szt. Rękawiczka winylowa bezpudr. L
- 4 szt. Kompresy włókninowe 7,5x7,5cm, 4 warstwy, 30g
- 2 szt. Hypoalergiczny opatrunek włókninowy z wkładem chłonnym 7x5cm 2

Opakowanie jednostkowe typu "zestaw w zestaw". Odłączenie w oddzielnym opakowaniu umieszczona z pozostałymi komponentami w opakowaniu papierowo-foliowym.

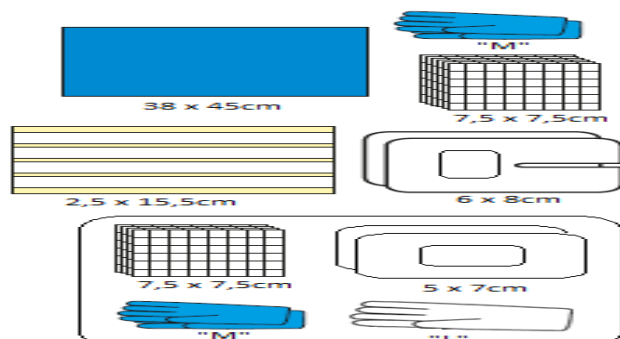

Odp. Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 28 dot. pakietu nr 23

Dotyczy pakietu nr 23 - Do podłączenia i odłączenia dializy – cewnik.

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie zestawu o poniższych parametrach, niegdyś z powodzeniem stosowany przez Zamawiającego.


Podłączenie :

- 2 szt. Serweta podfoliowana Hospidrape 38x45cm, 44g/m2
- 2 szt. Rękawiczki nitrylowe bezpudrowe, rozmiar M
- 1 szt. Opatrunek włókninowy z wkładem chłonnym 10x10cm
- 8 szt. Kompresy włókninowe 7,5x7,5cm, 4 warstwy, 30g

Odłączenie :

- 1 szt. Serweta podfoliowana Hospidrape 38x45cm, 44g/m2
- 2 szt. Rękawiczki nitrylowe bezpudrowe, rozmiar M
- 8 szt. Kompresy włókninowe 7,5x7,5cm, 4 warstwy, 30g
- 1 szt. Opatrunek włókninowy z wkładem chłonnym 10x10cm

Opakowanie jednostkowe typu "zestaw w zestaw". Odłączenie w oddzielnym opakowaniu umieszczona z pozostałymi komponentami w opakowaniu papierowo-foliowym.

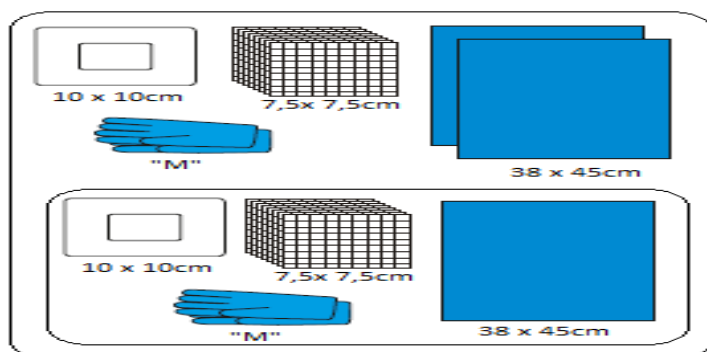

Odp. Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 29 dot. pakietu nr 23

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie zestawu przeznaczonego do podłączenia i odłączenia dializy przez cewnik o następującym składzie:

1. Część do podłączenia dializy - START:
 - a. Serweta z laminatu 50x40cm z nacięciem, gramatura min. 40 g/m² - 1szt.
 - b. Rękawice nitrylowe teksturowane M - 2szt. niebieskie
 - c. Rękawice nitrylowe teksturowane M - 2szt. ciemny niebieski
 - d. Kompresy z włókniny 7,5x7,5cm - 6szt.
 - e. Przylepiec włókninowy 2x15cm - 1szt.
2. Część do odłączenia dializy – END:
 - a. Rękawice nitrylowe teksturowane M - 2szt. niebieskie
 - b. Kompresy z włókniny 7,5x7,5cm 4szt.
 - c. Przylepiec włókninowy 2x15cm 2szt.

Zestawy pakowane w opakowanie papierowo-foliowe typu dwupak z perforacją umożliwiającą nieinwazyjne rozdzielanie części. Na opakowaniu podwójna etykieta samoprzylepna identyfikująca wyrób.

Odp. Zamawiający nie dopuszcza, ponieważ brak opatrunków włókninowych.

**Kierownik
Dział Zamówień Publicznych
Małgorzata Słomiana**

*Dział Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia
Sporządziła: Dorota Piekarcz
nr tel.: 74/6489700*