



Pleszewskie Centrum Medyczne
w Pleszewie
Sp. z o.o.



Szpital
Akredytowany

Znak sprawy Te 2300 -22/2022

Pleszew, dn. 30.09.2022 r.

Do Wszystkich Zainteresowanych

Dotyczy: postępowania na dostawę materiałów opatrunkowych, bielizny operacyjnej, obłożeń oraz pieluchomajtek dla szpitala w Pleszewie.

Szanowni Państwo!

Poniżej przedstawiamy treść pytań zadanych przez Wykonawców, dotyczących niniejszego postępowania oraz odpowiedzi na te pytania.

Pytanie nr 1 – dotyczy Zadania nr 3 poz. 1-3

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie opasek gipsowych o zawartości gipsu min. 91%, spełniających pozostałe wymagania zawarte w SWZ?

Odpowiedź: Tak, - Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 2 – dotyczy Zadania nr 3 poz. 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie opasek gipsowych o szerokości , spełniających pozostałe wymagania zawarte w SWZ?

Odpowiedź: Zamawiający nie udziela odpowiedzi ponieważ pytający nie podał wymiaru opasek.

Pytanie nr 3 – dotyczy ilości próbek – zadanie nr 13

Mając na względzie ochronę środowiska i obniżenie kosztów związanych z utylizacją, zwracamy się z uprzejmą prośbą o zmniejszenie ilości próbek do minimum koniecznego do dokonania oceny jakości (np. do 10szt)

Odpowiedź: Nie, - Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 4 – dotyczy Zadania nr 28

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w zadaniu nr 28 niżej opisanego zestawu?

Zestaw do cięć cesarskich

1 taśma przylepna 9 x 50 cm

1 wzmocniona osłona na stolik Mayo 79 x 145 cm, wzmocnienie 65 x 85 cm

4 ręczniki do osuszania rąk 30,5 x 34 cm

1 serwetka do owinięcia dziecka 75 x 120 cm



Pleszewskie Centrum Medyczne
w Pleszewie
Sp. z o.o.



Szpital
Akredytowany

1 serweta do cięcia cesarskiego 180/250 x 330 cm z torbą na płyny 72 x 72 cm, folia operacyjna z otworem 18 x 16 cm, organizatory przewodów, 2 porty do ssaka

1 serweta na stół do instrumentarium 150 x 190 cm, wzmocnienie 75 x 190 cm

Obłożenie na całej powierzchni wykonane z laminatu dwuwarstwowego PE+PP (polietylen+polipropylen) o gramaturze 60g/m²

Odpowiedź: Tak, - Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 5 – dotyczy Zadania nr 28

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w zadaniu nr 28 niżej opisanego zestawu?

1 taśma przylepna 9 x 50 cm

1 wzmocniona osłona na stolik Mayo 79 x 145 cm, wzmocnienie 65 x 85 cm

4 ręczniki do osuszania rąk 30,5 x 34 cm

1 serwetka do owinięcia dziecka 75 x 120 cm

1 serweta do cięcia cesarskiego 230 x 330 cm z torbą na płyny 72 x 72 cm, folia operacyjna 36 x 36 cm, organizatory przewodów, 2 porty do ssaka

1 serweta na stół do instrumentarium 150 x 190 cm, wzmocnienie 75 x 190 cm

Obłożenie na całej powierzchni wykonane z laminatu dwuwarstwowego PE+PP (polietylen+polipropylen) o gramaturze 60g/m²

Odpowiedź: Nie, - Zamawiający nie wyraża zgody. Brak otworu w folii.

Pytanie nr 6 – dotyczy ilości próbek – zadanie nr 28

Mając na względzie ochronę środowiska i obniżenie kosztów związanych z utylizacją, zwracamy się z uprzejmą prośbą o zmniejszenie ilości próbek do 1 zestawu, na podstawie których Zamawiający będzie mógł dokonać oceny zgodności zaoferowanego asortymentu z wymaganiami. Ponadto pragniemy nadmienić, iż zgodnie z zapisami SWZ kryterium oceny nie stanowi ocena jakości.

Odpowiedź: Tak.

Pytanie nr 7 – dotyczy Zadania nr 31

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie kompresów włókninowych klasy IIa reguła 7?

Odpowiedź: Tak, - Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 8 – dotyczy Zadania nr 35

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie niżej opisanego zestawu, minimalnie różniącego się od opisanego w SWZ?

Zestaw serwet, uniwersalnych wykonany z chłonnego, wytrzymałego i nieprzemakalnego laminatu dwuwarstwowego o gramaturze 60g/m² z dodatkowym padem chłonnym o gramaturze 80g/m² (łącznie gramatura 140g/m²)

a) Serweta samoprzylepna o wymiarach 150x240cm wzmocnienie o wymiarach **15x50cm + organizatory przewodów** - 1 szt.

b) Serweta samoprzylepna o wymiarach 180x180cm, wzmocnienie o wymiarach **15x50cm + organizatory**



Pleszewskie Centrum Medyczne
w Pleszewie
Sp. z o.o.



Szpital
Akredytowany

przewodów- 1 szt.,

c) Serwety boczne samoprzylepne o wymiarach 90 cm x 75 cm, wzmocnione o wymiarach **15x50cm +**

organizatory przewodów - 2 szt.,

d) Pokrowiec na stół MAYO o wymiarach 79x145 cm - 1 szt

e) Ściereczki chłonne - 4 szt.

f) Taśma włókninowa samoprzylepna o wymiarach **9** x 50 cm - 1 szt.

h) Całość owinięta w serwetę wzmocnioną o wymiarach 150x190cm - 1 szt., która może służyć jako przykrycie stolika instrumentalnego,

i) Całość zapakowana w torebkę **Tyvec-folia**, zaopatrzona w etykietę samoprzylepną, z możliwością wklejenia jej do dokumentacji, umożliwiającą identyfikację wyrobu,

Odporność na penetrację płynów w obszarze krytycznym (nieprzemakalność) 165cmH₂O

Przedmiot zamówienia wykonany zgodnie z normą PN-EN **13795-1:2019**

Odpowiedź: Nie, - Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 9 – dotyczy Zadania nr 46

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie niżej opisanego zestawu?

Zestaw do operacji stawu biodrowego

2 taśmy przylepne 9 x 50 cm

1 wzmocniona osłona na stół Mayo 79 x 145 cm, wzmocnienie 65 x 85 cm

1 osłona na kończynę 36 x 120 cm

1 serweta 100 x 150 cm

1 przylepna serweta średnia 150 x 300 cm z padem chłonnym 15 x 50 cm i organizatorami przewodów

1 serweta 230 x 260 cm z wycięciem „U” 20 x 85 cm z padem chłonnym 50 x 100 cm i organizatorami przewodów

1 serweta na stół do instrumentarium 150 x 190 cm, wzmocnienie 75 x 190 cm, stanowiąca owinięcie zestawu

Serwety główne wykonane z laminatu dwuwarstwowego PE+PP o gramaturze 60g/m² z dodatkowym padem chłonnym o gramaturze 80g/m². Całkowita gramatura w części wzmocnionej 140g/m². Odporność na penetrację płynów 165cm H₂O

Całość zapakowana w torebkę Tyvec-folia, zaopatrzoną w etykietę samoprzylepną z możliwością wklejenia do dokumentacji, umożliwiającą identyfikację wyrobu. Przedmiot zgodny z normą PN-EN 13795-1:2019 oraz dyrektywą 93/42EEC

Odpowiedź: Tak, - Zamawiający wyraża zgodę.



Pleszewskie Centrum Medyczne
w Pleszewie
Sp. z o.o.



Szpital
Akredytowany

Pytanie nr 10 – dotyczy Zadania nr 48

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie niżej opisanego zestawu?

Zestaw do operacji kończyn

2 taśmy przyklepne 9 x 50 cm

1 wzmocniona osłona na stół Mayo 79 x 145 cm, wzmocnienie 65 x 85 cm wykonana z folii PE o gramaturze 55g/m² i wzmocnienia z laminatu dwuwarstwowego (PE+PP) o gramaturze 85g/m². Całkowita gramatura w części wzmocnionej 140g/m². Osłona w postaci worka, składana w sposób ułatwiający założenie z zachowaniem zasad aseptyki z zaznaczonym kierunkiem rozwijania.

4 ręczniki do osuszania rąk 30,5 x 34 cm

1 elastyczna osłona na kończynę 22 x 75 cm

1 serweta 150 x 190 cm

1 serweta do operacji kończyn 230 x 300 cm z elastycznym otworem o średnicy 7 cm z padem chłonnym 50 x 100 cm i organizatorami przewodów

1 serweta na stół do instrumentarium 150 x 190 cm, wzmocnienie 75 x 190 cm, stanowiąca owinięcie zestawu

Serweta główna wykonana z laminatu trzywarstwowego PP+PE+PP o gramaturze 75g/m² z dodatkowym padem chłonnym o gramaturze 80g/m². Całkowita gramatura w części chłonnej 155g/m². Odporność na penetrację płynów 165cm H₂O

Całość zapakowana w torebkę Tyvec-folia, zaopatrzoną w etykietę samoprzylepną z możliwością wklejania do dokumentacji, umożliwiającą identyfikację wyrobu. Odporność na penetrację płynów w obszarze krytycznym (nieprzemakalność) 165 cm H₂O. Przedmiot zgodny z normą PN-EN 13795-1:2019 oraz dyrektywą 93/42EEC

Odpowiedź: Nie, - Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 11 – dotyczy Zadania nr 52

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie fartuchów zgodnych z wymaganiami obecnie obowiązującej normy EN 13795-1:2019, zawierających 4 etykiety do dokumentacji z nr REF, LOT, datą ważności, nazwą marki, dodatkowo na 2 etykietach kod kreskowy

Odpowiedź: Tak, - Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie 12 - Pakiet 61 pozycja 1:

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania folię jałową z gumką do osłony szyby chroniącej przed promieniowaniem RTG o wymiarach 95 x 115 cm ?

Odpowiedź: Tak, - Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 13 - Pakiet 13, poz. 1

Proszę o doprecyzowanie jakiego opatrunku wymaga Zamawiający ? Poliuretanowego czy włókninowego ?

Odpowiedź: Zamawiający nie określa rodzaju opatrunku, wybór uzależniony jest od oceny jakości.



Pleszewskie Centrum Medyczne
w Pleszewie
Sp. z o.o.



Szpital
Akredytowany

Pytanie 14 - Pakiet 51, poz. 1

Proszę o dopuszczenie czepków wiązanych na troki

Odpowiedź: Tak , - Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 15 - Pakiet 51, poz. 5

Proszę o dopuszczenie koszuli dla pacjenta z rozcięciem z tyłu.

Odpowiedź: Nie,- Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 16 - Pakiet 51, poz. 6

Proszę o dopuszczenie ochraniaczy o wymiarach 41x16cm

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 17 - Pakiet 51, poz. 7

Proszę o dopuszczenie fartuchów o gramaturze 20 g/m²

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 18

Czy Zamawiający uzupełni projekt umowy o zapis, że na podstawie art. 106n ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług udziela Wykonawcy zgody na wystawianie i przysyłanie faktur, duplikatów faktur oraz ich korekt, a także not obciążeniowych i not korygujących w formacie pliku elektronicznego PDF na wskazany przez siebie adres poczty e-mail, ze wskazanych w umowie adresów poczty e-mail Wykonawcy?

Odpowiedź: Tak.

Pytanie 19

Czy w celu miarkowania kar umownych Zamawiający dokona modyfikacji postanowień projektu przyszłej umowy w zakresie zapisów § 6 ust. 1, 2:

1. W przypadku nie dostarczania towaru w terminie określonym w umowie, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,5% wartości brutto towaru nie dostarczonego w terminie za każdy dzień zwłoki, **jednak nie więcej niż 10% wartości brutto niedostarczonego w terminie towaru.**
2. W przypadku nie dokonania wymiany towaru wadliwego na wolny od wad w terminie określonym w § 5 ust. 2 za każdy dzień zwłoki Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,5% wartości brutto reklamowanego towaru, **jednak nie więcej niż 10% wartości brutto reklamowanego towaru.**

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie wprowadzi proponowanych zapisów.



Pleszewskie Centrum Medyczne
w Pleszewie
Sp. z o.o.



Szpital
Akredytowany

Pytanie 20 - Pakiet nr 51, poz. 6

Czy Zamawiający dopuści ochraniacze o wymiarach 41 x 15 cm, rozmiar XL?

Odpowiedź: Nie, - Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 21 - Pakiet nr 51, poz. 7

Czy Zamawiający dopuści fartuchy w rozmiarach L (min. 115 x 136 cm) i XL (min. 125 x 150 cm)?

Odpowiedź: Nie. Zgodnie z SWZ.

Pytanie 22 - Pakiet nr 52

Czy Zamawiający dopuści fartuchy pojedynczo składane, opakowanie zbiorcze – torba foliowa a`100 szt.?

Odpowiedź: Tak , - Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 23 - Zadanie 13

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie opatrunku w rozmiarze 6 x 7,5 cm?

Odpowiedź: Tak, - Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie 24 - Zadanie nr 28

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawu serwet do cięć cesarskich wykonanego z laminatu

dwuwarstwowego (włóknina polipropylenowa i folia polietylenowa) o gramaturze min. 55 g/m2 o następującym składzie:

1 serweta na stolik instrumentariuszki 150 cm x 190 cm

4 ręczniki 30 cm x 40 cm

1 serweta na stolik Mayo 80 cm x 145 cm

1 serweta dla noworodka 90 cm x 100 cm z miękkiej włókniny

1 serweta do cesarskiego cięcia 260/200 cm x 335 cm do zabiegów w pozycji z nogami prostymi, z otworem 27 cm x 33 cm w okolicy jamy brzusznej otoczonym folią operacyjną, okno 14 cm x 20 cm, zintegrowaną torbą na płyny w rozmiarze 80 cm x 84 cm z usztywnieniem na całym obwodzie z lejkiem odprowadzającym płyny oraz zintegrowanymi osłonami podpórek kończyn górnych

Odpowiedź: Tak, - Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie 25 - Zadanie nr 32

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie kompresów gazowych niejałowych klasa I, reguła 4?

Odpowiedź: Tak, - Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie 26 - Zadanie nr 33

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie opatrunku w rozmiarze 6 x 7,5 cm?

Odpowiedź: Nie, - Zamawiający nie wyraża zgody.



Pleszewskie Centrum Medyczne
w Pleszewie
Sp. z o.o.



Szpital
Akredytowany

Pytanie 27 - Zadanie nr 35

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na możliwość zaoferowania zestawu serwet uniwersalnych o następującym składzie:

1 serweta na stół instrumentariuszki 150 cm x 190 cm

4 ręczniki 30 cm x 40 cm

1 serweta na stół Mayo 80 cm x 145 cm

1 taśma samoprzylepna 9 cm x 50 cm

2 samoprzylepne serwety operacyjne wzmocnione 75 cm x 90 cm

1 samoprzylepna serweta operacyjna wzmocniona 175 cm x 180 cm

1 samoprzylepna serweta operacyjna wzmocniona 150 x 250 cm

Obłożenie pacjenta wykonane z laminatu dwuwarstwowego (włókna polipropylenowa i folia polietylenowa) o gramaturze min. 57 g/m². Wokół pola operacyjnego, na każdej z serwet polipropylenowa łąta chłonna o wymiarach 20 x 50 cm. Całkowita gramatura laminatu podstawowego i łąty chłonnej 109 g/m². Odporność na penetrację płynów w obszarze krytycznym 174 cm H₂O. Materiał obłożenia spełnia wymagania wysokie normy PN EN 13795. Zestaw posiada min. 2 etykiety samoprzylepne zawierające nr katalogowy, LOT, datę ważności oraz dane producenta.

Odpowiedź: Tak, - Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie 28 - Zadanie nr 42

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na możliwość zaoferowania serwety w rozmiarze 45 x 70 cm z włókniyny o gramaturze 40,6 g/m²?

Odpowiedź: Nie, - Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 29 - Zadanie nr 43

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na możliwość zaoferowania serwety w rozmiarze 75 x 90 cm?

Odpowiedź: Nie, - Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 30 - Zadanie nr 44 poz. 3

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na możliwość zaoferowania kieszeni samoprzylepnej w rozmiarze 38 x 40 cm?

Odpowiedź: Tak, pozostałe parametry zgodnie z SWZ. Dopuszczamy kieszeń 2-sekcyjną.

Pytanie 31 - Zadanie nr 44 poz. 4

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na możliwość zaoferowania kieszeni samoprzylepnej w rozmiarze 25 x 45 cm?

Odpowiedź: Nie, - Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 32 - Zadanie nr 48

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na możliwość zaoferowania zestawu o następującym składzie:

1 serweta na stół instrumentariuszki 150 cm x 190 cm

2 ręczniki 30 cm x 40 cm

1 serweta na stół Mayo 80 cm x 145 cm

1 osłona ortopedyczna na kończynę 33 cm x 55 cm

1 taśma foliowa samoprzylepna 10 cm x 50 cm

1 serweta operacyjna 180 cm x 150 cm

1 serweta na kończynę 225 cm x 320 cm z samouszczelniającym się otworem o średnicy 7 cm i dwoma zintegrowanymi uchwytami do mocowania przewodów i drenów

Obłożenie pacjenta wykonane z laminatu dwuwarstwowego (włóknina polipropylenowa i folia polietylenowa) o gramaturze min. 57 g/m². Wokół pola operacyjnego polipropylenowa łata chłonna o wymiarach 100 cm x 50 cm. Całkowita gramatura laminatu podstawowego i łaty chłonnej min. 109 g/m². Odporność na penetrację płynów w obszarze krytycznym 174 cm H₂O. Materiał obłożenia spełnia wymagania wysokie normy PN EN 13795. Zestaw posiada min. 2 etykiety samoprzylepne zawierające nr katalogowy, LOT, datę ważności oraz dane producenta.

Odpowiedź: Nie, - Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 33 - Zadanie nr 52 poz. 2

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie fartuchów chirurgicznych z nieprzemakalnymi wzmocnieniami w części przedniej fartucha i na rękawach o gramaturze 28 g/m²? Pozostałe parametry zgodne z SWZ.

Odpowiedź: Nie, - Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 34 - Zadanie nr 75

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na możliwość zaoferowania zestawu ginekologicznego w następującym składzie:

1 serweta na stół instrumentariuszki 150 cm x 190 cm

2 ręczniki 30 cm x 40 cm

1 serweta na stół Mayo 80 cm x 145 cm

1 taśma samoprzylepna 9 cm x 50 cm

1 serweta samoprzylepna (folia PE) 50 cm x 50 cm

1 serweta ginekologiczna wzmocniona 230 cm x 240/260 cm ze zintegrowanymi osłonami na kończyny dolne, z otworem na krocze 10 cm x 15 cm, ze zintegrowaną torbą na płyny z siłkiem i zaworem

Obłożenie pacjenta wykonane z laminatu dwuwarstwowego (włóknina polipropylenowa i folia polietylenowa) o gramaturze min. 57 g/m². Wokół pola operacyjnego polipropylenowa łata chłonna. Całkowita gramatura laminatu podstawowego i łaty chłonnej min. 109 g/m².

Odpowiedź: Tak, - Zamawiający dopuszcza.



Pleszewskie Centrum Medyczne
w Pleszewie
Sp. z o.o.



Szpital
Akredytowany

Pytanie 35 - Zadanie 1, poz. 1-3

Czy zamawiający dopuści opaskę dzianą podtrzymującą wykonaną z przędzy poliestrowej 100%, gdyż włókna wiskozowe stosowane jako zamiennik poliestru są niezbyt wytrzymałe, gniotą się oraz elektryzują, co wpływa niekorzystnie na komfort pacjenta?

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

Pytanie 36 - Zadanie 1, poz. 4-5

Czy zamawiający dopuści opaskę dzianą elastyczną wykonaną z 100% włókien syntetycznych tj: poliestrowych i poliamidowych posiadające rozciągliwość powyżej 130 % z zapinką wewnątrz opakowania indywidualnego?

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

Pytanie 37 - Zadanie 6

Czy zamawiający dopuszcza wycenę za opakowanie 100 mb. z przeliczeniem ilości?

Czy zamawiający dopuści gazę sklasyfikowaną w klasie I reg.4 ? Oferowana gaza jest produktem niesterylnym, w związku z tym nie używa się jej w zabiegach medycznych wysokiego ryzyka i nie zachodzi potrzeba, aby była sklasyfikowana w klasie II a reg.7.

Odpowiedź: Tak, - Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 38 - Zadanie 13

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie wyceny za najmniejsze opakowanie handlowe 50 szt. z przeliczeniem ilości z zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań.

Odpowiedź: Tak, Zamawiający nie sprecyzował wielkość opakowania handlowego.

Pytanie 39 - Zadanie 32, poz. 1-3

Czy zamawiający dopuści kompresy sklasyfikowane w klasie I reg.4 ?

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

Pytanie 40 - Zadanie 34, poz. 1-5

Czy zamawiający dopuści kompresy sklasyfikowane w klasie I reg.4 ?

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

Pytanie 41 - Zadanie 34, poz. 1-5

Czy zamawiający dopuści wycenę za opakowanie 'a 2 szt. w blisterze x 25 szt. blisterów, z przeliczeniem ilości i zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań?

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

Pytanie 42 - Zadanie 36

Czy zamawiający dopuści serwetę 4 warstwową, 17 nitkową, z nitką RTG i tasiemką, o wymiarach 45 cm x 45 cm, pakowaną indywidualnie, sterylną?



Pleszewskie Centrum Medyczne
w Pleszewie
Sp. z o.o.



Szpital
Akredytowany

- Czy zamawiający dopuści wyroby z gazy sklasyfikowane w klasie I reg.4 ?
- Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie wyceny za najmniejsze opakowanie handlowe 1 szt. z przeliczeniem ilości.

Odpowiedź: Nie, - Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 43 - Zadanie 51, poz. 6

Czy zamawiający dopuści ochraniacze o dł. Ok. 40 cm, wysokości ok. 16 cm?

Odpowiedź: Nie, - Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 44 - Zadanie 51, poz. 7

Czy zamawiający dopuści gramaturę min. 20 g/m²?

Czy zamawiający dopuści rozmiar uniwersalny?

Odpowiedź: Nie, - Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 45 - Zadanie 53

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie wyceny za najmniejsze opakowanie handlowe 100 szt. z przeliczeniem ilości z zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań.

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

Pytanie 46 - Zadanie 58

Czy zamawiający dopuści medyczny podkład ochronny, trzywarstwowy o wymiarach 33 cm x 25 cm, z perforacją co 50 cm, wykonany z 2 x warstwa bibuły i 1 x warstwa folii, nieprzemakalny, o gramaturze 54 g/m²; wyrób medyczny klasy I; powierzchnia podkładu tłoczona; zakończenie brzegów – bez postrzępień; wyrób odporny na rozdieranie, gramatura bibuły: 36 ± 0,10 g/m²; minimalna chłonność 160 g/m²; grubość folii 22 ± 2 μm, 50 listków?

Odpowiedź: Nie, -Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 47 - Zadanie nr 58, pozycja nr 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie podkładu papierowo-foliowego o gramaturze: celuloza 23g/m² + folia PE 10g/m², o wymiarach 50cm x 50m, z perforacją co 38cm?

Odpowiedź: Nie, - Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 48

Czy zamawiający wyrazi zgodę w zadaniu nr 52 aby w pozycji nr 1 również złożyć ofertę na fartuchy z dodatkowymi nieprzemakalnymi wzmocnieniami. Otrzymają Państwo produkt wysokiej jakości zwiększającej bezpieczeństwo personel jaki pacjenta.

Odpowiedź: Tak, - Zamawiający wyraża zgodę.



Pytanie 49

Czy zamawiający dopuści zestaw pakiet nr 46 zestaw 1505-01 specyfikacja w załączniku oraz w pakiecie 59 zestaw 1231-100 specyfikacja w załączniku Umożliwi to zwiększenie jakości i bezpieczeństwa pracy.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zestaw do pakietu nr 46 o gramaturze min 55g/m².

Pakiet 59 dotyczy sterylnego pokrowca na przewody nastąpiła pomyłka, przesłany zestaw jest do operacji kończy pakiet 48.

Pytanie 50 - Zadanie 54.

Czy Zamawiający dopuści wyprofilowany (anatomiczny) wkład (pieluchę) zawierający superabsorbent, o szerokości maks. 12,5 cm?

Odpowiedź: Tak, - Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 51- Zadanie 3, pozycja 1-3

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie opaski gipsowej o zawartości gipsu naturalnego 94%?

Odpowiedź: Tak, - Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie 52 - Zadanie 3, pozycja 1-3

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie opaski gipsowej o czasie wiązania 5-6minut?

Odpowiedź: Tak, - Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie 53 - Zadanie 14, pozycja 3

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie opatrunku w rozmiarze 10x15cm?

Odpowiedź: Nie, - Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 54 - Zadanie 14, pozycja 3

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie opatrunku z wkładem chłonnym w rozmiarze 10x25cm?

Odpowiedź: Nie, - Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 55 - Zadanie 14, pozycja 3

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie opatrunku z wkładem chłonnym w rozmiarze 10x20cm?

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

Pytanie 56 - Zadanie 16, pozycja 1-1a

Czy Zamawiający dopuści samoprzylepne opatrunki hydrokoloïdowe z CMC i alginianem wapnia do zaopatrywania ran, z 3-częściowym systemem folii ochronnych zapewniającym aseptyczną aplikację, z półprzepuszczalną poliuretanową warstwą zewnętrzną z siatką umożliwiającą monitorowanie stanu rany i ocenę optymalnej częstotliwości zmiany opatrunku, bez zawartości pektyn, powszechnych alergenów, takich jak lateks czy kalafonia, ani odzwierzęcych produktów pochodnych, takich jak żelatyna?

Odpowiedź: Nie, - Zamawiający nie dopuszcza.



Pytanie 57 - Zadanie 16, pozycja 2

Czy Zamawiający dopuści sterylny, bezbarwny, bezpostaciowy żel hydrokoloidowy z alginianem wapnia do autolitycznego oczyszczania oraz utrzymywania wilgotnego środowiska leczenia w ranach, wskazany w leczeniu ran martwiczych lub z oddzielającą się tkanką martwiczą, w formie tuby z harmonijkowym aplikatorem do bezpośredniej aplikacji na ranę?

Odpowiedź: Nie, - Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 58 - Zadanie 17, pozycja 3

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie opatrunku w rozmiarze 20x25cm?

Odpowiedź: Nie, - Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 59 - Zadanie 19, pozycja 1-3

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie opatrunku impregnowanego parafiną?

Odpowiedź: Tak, - Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie 60 - Zadanie 27, pozycja 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie tupferów pakowanych a'10 szt. z przeliczeniem zamawianej ilości?

Odpowiedź: Nie, - Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 61 - Zadanie 27, pozycja 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie tupferów w kształcie fasolki?

Odpowiedź: Nie, - Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 62 - Zadanie 28, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści serwetę do cesarskiego cięcia z otworem 30 x 30 cm wypełnionym folią chirurgiczną z wycięciem?


Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

Zadanie 63, pozycja 1 – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawu serwet do cięć cesarskich, obłożenie wykonane z hydrofobowej włókniny trójwarstwowej typu SMS o gramaturze 50 g/m², o składzie:

- 1 x serweta wzmocniona na stół instrumentalny (owinięcie zestawu) o wymiarach 150 cm x 190 cm
- 4 x ręcznik chłonny o wymiarach 30 cm x 30 cm
- 1 x wzmocniona osłona (serweta) na stolik Mayo o wymiarach 80 cm x 140 cm
- 1 x serweta chłonna dla noworodka o wymiarach 75 cm x 80 cm
- 1 x serweta do cesarskiego cięcia, samoprzylepna o wymiarach 200 cm x 320 cm z otworem o wymiarach 25 cm x 30 cm wypełnionym folią chirurgiczną, zintegrowana z torbą do zbiórki płynów o wymiarach 75 cm x 85 cm



- 1 x taśma samoprzylepna o wymiarach 10 cm x 50 cm

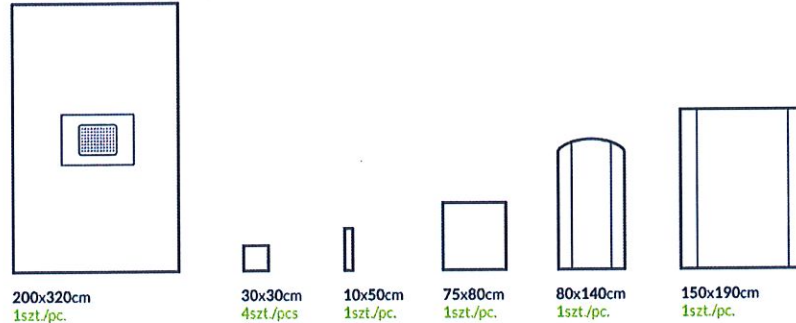

Odpowiedź: Nie, - Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 64 - Zadanie 31, pozycja 1-3

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie kompresów zakwalifikowanych do klasy IIa reguła 7?

Odpowiedź:

Pytanie 65 - Zadanie 33, pozycja 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie opatrunku do mocowania kaniul w rozmiarze 5,1x7,6cm?

Odpowiedź: Nie, - Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 66 - Zadanie 36, pozycja 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie serwet 17-nitkowych?

Odpowiedź: Nie, - Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 67 - Zadanie 36, pozycja 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie serwet 4-warstwowych?

Odpowiedź: Nie, - Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 68 - Zadanie 36, pozycja 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie serwet w rozmiarze 45x45cm?

Odpowiedź: Tak, - Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie 69 - Zadanie 36, pozycja 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie serwet pakowanych a'3 sztuki?

Odpowiedź: Nie, - Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 70 - Zadanie 39, pozycja 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie serwet o gramaturze min. 40g/m²?

Odpowiedź: Nie, - Zamawiający nie wyraża zgody.



Pleszewskie Centrum Medyczne
w Pleszewie
Sp. z o.o.



Szpital
Akredytowany

Pytanie 71 - Zadanie 42, pozycja 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie serwety o gramaturze 40g/m²?

Odpowiedź: Nie, - Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 72 - Zadanie 44, pozycja 2

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie serwet 17 nitkowych?

Odpowiedź: Nie, - Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 73 - Zadanie 44, pozycja 2

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie serwet w rozmiarze 45x45cm?

Odpowiedź: Tak, Pozostałe parametry bez zmian.

Pytanie 74

Zadanie 44, pozycja 3 – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie kieszeni o wymiarach 40 x 30 cm, opakowanie posiada 4 etykiety samoprzylepne do archiwizacji danych?

Odpowiedź: Tak ale kieszeni 2 sekcyjnej, pozostałe parametry bez zmian.

Pytanie 75 - Zadanie 44, pozycja 4

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie kieszeni 2 sekcyjnej o wymiarach 40 x 30 cm (kieszeń lewa 15 x 30 cm, kieszeń prawa 25 x 30 cm), opakowanie posiada 4 etykiety samoprzylepne do archiwizacji danych?

Odpowiedź: Nie, - Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 76 - Zadanie 45, pozycja 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie serwety 180/270 cm x 220 cm zintegrowanej z osłonami na kończyny, z otworem samoprzylepnym w kształcie trapezu o wymiarach 30 cm x 20 cm x 20 cm oraz otworem w okolicy krocza o wymiarach 10 cm x 15 cm zabezpieczonym kłapką?

Odpowiedź: Tak, - Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie 77 - Zadanie 45, pozycja 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie serwety na stolik instrumentariuszki wykonanej z warstwy nieprzemakalnej folii PE o gramaturze 40 g/m², wzmocnionej hydrofilową włókniną wiskozowo-poliestrową o wymiarach 65 cm x 190 cm i gramaturze 30 g/m², o łącznej gramaturze w strefie chłonnej - 70 g/m²?

Odpowiedź: Tak, - Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie 78 - Zadanie 46, pozycja 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie sterylne go zestawu do operacji stawu biodrowego o składzie:

- 1 x serweta samoprzylepna 200 cm x 260 cm , z wycięciem "U" o wymiarach 8,5 cm x 85 cm, wzmocnienie o wymiarze 75cm x 100cm



Pleszewskie Centrum Medyczne
w Pleszewie
Sp. z o.o.



Szpital
Akredytowany

- 1 x serweta samoprzylepna o wymiarach 170cm x 300cm wzmocnienie o wymiarze 30cm x 80cm
- 1 x serweta samoprzylepna o wymiarach 160 cm x 180 cm wykonana z chłonnego i nieprzemakalnego laminatu dwuwarstwowego o gramaturze 56 g/m²
- 1 x elastyczna osłona na kończynę o wymiarach 35 cm x 120 cm
- 4 x ręcznik chłonny o wymiarach 30 cm x 30 cm
- 2 x taśma samoprzylepna o wymiarach 10 cm x 50 cm
- 1 x wzmocniona osłona (serweta) na stolik Mayo o wymiarach 80 cm x 140 cm
- 1 x serweta wzmocniona na stół instrumentalny (owinięcie zestawu) o wymiarach 150 cm x 190 cm.
- 1 x sterylna kieszka na ssak i koagulację dołączona osobno do zestawu

Odporność na penetrację płynów w obszarze krytycznym 110 cm H₂O. Serwety wykonane z hydrofobowej włókniny trójwarstwowej typu SMS o gramaturze 50 g/m², w strefie krytycznej wyposażone we wzmocnienie wysokochłonne o gramaturze 80 g/m², zintegrowane z organizatorami przewodów. Opakowanie TYVEC.

Odpowiedź: Tak, -Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie 79 - Zadanie 47, pozycja 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie sterylnego zestawu do artroskopii stawu barkowego o składzie:

- 1 x serweta samoprzylepna o wymiarach 200cmx260cm, z wycięciem "U" o wymiarach 8,5 cm x 85 cm
- 1 x serweta samoprzylepna o wymiarach 170cm x 180cm wzmocnienie o wymiarze 50cm x 80cm
- 1 x serweta samoprzylepna o wymiarach 150 cm x 180 cm wykonana z chłonnego i nieprzemakalnego laminatu dwuwarstwowego o gramaturze 56 g/m²
- 1 x elastyczna osłona na kończynę o wymiarach 30 cm x 60 cm
- 4 x ręcznik chłonny o wymiarach 30 cm x 30 cm
- 2 x taśma samoprzylepna o wymiarach 10 cm x 50 cm
- 1 x wzmocniona osłona (serweta) na stolik Mayo o wymiarach 80 cm x 140 cm
- 1 x serweta wzmocniona na stół instrumentalny (owinięcie zestawu) o wymiarach 150 cm x 190 cm.

Odporność na penetrację płynów w obszarze krytycznym 110 cm H₂O. Serwety wykonane z hydrofobowej włókniny trójwarstwowej typu SMS o gramaturze 50 g/m², w strefie krytycznej wyposażone we wzmocnienie wysokochłonne o gramaturze 80 g/m², zintegrowane z organizatorami przewodów. Opakowanie TYVEC.

Odpowiedź: Nie, -Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 80 - Zadanie 48, pozycja 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie sterylnego zestawu do operacji kończyn o składzie:

- 1 x serweta z samouszczelniającym się otworem o średnicy 7 cm o wymiarach 230 cm x 300 cm, wzmocnienie o wymiarach 100 cm x 50 cm, z łata chłonna i uchwytem na przewody,
- 4 x ręcznik chłonny o wymiarach 30 cm x 30 cm
- 3 x taśma samoprzylepna o wymiarach 10 cm x 50 cm
- 1 x elastyczna osłona na kończynę o wymiarach 22 cm x 75 cm



- 1 x wzmocniona osłona (serweta) na stolik Mayo o wymiarach 80 cm x 145 cm
- 1 x serweta wzmocniona o wymiarach 150 cm x 190 cm
- 1 x serweta wzmocniona na stół instrumentalny (owinięcie zestawu) o wymiarach 150 cm x 190 cm.

Serweta główna wykonana z chłonnego i nieprzemakalnego laminatu dwuwarstwowego o gramaturze 60 g/m² w strefie krytycznej wyposażona we wzmocnienie wysokochłonne 80 g/m², zintegrowana z dwoma podwójnymi organizatorami przewodów. Łączna gramatura w strefie krytycznej 140 g/m². Odporność na rozerwania sucho/mokro w obszarze krytycznym 180/172 kPa. Wytrzymałość na rozciąganie na sucho/mokro w obszarze krytycznym 118/93 N. Odporność na penetrację płynów w obszarze krytycznym 197 cm H₂O. Współczynnik pylenia 3.4log₁₀. Chłonność wzmocnienia min. 680%.

Odpowiedź: Nie, -Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 81 - Zadanie 49, pozycja 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie sterylnej serwety do artroskopii:

- 1 x serweta samoprzylepna o wymiarach 150cm x 250cm, wzmocniona z wycięciem "U" o wymiarach 7cm x 70 cm
- 1 x serweta wzmocniona na stół instrumentalny stanowiąca owinięcie zestawu o wymiarach 150 cm x 190 cm
- 1 x sterylna osłona na kończynę o wymiarach 30cm x 80cm w zestawie z taśmą samoprzylepną 10cm x 50cm dołączona osobno do zestawu

Serweta wykonana z chłonnego i nieprzemakalnego laminatu dwuwarstwowego o gramaturze 60 g/m², w strefie krytycznej wyposażona we wzmocnienie wysokochłonne o gramaturze 80 g/m².

Spełnia wymagania wg normy EN 13795-1 na wysokim poziomie. Wytrzymałość na wypychanie na sucho/mokro w obszarze krytycznym 180/172 kPa. Wytrzymałość na rozciąganie na sucho/mokro w obszarze krytycznym 118/93 N. Odporność na penetrację płynów w obszarze krytycznym 197 cm H₂O. Współczynnik pylenia 3.4log₁₀. Chłonność wzmocnienia min. 680%.

Odpowiedź: Nie, -Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 82 - Zadanie 50, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści zestaw z podkładem chłonnym 60 x 90 cm (zamiast serwety wysokochłonnej)?

Odpowiedź: Tak, - Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie 83 - Zadanie 50, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści zestaw z miską o śr. min. 24,5 cm?

Odpowiedź: Nie, - Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 84 - Zadanie nr 51, pozycja 5

Czy Zamawiający dopuści koszulę wykonaną z włókniny SMS z rozcięciem z przodu wiązana na troki przy szyi i w pasie?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza koszulę wykonaną z włókniny SMS, pozostałe parametry zgodnie z SWZ.



Pleszewskie Centrum Medyczne
w Pleszewie
Sp. z o.o.



Szpital
Akredytowany

Pytanie 85 - Zadanie 51, pozycja 6

Czy Zamawiający dopuści ochraniacze na obuwiu wykonane z mocnej i wytrzymałej folii polietylenowej o grubości 18 μm , ściągane podwójną gumką obszytą ultradźwiękowo, wymiary 41 cm x 15cm, w kolorze niebieskim?

Odpowiedź: Nie, - Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 86 Zadanie 51, pozycja 6

Czy Zamawiający dopuści ochraniacze na obuwiu wykonane z mocnej i wytrzymałej włókniny polipropylenowej 30 g/m², ściągane podwójną gumką obszytą ultradźwiękowo, wymiary 38cm x 17cm?

Odpowiedź: Nie, - Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 87 - Zadanie 51, pozycja 7

Czy Zamawiający dopuści fartuch dostępny w rozmiarze L (dł. 120 cm, szer. 70cm) i XL (dł. 125cm, szer. 75cm)?

Odpowiedź: Nie, - Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 88 - Zadanie 52, pozycja 1, 2

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie fartuchów z 4 etykietami samoprzylepnymi dla potrzeb dokumentacji?

Odpowiedź: Tak, pozostałe parametry zgodnie z SWZ.

Pytanie 89 - Zadanie 52, pozycja 1, 2

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie fartuchów spełniających wymagania aktualnej normy PN-EN 13795-1:2019?

Odpowiedź: Tak, jeśli spełniają wymagania SWZ.

Pytanie 90 - Zadanie 52, pozycja 2

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie fartuchów wykonanych z włókniny SMS?

Odpowiedź: Nie, - Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 91 - Zadanie 52, pozycja 2

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie fartuchów z nieprzemakalnymi wzmocnieniami w części przedniej i na rękawach z laminatu o gramaturze 40g/m²?

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

Pytanie 92 - Zadanie 55, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści podkład celulozowo-foliowy z celulozy 23g/m² i folii polietylenowej 17gr/m²?

Odpowiedź: Tak.



Pleszewskie Centrum Medyczne
w Pleszewie
Sp. z o.o.



Szpital
Akredytowany

Pytanie 93 - Zadanie 55, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści podkład z podfoliowanej włókniny polipropylenowej o gramaturze 25g/m²?

Odpowiedź: Tak, pozostałe parametry bez zmian.

Pytanie 94 - Zadanie 58, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści podkład w rolce wykonany z dwóch warstw celulozy (2x18g/m²) i warstwy folii (0,015-0,017 mm) o szerokości 33cm i długości listka 50cm, długość rolki 20m (40 sztuk listków o wymiarach 33x50cm)?

Odpowiedź: Nie, - Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 95 – Zadanie 59, pozycja 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie sterylnego pokrowca na przewody z końcówką perforowaną umożliwiającą wysunięcie przewodu, a z drugiej wyposażony w kartonik z oznakowaniem kierunku rozwijania osłony? Pozostałe zapisy zgodnie z SWZ.

Odpowiedź: Tak,- Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie 96 - Zadanie 64, pozycja 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawu z serwetą min. 50 x 50 cm z otworem przylepnym 6 x 8 cm (pozycja b zestawu)?

Odpowiedź: Tak,- Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie 97 - Zadanie 64, pozycja 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawu z igłami iniekcyjnymi 1,2mmx40mm oraz 0,8mm x 40mm?

Odpowiedź: Tak,- Zamawiający wyraża zgodę, pozostałe parametry bez zmian.

Pytanie 98 - Zadanie 72, pozycja 1-2

Czy Zamawiający dopuści nieprzylepny opatrunek z pianki poliuretanowej o strukturze trójwymiarowej umożliwiającej pionowe pochłanianie i zatrzymywanie wysięku oraz dokładne dopasowanie do dna rany (technologia 3D Fit), z zewnętrzną częścią opatrunku wykonaną z półprzepuszczalnego poliuretanu; brzegi opatrunku ściśnione w celu zminimalizowania odcisnięć na skórze; wskazany w zakresie leczenia ran z wysiękiem średnim i obfitym?

Odpowiedź: Nie,- Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 99 - Zadanie 72, pozycja 1-2

Czy Zamawiający dopuści przylepny opatrunek z pianki poliuretanowej o strukturze trójwymiarowej umożliwiającej pionowe pochłanianie i zatrzymywanie wysięku oraz dokładne dopasowanie do dna rany (technologia 3D Fit), z zewnętrzną częścią opatrunku wykonaną z półprzepuszczalnego poliuretanu; część przylepna z warstwą hydrokoloidową zapewnia lepsze przyleganie opatrunku do rany i zabezpieczenie



Pleszewskie Centrum Medyczne
w Pleszewie
Sp. z o.o.



Szpital
Akredytowany

okalającej ranę skóry; bez zawartości kleju; brzegi opatrunku ścienione w celu zminimalizowania odcisnięć na skórze; wskazany w zakresie leczenia ran z wysiękiem średnim i obfitym?

Odpowiedź: Nie,- Zamawiający nie dopuszcza.


Pytanie 100- Zadanie 72, pozycja 2

Czy Zamawiający dopuści opatrunek w rozmiarze 18cm x 18cm?

Odpowiedź: Nie,- Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 101 – Zadanie 73, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści przylepny opatrunek z pianki poliuretanowej o strukturze trójwymiarowej umożliwiającej pionowe pochłanianie i zatrzymywanie wysięku oraz dokładne dopasowanie do dna rany (technologia 3D Fit); zewnętrzna część opatrunku wykonana z półprzepuszczalnego poliuretanu; część przylepna z warstwą hydrokolidową zapewnia lepsze przyleganie opatrunku do rany i zabezpieczenie okalającej ranę skóry; bez zawartości kleju; brzegi opatrunku ścienione w celu zminimalizowania odcisnięć na skórze; wskazany w zakresie leczenia ran z wysiękiem średnim i obfitym w okolicy pięty, w rozmiarze 19cm x 20cm? Zdjęcie poglądowe poniżej.

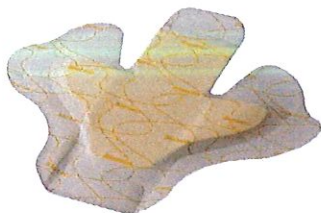

Odpowiedź: Nie,- Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 102 - Zadanie 75, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści zestaw zawierający:

- 1 x serweta o wymiarach 160/240 cm x 180 cm zintegrowana z osłonami na kończyny, z otworem samoprzylepnym w okolicy krocza o wymiarach 10 cm x 15 cm zintegrowana z torbą na płyny o wymiarach 35 x 50cm. W serwecie dodatkowa taśma samoprzylepna w rozmiarze 6cm x 38cm.
- 1 x serweta wzmocniona na stół instrumentalny stanowiąca owinięcie zestawu o wymiarach 150 cm x 190 cm
- 1 x wzmocniona osłona (serweta) na stolik Mayo o wymiarach 80 cm x 140 cm dołączona osobno do zestawu?

Odpowiedź: Nie,- Zamawiający nie dopuszcza.



Pytanie 103 - Zadanie 76, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści zestaw zawierający:

- 1 x serweta samoprzylepna o wymiarach 180cm x 305cm z dwoma eliptycznym otworami 12 x 15cm wypełnionymi folią operacyjną, wzmocnienie o wymiarach 50 cm x 80 cm
- 2 x ręcznik chłonny o wymiarach 30 cm x 30 cm
- 1 x osłona na aparaturę medyczna o średnicy 80 cm
- 1 x fartuch chirurgiczny standard wykonany z wielowarstwowej włókniny hydrofobowej SSMMS o gramaturze 45 g/m², wyposażony w system troków, kartonik do aseptycznej aplikacji, tylne części fartucha zachodzące na siebie. Rozmiar XL.
- 1 x serweta wzmocniona na stół instrumentalny stanowiąca owinięcie zestawu o wymiarach 150 cm x 190 cm.
- 1x jałowa serweta o rozmiarze min. 70x70cm dołączona osobno do zestawu

Serwety wykonane z chłonnego i nieprzemakalnego laminatu dwuwarstwowego o gramaturze 56 g/m² w strefie krytycznej wyposażona we wzmocnienie wysokochłonne o gramaturze 80 g/m², zintegrowana z dwoma podwójnymi organizatorami przewodów. Łączna gramatura w strefie wzmocnionej 140 g/m².

Opakowanie folia-papier wyposażone w informację o kierunku otwierania oraz 4 etykiety samoprzylepne typu TAG służące do archiwizacji danych.

Odpowiedź: Nie, - Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 104 - Zadanie Nr 3

Poz. nr 1-3- czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania opaski gipsowej o zawartości gipsu 90% +/- 2% i czasie wiązania do 4 minut? Pozostałe parametry bez zmian?

Odpowiedź: Tak, - Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 105 - Zadanie Nr 13

Poz. nr 1- czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania opatrunku do mocowania kaniul w rozmiarze 7 x 9 cm?

Odpowiedź: Tak, - Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 106 - Zadanie Nr 19

Poz. nr 3- czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania opatrunku z siatki bawełnianej w rozmiarze 20 x 20 cm lub opatrunku z siatki tiulowej w rozmiarze 20 x 30 cm? Pozostałe parametry bez zmian

Odpowiedź: Tak, - Zamawiający dopuszcza – rozmiar 20x30cm.

Pytanie 107 - Zadanie Nr 26

Poz. nr 3- prosimy Zamawiającego o sprecyzowanie jakiej pojemności zbiorników oczekuje- 300 ml czy 800 ml?

Odpowiedź: 300 ml.



Pleszewskie Centrum Medyczne
w Pleszewie
Sp. z o.o.



Szpital
Akredytowany

Pytanie 108 - Zadanie Nr 27

czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania tupferów w rozmiarze 13 x 13 cm lub 20 x 20 cm, pakowanych w opakowanie jednostkowe a' 10 szt. z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości?

Odpowiedź: Nie,- Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 109 - Zadanie Nr 28

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania zestawu serwet do cięć cesarskich o następującym składzie:

- 1 serweta na stół narzędziowy wzmocniona 150 x 190 cm
- 1 serweta na stół Mayo wzmocniona 80 x 145 cm
- 1 serweta do cięcia cesarskiego z torbą na płyny (okno 19 x 24 cm) 315 x 250/200 cm
- 1 serweta dla noworodka 90 x 105 cm
- 1 taśma samoprzylepna 10 x 50 cm
- 4 ręczniki celulozowe 30 x 33 cm

Odpowiedź: Tak, - Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 110 - Zadanie Nr 32

Poz. nr 1-3- Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania kompresów gazowych niejadalnych sklasyfikowanych przez producenta w minimum klasie I, regule 4?

Odpowiedź: Tak, - Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 111 - Zadanie Nr 35

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania zestawu uniwersalnego wykonanego z laminatu 2-warstwowego

o min. gramaturze 55 g/m² z dodatkowymi padami chłonnymi o następującym składzie:

- 1 serweta na stół narzędziowy wzmocniona 150 x 190 cm (wzmocnienie min. 75 x 190 cm)
- 1 serweta na stół Mayo wzmocniona 80 x 145 cm
- 1 samoprzylepna serweta operacyjna z padem chłonnym 150 x 240 cm (pad min.50 x 75 cm)
- 1 samoprzylepna serweta operacyjna z padem chłonnym 200 x 175 cm (pad min.50 x 75 cm)
- 2 samoprzylepne serwety operacyjne z padem chłonnym 75 x 90 cm (pad min.36 x 90 cm)
- 1 taśma samoprzylepna 10 x 50 cm
- 4 ręczniki celulozowe 30 x 33 cm

Odpowiedź: Tak, - Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 112 - Zadanie Nr 36

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania serwet operacyjnych gazowych w rozmiarze 45 x 45 cm? Zwracamy się z prośbą o wyjaśnienie czy nie doszło do omyłki pisarskiej dotyczącej opisu wielkości oferowanych opakowań handlowych? Pytanie nasze wynika z faktu, iż Zadanie 36 zawiera jedną pozycję,



Pleszewskie Centrum Medyczne
w Pleszewie
Sp. z o.o.



Szpital
Akredytowany

natomiast opis pod formularzem cenowym wskazuje trzy pozycje.

Odpowiedź: Tak, - Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 113 - Zadanie Nr 45

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania zestawu do operacji brzuszno- kroczywych wykonanego z laminatu 2- warstwowego o min. gramaturze 55 g/m² i następującym składzie:

1 serweta na stolik narzędziowy wzmocniona* 150 x 190 cm

1 serweta na stolik Mayo wzmocniona** 80 x 145 cm

(wzmocnienie 60 x 145 cm)

1 taśma przylepna 10 x 50 cm

1 serweta przylepna 90 x 75 cm

1 serweta brzuszno-kroczykowa z padami chłonnymi

(otwory 19 x 29 cm i 9 x 12 cm)

230 x 250/280 cm

4 ręczniki celulozowe 30 x 33 cm

* Laminat 2- warstwowy o łącznej gramaturze min. 90 g/m²; warstwa chłonna min. 28 g/m², folia PE min. 25 g/m²

** Laminat 2- warstwowy PP-PE, folia gramatura min. 50 g/m²; łączna gramatura min. 90g/m²

Odpowiedź: Tak, - Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 114 - Zadanie Nr 46

12. czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania zestawu do operacji stawu biodrowego wykonanego z laminatu 2- warstwowego z dodatkowymi padami chłonnymi, o następującym składzie:

1 x serweta na stół narzędziowy wzmocniona 150 x 190 cm

1 x serweta na stolik Mayo 80 x 145 cm

4 x ręczniki celulozowe 33 x 30 cm

2 x taśma przylepna 10 x 50 cm

1 x serweta extra wzmocniona ,U przylepne 10 x 95 cm

(wzmocnienie z wiskozy)

245 x 280 cm

1 x serweta wzmocniona przylepna z warstwą przylepną 100 cm 300 x 170 cm

1 x serweta nieprzylepna 90 x 75 cm

1 x serweta na stół narzędziowy wzmocniona złożona 190 x 150 cm

1 x osłona na kończynę 35 x 120 cm

Odpowiedź: Tak, - Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 115 - Zadanie Nr 47

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania zestawu do artroskopii stawu barkowego wykonanego z laminatu

2- warstwowego z dodatkowymi padami chłonnymi, o następującym składzie:



Pleszewskie Centrum Medyczne
w Pleszewie
Sp. z o.o.



Szpital
Akredytowany

- 1 serweta na stół narzędziowy wzmocniona 150 x 190 cm
- 1 serweta na stół Mayo wzmocniona 80 x 145 cm
- 1 samoprzylepna serweta operacyjna typu „U” z padem chłonnym z wiskozy 260 x 200 cm („U” 10 x 60 cm)
- 1 serweta nieprzylepna 150 x 175 cm
- 1 samoprzylepna serweta operacyjna z padem chłonnym 150 x 240 cm
- 1 osłona na kończynę 25 x 80 cm
- 2 taśmy samoprzylepne 10 x 50 cm
- 1 osłona na kable video 13 x 250 cm
- 4 ręczniki celulozowe 30 x 33 cm

Odpowiedź: Tak, - Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 116 - Zadanie NR 48

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania zestawu do operacji kończyn wykonanego z laminatu 2-warstwowego z dodatkowymi padami chłonnymi, o odporności na przenikanie płynów min. 150 cm H₂O i następującym składzie:

- 1 x serweta na stół narzędziowy wzmocniona 150 x 190 cm
- 1 x serweta na stół Mayo 80 x 145 cm
- 4 x ręczniki celulozowe 33 x 30 cm
- 2 x taśma samoprzylepna 10 x 50 cm
- 1 x serweta na stół narzędziowy wzmocniona 190 x 150 cm
- 1 x osłona na kończynę 35 x 80 cm
- 1 x serweta do operacji kończyn dolnych wzmocniona (wzmocnienie z wiskozy), okno 5 x 7 cm z uchwytem typu rzep 245 x 320 cm

Odpowiedź: Tak, - Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 117 - Zadanie Nr 49

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania zestawu do artroskopii, wykonanego z laminatu 2-warstwowego

o następującym składzie:

- 1 serweta na stół narzędziowy wzmocniona 150 x 190 cm
- 1 serweta na stół Mayo wzmocniona 80 x 145 cm
- 1 serweta nieprzylepna 150 x 190 cm
- 1 serweta do artroskopii z workiem do zbiórki płynów, 320 x 245 cm, otwory 5 x 7 cm
- 1 osłona na kończynę 35 x 80 cm
- 2 taśmy samoprzylepne 10 x 50 cm
- 4 ręczniki celulozowe 30 x 33 cm
- LUB
- 1 serweta na stół narzędziowy wzmocniona 190 x 150 cm
- 1 serweta na stół Mayo wzmocniona 80 x 145 cm



Pleszewskie Centrum Medyczne
w Pleszewie
Sp. z o.o.



Szpital
Akredytowany

1 serwetka do operacji kończyny z samouszczelniającym otworem (\varnothing 7 cm) 300 x 200 cm

1 osłona na kończynę 35 x 55 cm

3 taśmy samoprzylepne 10 x 50 cm

1 osłona na kamerę 13 x 250 cm

Odpowiedź: Nie,- Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 118 - Zadanie Nr 62

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania osłony na stół Mayo wykonanej z mocnej folii o grubości min.

57 g/m² z dodatkową zewnętrzną warstwą chłonną o łącznej gramaturze nie mniejszej niż 90 g/m²?

Odpowiedź: Tak, - Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 119

Czy Zamawiający potwierdza, że zgodnie z rozporządzeniem unijnym (UE) 2017/745, art. 14, pkt 3 (rozporządzenie MDR) dystrybutorzy muszą zapewnić, że w czasie, gdy są odpowiedzialni za wy-rób, warunki przechowywania lub transportu mają być zgodne z warunkami określonymi przez producenta ?

Odpowiedź: Tak.

Pytanie 120

Czy na okoliczność spełnienia warunków transportu określonych w rozporządzeniu unijnym (UE) 2017/745, art. 14, pkt 3 (rozporządzenie MDR) Zamawiający wymaga przedstawienia wykazu od-powiednich środków transportu tj. samochodów z zabudową typu izoterma z możliwością rejestra-cji i wydruku temperatury?

Odpowiedź: Nie.

Pytanie 121

Czy na okoliczność spełnienia warunków transportu określonych w rozporządzeniu unijnym (UE) 2017/745, art. 14, pkt 3 (rozporządzenie MDR) Zamawiający wyklucza możliwość wykonywania do-staw za pomocą standardowej usługi kurierskiej bez możliwości rejestracji i wydruku temperatury?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyklucza możliwości dostaw usług kurierskich pod warunkiem spełnienia warunków transportu określonych w rozporządzeniu unijnym (UE) 2017/745.

Pytanie 122

Czy Zamawiający dopuści i będzie wymagał w przedmiocie zamówienia (zadanie nr 57, pozycja 1) złożenia oferty na podkłady higieniczne 60x60cm z wkładem chłonnym z pulpy celulozowej, o chłonności co najmniej 800 ml? Brak określenia poziomu chłonności w opisie przedmiotu zamówienia dopuszcza do zaoferowania produkty o niskiej jakości użytkowej, które nie spełniają funk-cji zabezpieczającej przy zabiegach pielęgnacyjnych przy pacjencie. Naraża to Zamawiającego na zwiększone koszty opieki nad pacjentem z inkontynencją i zwiększa potrzebę dodatkowej pracy personelu opiekującego się pacjentami.

Odpowiedź: Tak, wymóg.



Pleszewskie Centrum Medyczne
w Pleszewie
Sp. z o.o.



Szpital
Akredytowany

Pytanie 123

Czy Zamawiający dopuści i będzie wymagał w przedmiocie zamówienia (zadanie nr 57, pozycja 2) złożenia oferty na podkłady higieniczne 60x90cm z wkładem chłonnym z pulpy celulozowej, o chłonności co najmniej 1100 ml? Brak określenia poziomu chłonności w opisie przedmiotu zamówienia dopuszcza do zaferowania produkty o niskiej jakości użytkowej, które nie spełniają funkcji zabezpieczającej przy zabiegach pielęgnacyjnych przy pacjencie. Naraża to Zamawiającego na zwiększone koszty opieki nad pacjentem z inkontynencją i zwiększa potrzebę dodatkowej pracy personelu opiekującego się pacjentami.

Odpowiedź: Tak, dopuszcza ale nie stawia ww. wymogu.

Pytanie 124

Czy Zamawiający wymaga w przedmiocie zamówienia (zadanie nr 71, pozycje 1 - 6) złożenia oferty na pieluchomajtki dla dorosłych pokryte laminatem paroprzepuszczalnym na całej powierzchni - w części centralnej i bocznej? Zastosowanie laminatu paroprzepuszczalnego jedynie w części centralnej z włókniną po bokach (która nie jest pokryta tym laminatem) stanowi ryzyko przeciekania boków pieluchomajtki, szczególnie przy obfitych i bocznych mikcjach?

Odpowiedź: Tak.

Pytanie 125 - Zadanie nr 3 poz. 1-3:

Czy Zamawiający wymaga opaski na perforowanym tubusie? Brak perforacji uniemożliwia prawidłowe namoczenie gipsu od środka.

Odpowiedź: Nie, - Zamawiający nie wymaga.

Pytanie 126 - Zadanie nr 3 poz. 1-3

Czy Zamawiający wymaga opaski na tubusie z tworzywa sztucznego? Tubus z tektury pod wpływem wody ulega deformacji i przez namoczenie pogarsza namoczenie gipsu od wewnątrz.

Odpowiedź: Nie, - Zamawiający nie wymaga.

Pytanie 127 - Zadanie 5 poz. 1

Czy Zamawiający wymagając opakowania chroniącego przed wilgocią wymaga opakowania foliowego? Opakowanie tekturowe nie zapewnia 100% ochrony przed wilgocią.

Odpowiedź: Nie, - Zamawiający nie wymaga.

Pytanie 128 - Zadanie 5 poz. 1:

Czy Zamawiający wymaga ligniny krepowanej?

Odpowiedź: Nie, - Zamawiający nie wymaga.

Pytanie 129 - Zadanie 5 poz. 1

Czy Zamawiający wymaga ligniny będącej wyrobem medycznym?

Odpowiedź: Nie, - Zamawiający nie wymaga.



Pleszewskie Centrum Medyczne
w Pleszewie
Sp. z o.o.



Szpital
Akredytowany

Pytanie 130 - Zadanie 7 poz. 4

Czy Zamawiający dopuści plaster z opatrunkiem na tkaninie o składzie 65% bawełna, 35% poliamid? Reszta parametrów zgodna z SIWZ.

Odpowiedź: Tak, - Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 131 - Zadanie 28:

Czy Zamawiający dopuści zestaw o składzie:

- kompresy włókninowe 20x40cm – 2 szt.
- podkład 90x60 cm – 1 szt.
- pokrowiec na stolik Mayo 145x80 cm – 1 szt.
- serweta na stolik instrumentariuszki 190x150 cm – 1 szt.
- serweta główna 320x180 cm z otworem 35x32 cm z folią chirurgiczną i workiem na płyny, okno w folii ok.20x15 cm – 1 szt.
- serweta dla noworodka 80x60 cm – 2 szt.?

Odpowiedź: Nie, - Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 132 - Zadanie 35:

Czy Zamawiający dopuści zestaw o składzie:

- 1 x serweta samoprzylepna o wymiarach 170cm x 200cm, wzmocnienie o wymiarach 37,5cm x 70cm.
- 1 x serweta samoprzylepna o wymiarach 150cm x 240cm, wzmocnienie o wymiarach 37,5cm x 70cm
- 2 x serweta samoprzylepna o wymiarach 75cm x 90cm, wzmocnienie o wymiarach 37,5cm x 70cm
- 2 x ręcznik chłonny o wymiarach 20 cm x 40cm
- 1 x taśma samoprzylepna o wymiarach 9cm x 50 cm
- 1 x osłona (serweta) na stolik Mayo o wymiarach 80cm x 145cm
- 1 x serweta na stół instrumentalny stanowiąca owinięcie zestawu o wymiarach 150cm x 190 cm

Całość zapakowana w blister, zaopatrzony w etykietę samoprzylepną, z możliwością wklejenia jej do dokumentacji, umożliwiającą identyfikację wyrobu.

Odporność na przenikanie płynów w obszarze krytycznym min. 150 cm H₂O

Przedmiot zamówienia wykonany zgodnie z normą PN-EN 13795 1-3?

Odpowiedź: Tak, - Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 133 - Zadanie 36 poz. 1:

Czy Zamawiający dopuści serwety 4-warstwowe, rozmiar 45x45 cm, reszta parametrów zgodna z SWZ?

Odpowiedź: Nie, - Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 134 - Zadanie 36 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści serwety 17-nitkowe, rozmiar 45x45 cm, reszta parametrów zgodna z SWZ?

Odpowiedź: Nie, - Zamawiający nie dopuszcza.



Pytanie 135 - Zadanie 36

Czy nie doszło do omyłki pisarskiej, ponieważ pod cennikiem znajdują się uwagi do pozycji 1, 2 i 3, a w tabeli znajduje się tylko pozycja 1?

Odpowiedź: Tak, przepraszamy za omyłkę.

Pytanie 136 - Zadanie 41

Czy Zamawiający dopuści serwetę z okrągłym otworem o średnicy 7 cm?

Odpowiedź: Tak, - Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 137 - Zadanie 42

Czy Zamawiający dopuści serwetę o wym. 50x50 cm?

Odpowiedź: Tak, - Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 138 - Zadanie 46:

Czy Zamawiający dopuści zestaw o składzie:

- serweta z przylepcem 1 szt 260x240 WYCIĘC. U 100x20
- serweta z przylepcem 1 szt 240x150
- pokrowiec na nogę 1 szt 120x37
- kieszeń na płyny z kształtką 1 szt 40x30
- taśma medyczna 6 szt 50x9
- serweta na stół instrum. 1 szt 190x150
- serweta na stolik Mayo 1 szt 145x80
- serwetki do rąk 2 szt włók. kom. 40x20
- Odporność na penetrację płynów 250 mm H₂O?

Odpowiedź: Tak, - Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 139 - Zadanie 47

Czy Zamawiający dopuści zestaw o składzie:

- kompres włókninowy 40g 4w 10x20cm 2 szt.
- pokrowiec na stolik mayo 145x80cm niebieski 1 szt.
- serweta na stół instrum 190x150cm 1 szt.
- pokrowiec na kończynę 75x37cm 1 szt.
- serweta 240x200cm wycięcie u (60x7) przył 1 szt.
- serweta 240x150cm przył 60 1 szt.
- serweta 180x150cm 1 szt.
- taśma medyczna 9x50cm przył 2 szt.
- odporność na penetrację płynów 250 mm h₂O?

Odpowiedź: Tak, - Zamawiający dopuszcza.



Pytanie 140 - Zadanie 49

Czy Zamawiający dopuści zestaw o składzie:

- pokrowiec na kończynę l2 75x37cm 1 szt.
- serweta 180x150cm wyc u (10x20) przył 1 szt.
- serweta 180x150cm wyc u (10x20) 2 przył 1 szt.
- taśma medyczna bp 9x50cm przył 2 szt.
- odporność na penetrację płynów 250 mm h₂o?

Odpowiedź: Nie. W ww. zestawie brak serwety na stolik zabiegowy.

Pytanie 141 - Zadanie 52 poz. 2

Czy Zamawiający dopuści fartuchy wykonane z włókniny SMS? Udzielając odpowiedzi na powyższe, pragniemy zauważyć, iż włóknina SMS jest włókniną posiadającą strukturę Spunbond/Meltblow/Spunbond. Obecnie na rynku oferowane są również wersje tego typu włókniny, m.in. SMMS, SMMMS lub SSMMS. Wymienione włókniny są wersjami typu SMS różniącymi się jedynie procesem technologicznym powstającej włókniny przy zachowaniu tożsamyh parametrów użytkowych, które muszą spełniać wymagania normy PN EN 13795. Surowce użyte w procesie technologicznym są takie same we wszystkich przypadkach, a proces technologiczny różni się wyłącznie zastosowaniem dodatkowych dyszy przy produkcji włóknin, które zwiększają wydajność pracy maszyny. Różne procesy technologiczne nie mają wpływu na właściwości powstałych włóknin. Zatem fartuchy wykonane z włókniny SMS w żadnym stopniu nie odbiegają w swych właściwościach od tych wykonanych z włókniny SMMMS. W związku z powyższym, zwracamy się z prośbą o dopuszczenie fartuchów, które są wykonane z włókniny SMS.

Odpowiedź: Nie, - Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 142 - Zadanie 52 poz. 1-2

Czy Zamawiający dopuści fartuchy o długości:

- rozmiar M 115 cm,
- rozmiar L 125 cm,
- rozmiar XL 140 cm?

Odpowiedź: Tak, - Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 143 - Zadanie 52 poz. 2

Czy Zamawiający dopuści wzmocnienia o gramaturze 40 g/m²?

Odpowiedź: Tak, - Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 144 - Zadanie 62

Czy Zamawiający dopuści osłonę z folii o grubości 50 μm, z warstwą chłonną z włókniny o masie powierzchniowej 30 g/m², co daje warstwą chłonną o łącznej masie powierzchniowej 82 g/m²?

Odpowiedź: Tak, - Zamawiający dopuszcza.



Pleszewskie Centrum Medyczne
w Pleszewie
Sp. z o.o.



Szpital
Akredytowany

Pytanie 145 - Zadanie 63

Czy Zamawiający dopuści ręczniki o wymiarze 30x40 cm?

Odpowiedź: Nie, - Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 146 - Zadanie 63:

Czy Zamawiający dopuści ręczniki o wymiarze 50x40 cm?

Odpowiedź: Tak, - Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 147 - Zadanie 64:

Czy Zamawiający dopuści zestaw o składzie:

- 1 x serweta 60x50 cm z otworem przylepnym 8cm
- 5 x kompres włókninowy 7,5x7,5 cm 4-warstwowy
- 3 x tupfer kula 20x20 cm 17N
- 1 x kleszczyki metalowe do igły 13 cm
- 1 x nożyczki metalowe 11 cm proste ostro-ostre
- 1 x pęseta metalowa chirurgiczna 12,5 cm
- 1 x pęseta plastikowa anatomiczna 13 cm
- serweta 75x45 cm (owinięcie zestawu)?

Odpowiedź: Nie, - Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 148 - Zadanie 64:

Czy Zamawiający dopuści zestaw o składzie:

- 1 x serweta 60x50 cm z przylepnym otworem 10 cm i 2 przylepcami na rogach serwety
- 1 x serweta 75x45 cm
- 10 x kompres włókninowy 7,5x7,5 cm 4-warstwowy
- 1 x opatrunek wyspowy 5x7,2 cm
- 1 x igła iniekcyjna 1,2x40mm
- 1 x igła iniekcyjna 0,5x25mm
- 1 x pęseta plastikowa anatomiczna 13 cm
- 1 x strzykawka 3ml
- 1 x strzykawka 5ml?

Odpowiedź: Nie, - Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 149 - Zadanie 66

Czy Zamawiający wymaga setonów jałowych?

Odpowiedź: Tak.



Pytanie 150 - Zadanie 70

Czy ze względu na fakt, iż pieluchomajtki dla dzieci nie są wyrobem medycznym, Zamawiający wymaga, aby oferowane pieluchomajtki posiadały świadectwo jakości PZH, które potwierdza i dokumentuje, iż wyrób nie stanowi zagrożenia dla zdrowia człowieka oraz jest przeznaczony dla dzieci? Czy Zamawiający wymaga załączenia tego dokumentu do oferty?

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

Pytanie 151 - Zadanie 70:

Czy dla potwierdzenia bezpieczeństwa i jakości wyrobu, Zamawiający wymaga, aby pieluchomajtki posiadały udokumentowaną pozytywną opinię użytkowników w postaci Opinii Instytutu Matki i Dziecka? Czy Zamawiający wymaga załączenia tego dokumentu do oferty?

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

Pytanie 152 - Zadanie 71

Czy Zamawiający dopuści pieluchomajtki o chłonności min.:

Pieluchomajtki dzienne

Odpowiedź:

poz. 1; 2200 g- Nie

poz. 2; 2500 g - Tak

poz. 3; 2500 g – Nie

Pieluchomajtki nocne

poz. 4; 2800 g - Tak

poz. 5; 3100 g - Tak

poz. 6; 3100 g? - Tak

Pytanie 153 - Zadanie 71

Czy Zamawiający dopuści pieluchomajtki dla dorosłych z dwoma ściągaczami taliowymi, oddychające na całej powierzchni produktu, które posiadają: dwa anatomicznie ukształtowane wkłady chłonne które wchłaniają i rozprowadzają mocz, absorbent moczu z zawartością substancji neutralizującej zapach (superabsorbent); falbanki oraz barierki wewnętrzne (skierowane do wewnątrz lub na zewnątrz), zapewniające zapobieganie wypływu moczu i kału; wykonane z oddychającego materiału – elastycznego laminatu i włókniny na całym obwodzie zapewniając tym samym dobre dopasowanie do pacjenta na całym obwodzie; podwójne elastyczne przylepcorzepy wielokrotnego użytku, dwa wskaźniki chłonności (zużycia produktu) w postaci dwóch żółtych pasków zmieniających barwę pod wpływem moczu i tuszowego nadruku rozmywającego się pod wpływem cieczy?

Odpowiedź: Nie.



Pytanie 154 - Zadanie 71

Zamawiający dopuści pieluchomajtki dla dorosłych, oddychające na całej powierzchni produktu, które posiadają: dwa anatomicznie ukształtowane wkłady chłonne które wchłaniają i rozprowadzają mocz, absorbent moczu z zawartością substancji neutralizującej zapach (superabsorbent); falbanki oraz bariery wewnętrzne (skierowane do wewnątrz lub na zewnątrz), zapewniające zapobieganie wypływu moczu i kału; wykonane z oddychającego materiału – elastycznego laminatu i włókniny na całym obwodzie zapewniając tym samym dobre dopasowanie do pacjenta na całym obwodzie zamiast ściągaczy taliowych; podwójne elastyczne przylepcorzepy wielokrotnego użytku, dwa wskaźniki chłonności (zużycia produktu) w postaci dwóch żółtych pasków zmieniających barwę pod wpływem moczu i tuszowego nadruku rozmywającego się pod wpływem cieczy?

Odpowiedź: Nie, - Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 155 - Zadanie 71 poz. 3

Czy Zamawiający dopuści w pozycji 3 chłonność 2600 g?

Odpowiedź: Nie, - Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 156 - Pytania dot. wzoru umowy:

Czy Zamawiający zgadza się aby w § 8 ust. 2 wzoru umowy zostało dodane zdanie o następującej (lub podobnej) treści: „Przed rozwiązaniem umowy Zamawiający pisemnie wezwie Wykonawcę do należytego wykonywania umowy.”?

Zważywszy na doniosłe i nieodwracalne skutki prawne rozwiązania umowy, celowe jest aby przed rozwiązaniem umowy Zamawiający wezwał wykonawcę do należytego wykonywania umowy. Takie wezwanie najprawdopodobniej zmobilizuje wykonawcę do należytego wykonywania umowy i pozwoli uniknąć rozwiązania umowy, a tym samym uniknąć skutków rozwiązania umowy, które są niekorzystne dla obu stron

Odpowiedź: Nie, - Zamawiający nie wprowadzi proponowanej zmiany do umowy.

Pytanie 157 - Zadanie 28

Czy Zamawiający dopuści zestaw:

- Serwety z materiału dwuwarstwowego Biflex, o dużej chłonności i wysokiej odporności na przenikanie cieczy
- Serweta główna z materiału trzywarstwowego Triflex z dodatkową warstwą włókniny PP dla zwiększenia komfortu pacjenta
- Gramatura serwet 65g/m² (Biflex) i 83g/m² (Triflex)
- Zgodność z normą PN-EN 13795

Skład

- 1 serweta na stolik instrumentariuszki 150 x 190 cm;
- 1 osłona na stolik Mayo 80 x 145 cm;
- 1 serweta do owinięcia noworodka, włóknina typu Spunlance, 75 x 80 cm;



- 1 serweta główna 180 x 320 cm, z przyklepionym otworem 30 x 25 cm wypełnionym folią chirurgiczną i zintegrowanym, prostokątnym zbiornikiem do przechwytywania płynów (3600). Zbiornik wyposażony w kształtki (szytwniki) oraz 2 zawory odpływowe z możliwością podłączenia do ssaka. Dodatkowo 3 zintegrowane z serwetą organizatory przewodów w formie rzepów;
- 4 ręczniki 30 x 40 cm;

Odpowiedź: Nie, - Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 158 – Zadanie nr 35

Czy Zamawiający dopuści:

- Serwety z materiału dwuwarstwowego Biflex, o dużej chłonności i wysokiej odporności na przenikanie cieczy
- Gramatura serwet 65 g/m²
- Serwety wzmocnione dodatkowym padem chłonnym
- Uniwersalne zastosowanie
- Zgodność z normą PN-EN 13795

Skład

- 1 serweta na stół instrumentariuszki 150 x 190 cm;
- 1 osłona na stół Mayo 80 x 145 cm;
- 1 serweta samoprzylepna 180 x 180 cm z 1 organizatorem przewodów w formie rzepu, pad chłonny 30x60 cm, taśma przyklepna 5 x 100 cm;
- 1 serweta samoprzylepna 150 x 240 cm z 1 organizatorem przewodów w formie rzepu, pad chłonny 30x60 cm, taśma przyklepna 5 x 100 cm;
- 2 serwety samoprzylepne 75 x 100 cm z 2 organizatorami przewodów w formie rzepu, pad chłonny 30x60 cm, taśma przyklepna 5 x 100 cm;
- 4 ręczniki 30 x 40 cm;

Odpowiedź: Tak, - Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 159 – Zadanie nr 46

Czy Zamawiający dopuści:

- Serwety z materiału dwuwarstwowego Biflex, o dużej chłonności i wysokiej odporności na przenikanie cieczy
- Gramatura serwet 65g/m²
- Zgodność z normą PN-EN 13795

Skład

- 1 serweta na stół instrumentariuszki 150 x 190cm;
- 1 serweta 75 x 90cm;
- 1 serweta 150 x 200cm;
- 1 osłona na stół Mayo 80 x 145cm;
- 1 osłona na kończynę z elastyczną tuniką, TPE i dzianinowa siatka poliestrowa, 30 x 120cm;



Pleszewskie Centrum Medyczne
w Pleszewie
Sp. z o.o.



Szpital
Akredytowany

- 1 serweta z taśmą przylepną 180 x 240cm z 2 organizatorami przewodów w formie rzepu, pad chłonny 30x60cm, taśma przylepna 5 x 120cm;
- 1 serweta główna 200 x 300cm, z wycięciem U-kształtnym w rozmiarze 10x100 cm, pad chłonny w rozmiarze 50x100 cm, taśma przylepna wokół wycięcia;
- 2 włókninowe OP Taśmy 10 x 50cm;
- 4 ręczniki 30 x 40cm;

Odpowiedź: Tak, - Zamawiający dopuszcza.

Zadanie 160 – zadanie nr 48

Czy Zamawiający dopuści zestaw:

- Serwety z materiału dwuwarstwowego Biflex, o dużej chłonności i wysokiej odporności na przenikanie cieczy
- Gramatura serwet 65g/m²
- Zgodność z normą PN-EN 13795

Skład

- 1 serweta na stół instrumentariuszki 150 x 190 cm;
- 1 osłona na stół Mayo 80 x 145 cm;
- 1 osłona na kończynę z elastyczną tuniką, TPE i dzianinowa siatka poliestrowa, 30 x 90 cm;
- 1 serweta główna 230 x 320 cm, z samouszczelniającym otworem (Ø 7 cm) i padem chłonnym 50 x 50 cm wokół otworu.

Dodatkowo 2 zintegrowane z serwetą organizatory przewodów w formie rzepów.

- 2 włókninowe OP Taśmy 10 x 50 cm;
- 4 ręczniki 30 x 40 cm;

Odpowiedź: Nie, - Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 161 - Zadanie 51 poz.1

Czy Zamawiający dopuści czepek furazerkę z trokami zamiast gumki?

Odpowiedź: Tak, - Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 162 - Zadanie 51 poz.5

Czy Zamawiający dopuści Koszulę dla pacjenta zakładaną przez głowę z wycięciem pod szyją typu V, krótki rękaw typu kimono. Rozmiar uniwersalny odpowiadający rozmiarowi XL: długość 105cm, obwód w ramionach 160cm, obwód pod pachą 145cm. Wykonana z przewiewnej nie prześwitującej włókniny SMS kolor niebieski 35g/m².

Odpowiedź: Tak, - Zamawiający dopuszcza.



Pleszewskie Centrum Medyczne
w Pleszewie
Sp. z o.o.



Szpital
Akredytowany

Pytanie 163 - Zadanie 51 poz. 7

Czy Zamawiający dopuści fartuch o gramaturze min.20g/m2?

Czy Zamawiający dopuści fartuch w rozmiarze uniwersalnym?

Odpowiedź: Nie, - Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 164 - Zadanie 52 poz.1,2

Czy Zamawiający dopuści 3 etykiety samoprzylepne do dokumentacji?

Odpowiedź: Tak, - Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 165 - Zadanie 52 poz.2

Czy Zamawiający dopuści fartuch z wzmocnieniami o gramaturze 40g/m2? Pozostałe wymogi zgodnie z SWZ.

Odpowiedź: Tak, - Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 166 - Zadanie 55

Czy Zamawiający dopuści podkład z włókniny polipropylenowej podfoliowanej folią (PP+PE) o gramaturze 20g/m2+20g/m2?

Odpowiedź: Nie, - Zamawiający nie dopuszcza.

Czy Zamawiający dopuści podkład wykonany z dwóch warstw celulozy oraz warstwy folii PE, dodatkowo podkład wzmocniony 48 nitkami poliestrowymi. Rozmiar 80x210cm, gramatura: celuloza 34g/m2, folia 22g/m2; folia 22 mikrony.

Odpowiedź: Tak, - Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 167 - Zadanie 63

Czy Zamawiający dopuści ręczniki w rozmiarze 40x30cm?

Czy Zamawiający dopuści ręczniki pakowane a`2szt?

Odpowiedź: Nie, - Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 168

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wyodrębnienie w toku niniejszego postępowania z części nr 65 pozycji nr 1 - ŚRODEK HEMOSTATYCZNY Z APLIKATOREM (objętość- 1, 3 oraz 5 gramów) oferowany przez wykonawcę proszek hemostatyczny zawiera w swoim zestawie aplikatory wymienione w pozycji nr 2 na rzecz oddzielnego zadania w celu otrzymania alternatywnej, bardzo korzystnej cenowo, przewyższająco technologicznie oferty oraz w celu zwiększenia konkurencyjności i otrzymania produktu prawdopodobnie bardziej atrakcyjnego dla Zamawiającego? Jako producent proszku hemostatycznego posiadamy w swojej ofercie gotowe zestawy: proszek wraz z aplikatorem do jego podania, co zapewnia bezpieczeństwo podczas użytkowania. Warto podkreślić, iż modyfikacja treści SWZ w postulowanym powyżej brzmieniu (poprzez wydzielenie ww. pozycji), pozwoli Zamawiającemu spełnić wymogi poszanowania w ramach niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego zasad wskazanych w ustawie PZP (w tym w szczególności art.16 i art.99), ale także przepisów ustawy o finansach publicznych (w zakresie racjonalnego



Pleszewskie Centrum Medyczne
w Pleszewie
Sp. z o.o.



Szpital
Akredytowany

wydatkowania środków publicznych). Pragniemy zwrócić uwagę na wyrok KIO z 17 lipca 2013 r.; sygn. KIO 1606/13, który wskazuje, iż „Samo podjęcie próby udzielenia wyjaśnień czy też udzielenie takich, które w istocie nie stanowią pełnej odpowiedzi na wniosek wykonawcy, nie może być traktowane jako wykonanie dyspozycji normy, wyrażonej w przepisie art. 38 ust. 1 ustawy Pzp. Zdaniem KIO instytucja wyjaśnień nie służy bowiem formalnemu wykonaniu obowiązku wyartykułowanego we wskazanym przepisie. Ma ona umożliwić wykonawcom powzięcie wiedzy niezbędnej do podjęcia decyzji co do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego”. Dlatego uprzejmie prosimy o merytoryczne ustosunkowanie się do zadanego przez oferenta pytania, odpowiedź o treści „zgodnie z SIWZ” nie będzie w tym wypadku wystarczająca, o czym stanowi przytoczony fragment wyroku.

Zwracamy się do Zamawiającego z pytaniem o dopuszczenie do Zadania 65, pozycji 1 oraz 2 polisacharydowego proszku hemostatycznego w opakowaniu 1g wraz z aplikatorem 10 cm, nie-pirogenego, uzyskiwanego z oczyszczonej skrobi roślinnej, cząsteczki polimeru modyfikowanego są rozkładane przez amylazę i glukoamylazę w ciągu 2-3 dni. Proszek przeznaczony jest do użycia w przypadkach, gdy kontrola krwawienia z naczyń włosowatych, żylnych lub tętniczych przy zastosowaniu ucisku, podwiązania czy innych konwencjonalnych metod jest nieefektywna lub niepraktyczna.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyodrębni pakietu 65 poz. 1. Pozycja 2 musi być kompatybilna z proszkiem hemostatycznym.

Pytanie 169 - Pakiet 28

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie zestawu o poniższym składzie :

- 1 x serweta na stolik narzędziowy 152x190cm wzmocnienie z folii PE z warstwą chłonną (owinięcie zestawu)
- 1 x serweta na stolik Mayo 80 x142 cm ze wzmocnieniem
- 1 x kocyk dla noworodka 76x86 cm
- 1x ręczniki 35x35 +/-1cm
- 1 x serweta do cięcia cesarskiego 196/259x307cmz obłożeniem ramion stołu, z otworem brzusznymp wypelnionym folią chirurgiczną z wycięciem w kształcie gruszki 18x18 cm, ze zintegrowaną torbą na płyny 360° z kształtką usztywniającą umożliwiającą uformowanie i utrzymanie kształtu worka oraz z zabezpieczeniem zapobiegającym rozerwaniu serwety lub ubioru operatora na końcach usztywnień torby, z 2 portami do ssaka, ze wzmocnieniem chłonnym 40x50 +/- 3 cm poniżej otworu, 3 zintegrowane organizatory przewodów typu rzep. Serweta wykonana z wielowarstwowej włókniny polipropylenowej typu SMS o gramaturze max. 43 g/m2, wzmocnienie chłonne wykonane laminatu, łączna gramatura materiału min.115 g/m2 o odporności na penetracje płynów min. 200 cmH2O, serweta dobrze układające się na pacjentce, w części niekrytycznej „oddychająca”, paroprzepuszczalna. I klasa palności. Zestaw spełnia wymagania dla procedur wysokiego ryzyka wg normy EN 13795 pakowany sterylnie w przezroczystą, foliową torbę z portami do sterylizacji, posiada 4 etykiety samoprzylepne do dokumentacji medycznej zawierające: numer katalogowy, numer lot, datę ważności oraz nazwę producenta, w tym 2 etykiety dodatkowo zawierające kod kreskowy . Sterylizacja tlenkiem etylenu. Zestawy pakowane zbiorczo w worek foliowy, następnie karton. Producent spełnia wymogi normy środowiskowej ISO 14001 potwierdzony certyfikatem

Odpowiedź: Tak, - Zamawiający dopuszcza.



Pleszewskie Centrum Medyczne
w Pleszewie
Sp. z o.o.



Szpital
Akredytowany

Pytanie 170 - Pakiet 28

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie zestawu o poniższym składzie :

- 1 x serweta na stolik narzędziowy 140x190 cm z folii PE 50 μ ze wzmocnieniem (owinięcie zestawu)
- 1 x serweta na stolik Mayo 80x142 cm ze wzmocnieniem chłonnym
- 1 x kocyk dla noworodka 100x105 cm
- 2 x ręcznik chłonny 20x30 cm
- 1 x serweta do cięcia cesarskiego 196x249x300 cm z obłożeniem ramion stołu, z otworem 30x36cm wypełniony folią chirurgiczną wokół brzegów otworu, ze zintegrowaną torbą na płyny 270° z kształtką usztywniającą umożliwiającą uformowanie i utrzymanie kształtu worka oraz z 2 portami do ssaka, wzmocnienie chłonne wokół otworu 50x65+/- 3cm, zintegrowane 4 podwójne organizatory przewodów oraz dodatkowe wzmocnienie chłonne na kończynach pacjentki 40x60 +/-3cm. Część główna serwety osłaniająca pacjentkę wykonana z laminatu z warstwą komfortu (trilaminat o gramaturze max. 66g/m²) pozbawiona pyłących i łatwopalnych włókien celulozy i wiskozy (współczynnik pylenia $\leq 1,9 \log_{10}$), boki wykonane z pełnobarierowej folii, ekran anestezyjologiczny wykonany z laminatu dwuwarstwowego. I klasa palności. Zestaw spełnia wymagania dla procedur wysokiego ryzyka wg normy EN 13795 pakowany sterylnie w przezroczystą, foliową torbę z portami do sterylizacji, posiada 4 etykiety samoprzylepne do dokumentacji medycznej zawierające: numer katalogowy, numer lot, datę ważności oraz nazwę producenta, w tym 2 etykiety dodatkowo zawierające kod kreskowy . Sterylizacja tlenkiem etylenu. Zestawy pakowane zbiorczo w worek foliowy, następnie karton. Producent spełnia wymogi normy środowiskowej ISO 14001 potwierdzone certyfikatem.

Odpowiedź: Nie, - Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 171 - Pakiet 28

Czy Zamawiający wymaga obłożenia do cięcia cesarskiego ze wzmocnieniem zarówno w okolicy otworu, jak i dodatkowego na kończynach pacjentki?

Odpowiedź: Nie, - Zamawiający nie wymaga.

Pytanie 172 - Pakiet 35

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie zestawu o poniższym składzie :

- 1 x serweta na stolik narzędziowy 140x190 cm z folii PE 50 μ ze wzmocnieniem (owinięcie zestawu)
 - 1 x serweta na stolik Mayo 80x142 cm ze wzmocnieniem, składana rewersowo
 - 2 x serwety boczne 75x90 cm, przylepna na dłuższym boku
 - 1 x serweta dolna 175x175 cm, przylepna
 - 1 x serwetę górną 150x240 cm, przylepna (taśma lepna dł. ok 80 cm)
 - 1 x taśma lepna 9x50 cm
 - 4 x ręcznik chłonny z mikrosiecią zabezpieczająca przed rozrywaniem 20x30 cm
- Serwety okrywające pacjenta wykonane z chłonnego na całej powierzchni laminatu 2-warstwowego o gramaturze max. 58g/m², dobrze układającego się na pacjencie, odpornego na przenikanie płynów > 175 cm H₂O) odpornego na rozerwanie na mokro/sucho (min. 145 kPa), niepyłącego (współczynnik pylenia $\leq 1,7 \log_{10}$). W celu ułatwienia aplikacji serwety złożone książkowo, z nieprzylepnymi końcówkami przy taśmach o szerokości ok. 5cm zabezpieczającymi część lepną serwet pozwalające w rękawicach jednych ruchem odkryć część lepną do aplikacji serwet na pacjencie. I klasa palności. Zestaw spełnia wymagania dla procedur wysokiego ryzyka wg normy EN 13795 pakowany sterylnie w przezroczystą, foliową torbę z portami do sterylizacji, posiada 4 etykiety samoprzylepne do dokumentacji medycznej zawierające: numer katalogowy, numer lot, datę ważności, nazwę producenta w tym 2 etykiety dodatkowo z kodem EAN.



Pleszewskie Centrum Medyczne
w Pleszewie
Sp. z o.o.



Szpital
Akredytowany

Steryliczacja EO. Zestawy pakowane zbiorczo w worek foliowy, następnie karton. Producent spełnia wymogi normy środowiskowej ISO 14001 potwierdzony certyfikatem.

Odpowiedź: Nie, - Zamawiający nie dopuszcza.

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie zestawu o poniższym składzie :

- 1x serweta na stolik narzędziowy 150x190 cm, z warstwą chłonna na całej powierzchni
- 1x serweta na stolik Mayo 80x150 cm ze wzmocnieniem chłonnym w części centralnej 65x150 cm
- 4x ręcznik chłonna 40x40 cm
- 1x taśma lepna 10x50 cm
- 1x taśma lepna 10x25 cm
- 2x serweta boczna 75x90 cm
- 1x serweta górna 150x240 cm
- 1x serweta dolna 180x180 cm

Serwety okrywające pacjenta wykonane z chłonnego na całej powierzchni laminatu 2-warstwowego o gramaturze 55g/m² ±1, dobrze układającego się na pacjencie, odpornego na przenikanie płynów >180 cm H₂O) odpornego na rozerwanie na mokro/sucho (min. 170 kPa), niepylącego (współczynnik pylenia ≤ 1,2 log10). Zestaw spełnia wymagania dla procedur wysokiego ryzyka wg normy EN 13795, pakowany sterylnie w przezroczystą, foliową torbę z portami do sterylizacji, posiada 4 etykiety samoprzylepne do dokumentacji medycznej zawierające: numer katalogowy, numer lot, datę ważności, nazwę producenta, kod EAN, następnie zbiorczo w karton. Steryliczacja EO.

Odpowiedź: Tak, - Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 173 - Pakiet 35

1. Prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający oczekuje zestawów z serwetami okrywającymi pacjenta, które są pełnobarierowe i chłonne na całej powierzchni zarówno w obszarze krytycznym jak i poza nim?

Odpowiedź: Wielkości wzmocnień są podane w SWZ.

2. Prosimy zamawiającego o doprecyzowanie czy oczekuje zestawów sterylizowanych tlenkiem etylenu, dzięki czemu serwety są mniej pogniecione i nie posiadają nieprzyjemnego zapachu jak w przypadku sterylizacji radiacyjnej.

Odpowiedź: Zamawiający nie wymaga.

3. Czy zamawiający oczekuje zestawu z 4 etykietami do dokumentacji medycznej.

Odpowiedź: Zamawiający oczekuje min. 2 etykiet.

Pytanie 174 - Pakiet 46

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie zestawu o poniższym składzie :

- 1 x serweta na stolik narzędziowy min. 140x190 cm z foli PE 50 μ ze wzmocnieniem
- 1 x serweta na stolik Mayo, 80x145 cm ze wzmocnieniem chłonnym 75x100cm +/-1cm
- 5 x taśma przyklepna, przezroczysta 8x40 cm
- 1 x osłona na kończynę 35x120cm 2-warstwowa, z warstwą chłonną od wewnętrznej strony
- 1 x serweta 190x190 cm długość przyklepca 85 cm
- 1 x serweta górna 300x220 +/-2cm długość przyklepca 130 cm
- 1 x serweta do operacji biodra 230x305 +/-2 cm ze wzmocnieniem chłonnym 70x100 +/- 2cm cm , z wycięciem U 15x117 cm zaopatrzonym w taśmy lepne, które umożliwiają trójstopniową aplikację na pacjencie i obejmują precyzyjnie zaokrąglenia wycięcia U . Serwety okrywające pacjenta wykonane z chłonnego na całej powierzchni bilaminatu o gramaturze max. 58g/m² , niskim współczynniku pylenia ≤1,7 log10, wysokiej odporności przenikanie płynów > 175 cm H₂O. Obszar wzmocnienia bez



Pleszewskie Centrum Medyczne
w Pleszewie
Sp. z o.o.



Szpital
Akredytowany

wiskozy i celulozy o łącznej gramaturze $>121\text{g/m}^2$ i wysokiej absorpcji $>700\text{ml/m}^2$. I klasa palności. W celu ułatwienia aplikacji serwety złożone książkowo, z nieprzelepnymi końcówkami przy taśmach o szerokości 5cm zabezpieczającymi część lepną serwet pozwalające w rękawicach odkryć część lepną do aplikacji serwet na pacjencie. Zestaw pakowany sterylnie w przezroczystą, foliową torbę z portami do sterylizacji, posiada 4 etykiety samoprzylepne do dokumentacji medycznej zawierające: numer katalogowy, numer lot, datę ważności oraz nazwę producenta w tym 2 etykiety dodatkowo z kodem kreskowym. Zestawy zbiorczo pakowane w worek foliowy, następnie karton. Sterylizacja EO. Zestaw spełnia wymagania dla procedur wysokiego ryzyka wg normy PN13795. Producent spełnia wymogi normy środowiskowej ISO 14001 potwierdzony certyfikatem

Odpowiedź: Tak, - Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 175 - Pakiet 46

Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie czy należy zaoferować obłożenie z serwetą U, której część lepna obejmuje precyzyjnie wycięcie „U” łącznie z zaokrągleniami celem właściwej aplikacji.

Odpowiedź: Tak.

Pakiet 51 poz. 7

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie fartucha w rozmiarze uniwersalnym

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

Pakiet 52 poz. 1

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie sterylnego fartucha chirurgicznego wykonanego z włókniny typu SMS o gramaturze 40g/m^2 . Rękawy fartucha zakończone elastycznym mankietem z dzianiny, łączone za pomocą ultradźwięków, z tyłu wiązany na troki umieszczone w kartoniku oraz zapinany na rzep przy szyi, krój prosty. Barrierowość min. $37\text{cm H}_2\text{O}$, wytrzymałość na wypychanie 170kPa , wytrzymałość na rozciąganie na mokro $\text{CD } 62\text{ N/MD } 114\text{ N}$. Pakowany w opakowanie papier/folia. Wyrób medyczny klasy Is. Zgodny z normą EN 13795-1:2019. Sterylizowany tlenkiem

Odpowiedź: Tak, - Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 176 - Pakiet 52 poz. 2

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie sterylnego fartucha chirurgicznego wykonanego z włókniny typu SMS o gramaturze podstawowej 40g/m^2 , ze wzmocnieniem chłonnym wykonanym z włókniny o gramaturze 26g/m^2 . Wzmocnienie w części krytycznej, na rękawach i z przodu na pełnej długości fartucha (mocowane od wewnętrznej strony). Rękawy fartucha zakończone elastycznym mankietem z dzianiny, łączone za pomocą ultradźwięków, z tyłu wiązany na troki umieszczone w kartoniku oraz zapinany przy szyi na rzep, z oznaczeniem rozmiaru na metce, krój prosty. Pakowany w podwójnie w opakowanie papier/folia i papier krepowy, w komplecie z dwoma ręcznikami. Wyrób medyczny klasy Is. Zgodny z normą EN 13795-1:2019. Sterylizowany tlenkiem etylenu.

Odpowiedź: Nie, - Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 177 - Pakiet 55

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie serwety ochronnej na stół operacyjny, przeciwodrażynowej, 5-cio warstwowej, zintegrowanej wielopunktowo – brak możliwości tworzenia zagięć i pofałdowań pod pacjentem, samowygładzająca się. Rdzeń chłonny z wyraźnym pikowanym wzorem ułatwiającym rozprowadzanie wilgoci. Wykonana z włókniny polipropylenowej, wysokochłonnej warstwy środkowej z SAP i spodniej pełnobarierowej folii polietylenowej, zabezpieczającej przed przesuwaniem się i ślizganiem podkładu po powierzchni. Wszystkie krawędzie uszczelnione. Certyfikaty jakościowe dla miejsca produkcji: ISO 13485, ISO 9001 i ISO 14001, wystawione przez jednostki notyfikowane.



Pleszewskie Centrum Medyczne
w Pleszewie
Sp. z o.o.



Szpital
Akredytowany

Parametry:

- chłonność 3750 – 4000 ml/m², (test potwierdzony badaniami wykonanymi w laboratorium akredytowanym zg. ISO 9073-6), wskaźnik chłonności min. 2490 %
- gramatura podstawowa: 150 g/m² (+/- 10%),
- wymiary: 102 x 230cm, rdzeń chłonny otoczony z każdej strony dodatkowymi marginesami nieprzeziernego laminatu na całej szerokości podkładu.
- pakowana po 20 sztuk/karton

Odpowiedź: Tak, - Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 178 - Pakiet 59

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie sterylnego, jednorazowego pokrowca na przewody o szer. 13 cm oraz dł. 240 cm, wykonanego z mocnej folii PE (50μ, gramatura 46g/m²), z perforowaną jedną końcówką zwięzającą się, złożony teleskopowo, z taśmą lepną do mocowania o długości min. 18 cm oraz z kartonikiem ułatwiającym aplikację. Opakowanie jednostkowe typu peel pouch zaopatrzone w 4 etykiety samoprzylepne posiadające indeks wyrobu, numer lot, datę ważności, nazwę producenta. Osłony pakowane zbiorczo po 25 szt. w worek foliowy, następnie karton. Producent spełnia wymogi normy środowiskowej ISO 14001 potwierdzonej certyfikatem.

Odpowiedź: Tak, - Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 179 - Pakiet 60

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie sterylnego zestawu o składzie:

- 1 owinięcie zestawu wykonane z miękkiej włókniny 30x30cm,
- 1 osłona sondy 15x122 cm wykonana z przezroczystego poliuretanu o delikatnie matowej powierzchni zapobiegającej odbłaskom
- 1 sterylny żel 20g w saszetce
- 2 elastyczne gumki

Zestaw zapakowany jednostkowo w rozrywaną torebkę papierowo –foliową, posiada 4 naklejki zawierające numer katalogowy, numer lot, datę ważności i nazwę producenta, w tym 2 naklejki dodatkowo z kodem kreskowym. Sterylizacja tlenkiem etylenu. Zestawy pakowane zbiorczo po 20 szt. w worek foliowy następnie w karton transportowy.

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ

Pytanie 180 - Pakiet 62

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie sterylnej serwety na stolik Mayo 80x142 cm wykonanej z mocnej folii PE o grubości 70μ o gramaturze 65g/m², ze wzmocnieniem chłonnym o wymiarze 55x88cm - włóknina polipropylenowa o gramaturze 30 g/m² zespolona z folią na całej powierzchni. W obszarze krytycznym gramatura 95 g/m². Spełnia wymagania dla procedur wysokiego ryzyka wg normy EN 13795. Składana rewersowo. Serwety pakowane jednostkowo w rozrywaną torebkę papierowo-foliową. Opakowanie zaopatrzone w 4 etykiety przylepne, zawierające numer katalogowy, serię i datę ważności oraz informację o producencie. Wszystkie sztuki w kartonie zbiorczym dodatkowo zapakowane w torbę foliową. Sterylizacja tlenkiem etylenu.

Odpowiedź: Tak, - Zamawiający dopuszcza.



Pytanie 181 - Pakiet 63

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie ręczniczków pakowanych podwójnie z odpowiednim przeliczeniem ilości.

Odpowiedź: Nie, - Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 182

Czy Zamawiający dopuści w pakiecie nr 50 jałowe obłożenie do zabiegów kardiologii inwazyjnej spełniający wymogi normy PN-EN 13795 o składzie:

- 1 x serweta angiograficzna z włókniny SMS w rozm. 208 x 330 cm z 2 otworami do wkluc oraz z przezroczystą folią na panel sterowania (nakrycie pacjenta)
- 1 x serweta do nakrycia stolika zabiegowego 152x190cm i do zawinięcia zestawu
- 1 x serweta absorbująca o wysokiej chłonności płynów 60 x 90 cm
- 1 x osłona foliowa ochronna z elastyczną krawędzią (z gumką) typu torba o wym. 60x60cm
- 1 x chusta 75 x90 cm (lamilat dwuwarstwowy)
- 1 x miska niebieska na przewodnik 2,5l, 24cm, H7, z brzegami zapobiegającymi wysunięciu się sprzętu na zewnątrz
- 1 x fartuch zabiegowy rozm. XL
- 2 x etykiety samoprzylepne umieszczone na etykiecie zestawu z nadrukiem w języku polskim zawierające informacje o nazwie zestawu, numerze katalogowym i datą ważności do wklejenia w dokumentację medyczną

Zestaw zapakowany w opakowanie folia – papier. Skład zestawu w j. polskim na etykiecie zewnętrznej?

Odpowiedź: Tak, - Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 183

Czy Zamawiający dopuści w pakiecie nr 76 jałowe obłożenie do zabiegów kardiologii inwazyjnej spełniający wymogi normy PN-EN 13795 o zmienionym składzie:

- 1 x Chusta na pacjenta o wym. 235x330cm z dwoma prostokątnymi otworami obojczykowymi o wym. 12x16cm wypełnionymi w całości folią chirurgiczną. Otwory oddalone od siebie o 12-13cm, umieszczone 75cm od górnego brzegu chusty. Wzmocnienie w strefie krytycznej o wym. 75x120cm. Przezroczysty panel z 2 stron od dołu chusty o wym. 90x145cm.
- 1 x serweta do nakrycia stolika zabiegowego 152x190cm i do zawinięcia zestawu
- 1 x serweta absorbująca o wysokiej chłonności płynów 60 x 90 cm
- 1 x chusta 75 x90 cm (lamilat dwuwarstwowy)
- 1 x fartuch zabiegowy rozm. XL
- 2 x etykiety samoprzylepne umieszczone na etykiecie zestawu z nadrukiem w języku polskim zawierające informacje o nazwie zestawu, numerze katalogowym i datą ważności do wklejenia w dokumentację medyczną



Pleszewskie Centrum Medyczne
w Pleszewie
Sp. z o.o.



Szpital
Akredytowany

Zestaw zapakowany w opakowanie folia – papier. Skład zestawu w j. polskim na etykiecie zewnętrznej?
Odpowiedź: Tak, - Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 184

Czy Zamawiający dopuści w pakiecie nr 76 jałowe obłożenie do zabiegów kardiologii inwazyjnej spełniający wymogi normy PN-EN 13795 o zmienionym składzie:

- 1 x Chusta na pacjenta o wym. 240x335cm z dwoma prostokątnymi otworami obojczykowymi o wym. 20x20cm wypełnionymi w całości folią chirurgiczną. Otwory oddalone od siebie o 11-13cm, umieszczone 115cm od górnego brzegu chusty. Przezroczysty panel z 2 stron o wym. 70x335cm..
- 1 x serweta do nakrycia stolika zabiegowego 152x190cm i do zawinięcia zestawu
- 1 x serweta absorbująca o wysokiej chłonności płynów 60 x 90 cm
- 1 x chusta 75 x90 cm (lamilat dwuwarstwowy)
- 1 x fartuch zabiegowy rozm. XL
- 2 x etykiety samoprzylepne umieszczone na etykiecie zestawu z nadrukiem w języku polskim zawierające informacje o nazwie zestawu, numerze katalogowym i datą ważności do wklejenia w dokumentację medyczną

Zestaw zapakowany w opakowanie folia – papier. Skład zestawu w j. polskim na etykiecie zewnętrznej?
Odpowiedź: Nie, - Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 185

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w pakiecie nr 28

Zestaw serwet jałowych do cięcia cesarskiego o składzie:

- 1 x Serweta na stół instrumentalny 150 x 190cm
- 1 x Serweta czerwona na stolik Mayo 80 x 145cm
- 1 x Serweta do cięcia cesarskiego 200/250 x 315cm w kształcie litery T, z otworem o wymiarach 18 x 28 x 32cm
- 1 x Serweta dla noworodka 90 x 100cm
- 1 x Taśma samoprzylepna 10 x 50cm
- 2 x Ręcznik chłonny 40 x 40cm

Odpowiedź: Nie, - Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 186

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w pakiecie nr 35

Zestaw serwet jałowych uniwersalnych wzmocniony o składzie:

- 1 x Serweta na stół instrumentalny 150x 190cm
- 1 x Serweta czerwona na stolik Mayo 80 x 145cm
- 1 x Serweta przylepna 150 x 240cm – „górna”, gramatura 56g/m². Strefa przylepna o wymiarach 180 x 5cm zawiera wzmocnienie o wymiarze 25 x 60cm
- 1 x Serweta przylepna 170 x 200cm – „dolna”, gramatura 56g/m². Strefa przylepna o wymiarach 100 x 5cm zawiera wzmocnienie o wymiarze 25 x 60cm



- 2 x Serweta przylepna 75 x 90cm – „boczna”, gramatura 56g/m². Strefa przylepna o wymiarach 90 x 5cm zawiera wzmocnienie o wymiarze 25 x 40cm
- 4 x Ręcznik chłonny, wykonany z gofrowanej celulozy o wymiarach 40 x 40 cm
- 2 x Taśma przylepna OP o wymiarze 10 x 50cm.

Odpowiedź: Tak, - Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 187 - Pakiet 72

Poz.1

Czy Zamawiający dopuści opatrunek z pianki poliuretanowej z silikonową warstwą kontaktową o wym. 10x10 cm, która chroni otaczającą skórę i zmniejsza ból pozostałe zapisy w opisie przedmiotu zamówienia pozostają bez zmian.

Poz. 2

Czy Zamawiający dopuści opatrunek z pianki poliuretanowej z silikonową warstwą kontaktową o wym. 15x15 cm, która chroni otaczającą skórę i zmniejsza ból pozostałe zapisy w opisie przedmiotu zamówienia pozostają bez zmian.

Odpowiedź: Nie, - Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 188 - Pakiet 73 - Poz 1.

Czy Zamawiający dopuści opatrunek piankowy z silikonem Kliniderm® z brzegiem klejącym na piętę o rozmiarze 10X17,5cm. To miękki, dopasowujący się, chłonny opatrunek z pianki poliuretanowej z silikonową warstwą kontaktową i warstwą folii przepuszczającej wilgoć. Opatrunki zapewniają wilgotne środowisko gojenia się ran.

Odpowiedź: Tak, - Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 189 - Pytanie nr 9 – dotyczy Zadania nr 35

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie niżej opisanego zestawu, minimalnie różniącego się od opisanego w SWZ?

Zestaw serwet, uniwersalnych wykonany z chłonnego, wytrzymałego i nieprzemakalnego laminatu trzywarstwowego o

gramaturze 75g/m² z dodatkowym padem chłonnym o gramaturze 80g/m² (łącznie gramatura 155g/m²)

- a) Serweta samoprzylepna o wymiarach 150x240cm wzmocnienie o wymiarach 25x60cm + organizatory przewodów - 1 szt.
- b) Serweta samoprzylepna o wymiarach 180x180cm, wzmocnienie o wymiarach 25x60cm + organizatory przewodów- 1 szt.,
- c) Serwety boczne samoprzylepne o wymiarach 90 cm x 75 cm, wzmocnione o wymiarach 25x60cm + organizatory przewodów - 2 szt.,
- d) Pokrowiec na stół MAYO o wymiarach 79x145 cm - 1 szt
- e) Ściereczki chłonne - 4 szt.
- f) Taśma włókninowa samoprzylepna o wymiarach 9 x 50 cm - 1 szt.



Pleszewskie Centrum Medyczne
w Pleszewie
Sp. z o.o.



Szpital
Akredytowany

h) Całość owinięta w serwetę wzmocnioną o wymiarach 150x190cm - 1 szt., która może służyć jako przykrycie stolika instrumentalnego,

i) Całość zapakowana w torebkę Tyvec-folia, zaopatrzona w etykietę samoprzylepną, z możliwością wklejenia jej do

dokumentacji, umożliwiającą identyfikację wyrobu,

Odporność na penetrację płynów w obszarze krytycznym (nieprzemakalność) 165cmH₂O

Przedmiot zamówienia wykonany zgodnie z normą PN-EN 13795-1:2019

Odpowiedź: Tak, - Zamawiający dopuszcza.

Treść niniejszego pisma staje się częścią specyfikacji warunków zamówienia i Wykonawcy zobowiązani są ją uwzględnić w składanych ofertach.

Z poważaniem

PREZES ZARZĄDU
PCM w Pleszewie Sp. z o.o.

Błażej Gorczyński

Sporządziła :
Magdalena Janicka
(62) 74-20-719

