

WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY WE WROCŁAWIU

51-124 Wrocław, ul. H. Kamińskiego 73a
telefony: centrala 71 32 70 100, fax 71 32 54 101
www.wssk.wroc.pl

Szp/FZ – 22/ 237/2019


Wrocław, dnia 27.05.2019 r.

INFORMACJA NR 3 DLA WYKONAWCÓW

Dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławiu przy ul. Kamińskiego 73 a zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.) jako kierownik Zamawiającego przekazuje treść zapytań oraz wyjaśnienia do postępowania pn.: „*Dostawa aparatury medycznej*”.

Pytanie nr 1 - Zadanie nr 6, pozycja nr 1

1. Czy Zamawiający dopuści do postępowania przetargowego wysokiej jakości materace przeciwodleżynowe zbudowane z 20 poprzecznych komór? Poniżej znajduje się fotografia oferowanego przez Wykonawcę przedmiotu zamówienia.

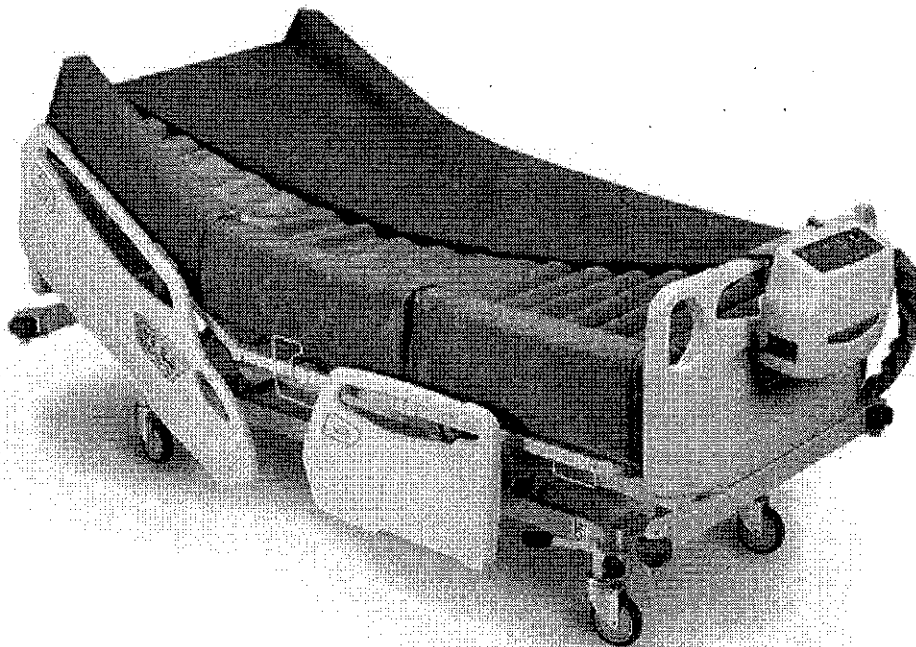

2. Czy Zamawiający dopuści do postępowania przetargowego wysokiej jakości materace przeciwodleżynowe z kątem przechyłu/rotacji regulowanym w zakresie 10 – 60 minut modułem: 10, 20, 30, 60 minut? Funkcja rotacji w trybie statycznym – 10 minut, pozostałe czasy w trybie zmiennociśnieniowym. Maksymalny czas przechyłu/rotacji: 60 minut.

3. Czy Zamawiający dopuści do postępowania przetargowego wysokiej jakości materace przeciwodleżynowe o wymiarach: 200 x 90 x 13 cm, wysokość komór bocznych do zabezpieczenia pacjenta podczas przechyłów bocznych i/lub rotacji: 25,4 cm?
4. Czy Zamawiający dopuści do postępowania przetargowego wysokiej jakości materace przeciwodleżynowe z komorami bocznymi napełniającymi się i opróżniającymi razem z komorami głównymi?
5. Czy Zamawiający dopuści do postępowania przetargowego wysokiej jakości materace przeciwodleżynowe, w których operator ustawia wagę pacjenta natomiast pompa reguluje optymalne ciśnienie materaca w stosunku do ustawionej wagi pacjenta?
6. Czy Zamawiający dopuści do postępowania przetargowego wysokiej jakości materace przeciwodleżynowe z pokrowcem rozciągliwym czterokierunkowo, nieprzezroczystym, w kolorze niebieskim?
7. Czy Zamawiający dopuści do postępowania przetargowego wysokiej jakości materace przeciwodleżynowe o udźwigu do 180 kg?
8. Czy Zamawiający dopuści do postępowania przetargowego wysokiej jakości materace przeciwodleżynowe z możliwością transportu pacjenta na materacu pozbawionym zasilania w czasie do 8 godzin?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ w zakresie pkt 1 do 8.

Pytanie nr 1 - Zadanie nr 6, pozycja nr 2

1. Czy Zamawiający dopuści do postępowania przetargowego wysokiej jakości materace przeciwodleżynowe w cyklu o regulowanym czasie 10/15/20/25 minut? Komory w sekcji głowy stale napełnione powietrzem. Poniżej znajduje się fotografia oferowanego przez Wykonawcę przedmiotu zamówienia.



2. Czy Zamawiający dopuści do postępowania przetargowego wysokiej jakości materace przeciwodleżynowe z jednym trybem statycznym?
3. Czy Zamawiający dopuści do postępowania przetargowego wysokiej jakości materace przeciwodleżynowe zbudowane z 20 poprzecznych komór?
4. Czy Zamawiający dopuści do postępowania przetargowego wysokiej jakości materace przeciwodleżynowe z kątem przechyłu/rotacji regulowanym w zakresie 10 – 60 minut modułem: 10, 20, 30, 60 minut? Funkcja rotacji w trybie statycznym – 10 minut, pozostałe czasy w trybie zmiennociśnieniowym. Maksymalny czas przechyłu/rotacji: 60 minut.
5. Czy Zamawiający dopuści do postępowania przetargowego wysokiej jakości materace przeciwodleżynowe o wymiarach: 200 x 90 x 13 cm, wysokość komór bocznych do zabezpieczenia pacjenta podczas przechyłów bocznych i/lub rotacji: 25,4 cm?
6. Czy Zamawiający dopuści do postępowania przetargowego wysokiej jakości materace przeciwodleżynowe, w których operator ustawia wagę pacjenta natomiast pompa reguluje optymalne ciśnienie materaca w stosunku do ustawionej wagi pacjenta?
7. Czy Zamawiający dopuści do postępowania przetargowego wysokiej jakości materace przeciwodleżynowe z pokrowcem rozciągliwym czterokierunkowo, nieprzezroczystym, w kolorze niebieskim?
8. Czy Zamawiający dopuści do postępowania przetargowego wysokiej jakości materace przeciwodleżynowe o udźwigu do 180 kg?
9. Czy Zamawiający dopuści do postępowania przetargowego wysokiej jakości materace przeciwodleżynowe z możliwością transportu pacjenta na materacu pozbawionym zasilania w czasie do 8 godzin?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ w zakresie pkt 1 do 9.

Powyższe zmiany są integralną częścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia i dotyczą wszystkich Wykonawców, biorących udział w w/w postępowaniu Wykonawca zobowiązany jest złożyć ofertę z uwzględnieniem powyższego.

UPOWAŻNIENIA DYREKTORA
Z-ca DYREKTORA
ds. Finansów i Administracji

mgr inż. Jadwiga Raziuk

