



INFORMACJA NR 2 DLA WYKONAWCÓW

Dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławiu przy ul. Kamieńskiego 73a, działając na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2022r. poz. 1710) jako kierownik Zamawiającego przekazuje treść zapytań oraz wyjaśnienia do postępowania pn.: „*dostawa ambulansu specjalistycznego „P” spełniającego wymagania dot. konstrukcji i wyposażenia typu C wg PN-EN 1789:2008*”.

Pytanie nr 1

Czy Zamawiający dopuści nosze transportowe nie posiadające na wyposażeniu materaca konturowanego, profilowanego i stabilizującego ? Opisane przez Zamawiającego nosze składane w krzesło nie mają możliwości zastosowania takiego materaca.

Prosimy o dopuszczenie noszy z standardowym matercem umożliwiającym ustawienie wszystkich wymaganych przez Zamawiającego pozycji.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe rozwiązanie.

Pytanie nr 2


Czy Zamawiający dopuści poniższe krzesło transportowe z systemem elektrycznym:

DYREKTOR SZPITALA

Prof. dr hab. Wojciech Witkiewicz
(5)

Z-ca Kierownika Działu
Zaopatrzenia i Zamówień Publicznych

mgr inż. Jacek Banaszak

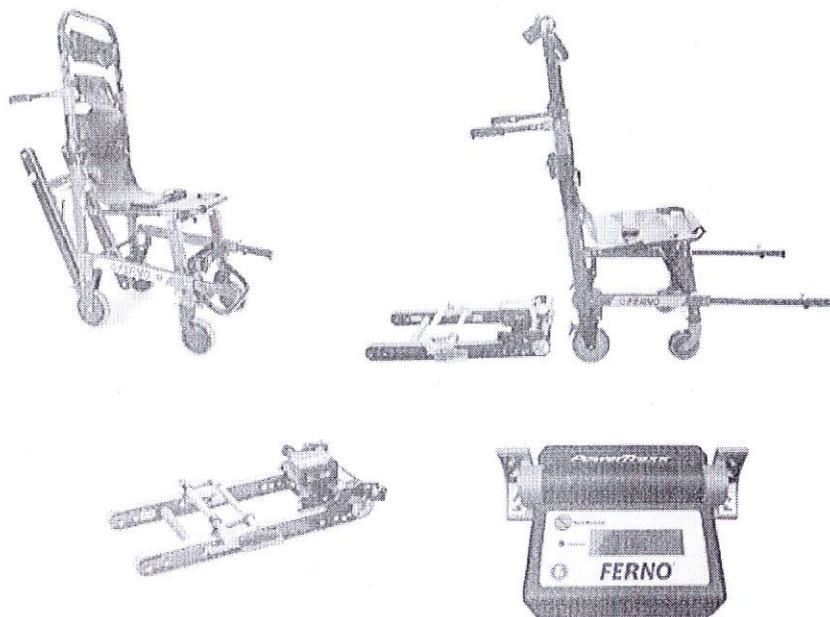

Charakterystyka

- Krzesło FAST (nr katalogowy: 60-4130-001) może być używane jako schodołaz, krzesło ewakuacyjne lub krzesło transportowe.
- Idealne i opłacalne rozwiązanie z systemem gasienic Ferno o napędzie elektrycznym.
- Całkowicie aluminiowa konstrukcja ramy może przenosić pacjentów o wadze do 250 kg.
- Dwa przednie koła skrętne (125 mm) i dwa tylne koła stałe (150 mm) z blokadą.
- Koła zbierają minimum zanieczyszczeń z podłoża - przy zachowaniu dobrej przyczepności i komfortu oraz bardzo dobrej manewrowości w ciasnych przestrzeniach (takich jak podesty schodów czy wąskie korytarze).
- Posiada podparcie głowy i trzy pasy unieruchamiające do zabezpieczenia pacjenta.
- Tylne uchwyty górny jest wysuwany i regulowany w czterech położeniach (od 1000 do 1580 mm).
- Przednie uchwyty teleskopowe są regulowane w pięciu położeniach (maksymalne wyciągnięcie: 340 mm).
- Powłoka winylowa jest łatwa do czyszczenia i wymiany.
- Opcjonalnie dostępne są: komfortowy podnóżek, 4-punktowy pas unieruchamiający, kosz siatkowy, tylne uchwyty podtrzymujące i zamek blokujący.

Dane techniczne

Wysokość min.	Szerokość całkowita	Długość całkowita	Szerokość siedziska	ś. x szer. x wys. (złożone)	Waga bez gasienic	Waga z gasienicami	Limit obciążenia
1000 mm	516 mm	695 mm	415 mm	1000 x 516 x 215 mm	11.2 kg	25 kg	250 kg

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie powyższego rozwiązania dla Transportera schodowego opisanego w Załącznik nr 4 - zestawienie minimalnych parametrów.

Powyższe zmiany są integralną częścią specyfikacji warunków zamówienia i dotyczą wszystkich Wykonawców, biorących udział w w/w postępowaniu Wykonawca zobowiązany jest złożyć ofertę z uwzględnieniem powyższego.

Z-ca Kierownika Działu
Zaopatrzenia i Zamówień Publicznych

mgr inż. Jacek Banaszk

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny we Wrocławiu

ul. H. M. Kamieńskiego 73a, 51-124 Wrocław

Infolinia 45 95 95 454

Sekretariat tel. +48 71 32 70 101; e-mail: sekretariat@wssk.wroc.pl

NIP 8951645574, REGON 000977893

www.wssk.wroc.pl