



„Kutnowski Szpital Samorządowy” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
99-300 Kutno ul. Kościuszki 52
tel. centr.24 38 80 200 tel./fax 24 38 80 201
e-mail: nzoz.kss@szpital.kutno.pl www.szpital.kutno.pl
REGON 100974785; NIP 7752631681

Kutno, dnia 15.03.2024 r.

WYJAŚNIENIA Nr 1 DO SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji pn.: **JEDNORAZOWE ARTYKUŁY MEDYCZNE (sterylne).**

Nr postępowania: **ZP/6/24**

„Kutnowski Szpital Samorządowy” Spółka z o.o., ul. Kościuszki 52, 99-300 Kutno, na podstawie art. 284 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2023.1605 tj. z dnia 2023.08.14 ze zm.), udziela odpowiedzi na następujące pytania:

1. Dotyczy Pakietu Nr 16, poz. 1 - Czy zamawiający ma na myśli sztanca biopsyjna rozmiar 3mm?



Zgodnie z zapisami SWZ.

2. Dotyczy Pakietu Nr 16, poz. 2 - Czy zamawiający ma na myśli igłę do biopsji typu:

- a - aparat półautomatyczny,
- b - aparat w pełni automatyczny,

Zamawiający ma na myśli aparat w pełni automatyczny, reszta zapisów zgodna z zapisami SWZ.

3. Dotyczy Pakietu Nr 4, poz. 1 - Czy Zamawiający dopuści w przedmiocie zamówienia (pakiet nr 4, pozycja 1) Wodę sterylną do inhalacji o właściwościach: zapobiega uszkodzeniom błon śluzowych, poprawia komfort i zapewnia ulgę podczas oddychania. Woda Across została stworzona do systemów nawilżania zamkniętego, która ma za zadanie ograniczenie ryzyka wzrostu bakteryjnego; wolna od pirogenów, zapobiegająca namnażaniu bakterii, doskonale dopasowana do każdej sytuacji, w której istnieje zapotrzebowanie na nawilżanie gazów oddechowych, od doraźnej tlenoterapii przez maskę twarzową i kaniule nosowe poczynając, po zaintubowanych pacjentów wentylowanych mechanicznie o pojemności 500 ml?

Zamawiający dopuszcza.

4. Dotyczy Pakietu Nr 4 - Do każdej butelki dołączona instrukcja obsługi w języku Polskim. W związku z wejściem w życie Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 27 października 2022 r. w sprawie podstawowych warunków prowadzenia apteki i wynikającym z niego obowiązku kontroli przez Zamawiającego warunków w jakich odbywał się transport wyrobów medycznych prosimy o określenie w jaki sposób Zamawiający zamierza kontrolować warunki dostaw? Czy będzie to np. przez załączenie do oferty wykazu odpowiednio przystosowanych środków transportu przeznaczonych do realizacji umowy lub przedstawienia umowy ze specjalistyczną firmą kurierską realizującą dostawy pojazdami typu Izoterma z możliwością rejestracji i wydruku temperatury w przestrzeni ładunkowej ?

Zgodnie z § 2 ust. 5 i 6 projektu umowy:

„5. Wykonawca zobowiązuje się dostarczać towar fabrycznie nowy, wolny od wad fizycznych i prawnych do Apteki Szpitalnej (...).

6. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć zamówiony towar na własny koszt i ryzyko.”

5. Dotyczy Pakietu Nr 3, poz. 1-4, 10, 11 - Czy Zamawiający w Pakiecie nr 3, wykreśli poz. 1-4, 10, 11 - z uwagi, iż producentem ww. pozycji jest wyłącznie jedna firma, a taka budowa pakietu stawia ją w pozycji uprzywilejowanej. Brak jest zamienników i produktów równoważnych. Na pozostałe pakiety Zamawiający może otrzymać korzystniejsze oferty pod względem ceny oraz nie gorsze jakościowo produkty

Zgodnie z zapisami SWZ.

6. Dotyczy Pakietu Nr 10, poz. 1 - Czy Zamawiający w dopuści pak 10 pozycja 1 do postępowania cewnik dializacyjny dwuświatłowy wysokoprzepływowo (High Flow), z poliuretanu, bez otworów bocznych, o średnicy 11 i 13 Fr ramiona proste i zagięte o długościach: 15, 20, 25 do wyboru przez zamawiającego.

Charakterystyka cewnika:

- termoplastyczny poliuretan Tecoflex
- radiocieniujący szaft cewnika
- końcówka bez bocznych otworów zmniejszająca ryzyko powstawania zakrzepu
- przednie otwory zmniejszające ryzyko powstawania zakrzepów
- obrotowy pierścień do szycia pozwalający uniknąć podrażnienia skóry
- zacisk bezpieczeństwa z zabezpieczeniami bocznymi chroniącymi rurkę końcówki przed wyslizgnięciem się
- wskaźniki wypełnienia, rozmiar i długość
- kompatybilny z MRI
- odporna na odkształcenia prowadnica „J” 0,98 mm x 700 mm/0,97 mm x 700 mm z wysoką zawartością tytanu zapewniająca wyjątkowo wysoką elastyczność i odporność na odkształcenia, dodatkowy komfort zapewnia powłoka z PTFE, która gwarantuje gładką powierzchnię i najwyższy poślizg
- igła wprowadzająca 18G
- rozszerzadło 11Fr/ 13 Fr
- nasadki iniekcyjne Luer Lock
- opakowanie zawiera 3 szt.

Zgodnie z zapisami SWZ.

7. Dotyczy Pakietu Nr 17, poz. 4 - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie poz. 4 z pakietu 17 i stworzy osobny pakiet dla tej pozycji?

Zamawiający nie wyraża zgody, zgodnie z zapisami SWZ.

8. Dotyczy Pakietu Nr 20, poz. 1 - Prosimy o dopuszczenie układu z generatorem z linią wdechową i wydechową niezabudowane w jeden przewód, przystosowany do zamocowania zarówno na opasce poprzez kołyskę jak i na czapeczce.

Zamawiający dopuszcza.

9. Dotyczy Pakietu Nr 20, poz. 1 - Czy Zamawiający oczekuje zaoferowania układu z generatorem, komorą nawilżacza, opaską (do stosowania zamiennego z czapeczką) i maską nosową?

Zamawiający dopuszcza.

10. Dotyczy Pakietu Nr 20, poz. 1 - Prosimy o doprecyzowanie czy Zamawiający wymaga zaoferowania opaski do zamiennego stosowania z czapeczką bawełnianą? Opaska jest dostępna w 5 rozmiarach dla obwodu głowy w zakresie
Zamawiający dopuszcza.

11. Dotyczy Pakietu Nr 20, poz. 1 - Cechą układu oddechowego wpływającą na ograniczenie i ochronę przed kolonizacją przez drobnoustroje jest ochrona przeciwdrobnoustrojowa oparta na działaniu jonów srebra. Czy Zamawiający, ze względu na bezpieczeństwo i ochronę pacjentów przedwcześnie urodzonych, których organizmy są w szczególności narażone na działanie drobnoustrojów chorobotwórczych, wymaga aby oferowany układ posiadał ochronę przeciwdrobnoustrojową opartą na działaniu jonów srebra?
Zamawiający dopuszcza.

12. Dotyczy Pakietu Nr 20, poz. 2 - Czy Zamawiający dopuści układ oddechowy z grzałką niezatopioną w ścianki układu?
Zamawiający dopuszcza.

13. Dotyczy Pakietu Nr 20, poz. 2 - Cechą układu oddechowego wpływającą na ograniczenie i ochronę przed kolonizacją przez drobnoustroje jest ochrona przeciwdrobnoustrojowa oparta na działaniu jonów srebra. Czy Zamawiający, ze względu na bezpieczeństwo i ochronę pacjentów przedwcześnie urodzonych, których organizmy są w szczególności narażone na działanie drobnoustrojów chorobotwórczych, wymaga aby oferowany układ posiadał ochronę przeciwdrobnoustrojową opartą na działaniu jonów srebra?
Zamawiający dopuszcza.

14. Dotyczy Pakietu Nr 20, poz. 3 - Cechą układu oddechowego wpływającą na ograniczenie i ochronę przed kolonizacją przez drobnoustroje jest ochrona przeciwdrobnoustrojowa oparta na działaniu jonów srebra. Czy Zamawiający, ze względu na bezpieczeństwo i ochronę pacjentów przedwcześnie urodzonych, których organizmy są w szczególności narażone na działanie drobnoustrojów chorobotwórczych, wymaga aby oferowany układ posiadał ochronę przeciwdrobnoustrojową opartą na działaniu jonów srebra?
Zamawiający dopuszcza.

15. Dotyczy Pakietu Nr 20, poz. 4 - Czy Zamawiający dopuści kaniulę zakończoną adapterem o średnicy 10 mm, umożliwiającą podłączenie do drenu tlenowego bez użycia dodatkowego łącznika.
Zamawiający dopuszcza.

16. Dotyczy Pakietu Nr 20, poz. 5 - Prosimy o dopuszczenie innego kształtu plastra niż owalny
Zgodnie z zapisami SWZ, kształt plastra owalny.

17. Dotyczy Pakietu Nr 1, poz. 1-2 - Czy Zamawiający dopuści kaniule do wlewów dożylnych wykonane z FEP?
Zgodnie z zapisami SWZ.

18. Dotyczy Pakietu Nr 2, poz. 4 - Czy Zamawiający dopuści zamknięty system do pomiaru diurezy i zbiórki moczu z workiem do zbiórki moczu o pojemności 2000 ml, komorą zbiorczą 500 ml umożliwiającą bardzo dokładne pomiary diurezy (liniowo co 1ml od 3ml do 40ml, co 5 ml od 40 do 100 ml, co 10 ml od 100 do 500 ml). Wyposażony w 2 filtry hydrofobowe oraz 2 bezzwrotne zastawki – w worku oraz w łączniku do cewnika Foley'a. Dwuświatłowy dren o

długości 120 cm z klamrą zaciskową, zakończony bezigłowym portem do pobierania próbek i bezpiecznym łącznikiem do cewnika. Umocowanie na łóżku pacjenta za pomocą składanych wieszaków lub pasków mocujących?

Zamawiający dopuszcza.

19. Dotyczy Pakietu Nr 2, poz. 7 - Czy Zamawiający dopuści cewnik Tiemann o przezroczystej powierzchni?

Zamawiający dopuszcza.

20. Dotyczy Pakietu Nr 6, poz. 1 - Czy Zamawiający dopuści zestaw o składzie:

1 x serweta 180/280 cm x 220 cm zintegrowana z osłonami na kończyny, z otworem samoprzylepnym w kształcie trapezu o wymiarach 30 cm x 20 cm x 20 cm oraz otworem w okolicy krocza o wymiarach 10 cm x 15 cm zabezpieczonym klapką, wykonana z chłonnego i nieprzemakalnego laminatu dwuwarstwowego o gramaturze 56 g/m²

1 x wzmocniona osłona (serweta) na stolik Mayo o wymiarach 80 cm x 145 cm

1 x taśma samoprzylepna typu rzep 2 cm x 22 cm

4 x ręcznik chłonny o wymiarach 30 cm x 30 cm

1 x taśma samoprzylepna o wymiarach 10 cm x 50 cm

1 x osłona na przewody o wymiarach 14 cm x 250 cm

1 x serweta wzmocniona na stół instrumentalny (owinięcie zestawu) o wymiarach 150 cm x 190 cm

Do zestawu dołączona sterylna kieszeń dwukomorowa o wymiarach 30 x 40 cm (15 x 30 cm kieszeń lewa, 25 x 30 cm kieszeń prawa)?

Zamawiający dopuszcza.

21. Dotyczy Pakietu Nr 9, poz. 1 - Czy Zamawiający dopuści wycenę szczotek pakowanych w dyspenser a`40 z odpowiednim przeliczeniem ilości?

Zamawiający dopuszcza.

22. Dotyczy Pakietu Nr 11, poz. 1 - Czy Zamawiający dopuści licznik ostrzy z 8% stawką Vat będący wyrobem medycznym, pozostałe parametry zgodne z SWZ?

Zamawiający dopuszcza.

23. Dotyczy Pakietu Nr 14, poz. 1 - Czy Zamawiający dopuści przedstawienie próbki w wersji niesterylnej?

Zamawiający dopuszcza.

24. Dotyczy Pakietu Nr 14, poz. 1 - Czy Zamawiający dopuści poniższy zestaw, dostarczany do szpitala:

1 x Serweta chirurgiczna 45cm x 60cm 2-warstwowa, z centralnym otworem o śr. 6cm

1 x Serweta chirurgiczna 50cm x 50cm 2-warstwowa

1 x Pęseta plastikowa niebieska 13cm

8 x Kompres z gazy 17N 8W 7,5cm x 7,5cm

1 x Miska nerkowata PVC, rozmiar 12cm x 18cm

1 x Chwytnik Plastikowy 14 cm (Kocher, Pean)

Osobno Pakowane:

1 x Żel do znieczulenia błon śluzowych 6 ml (ampułkostrzykawka)


1 x Strzykawka z wodą destylowaną i gliceryną 10 ml?

Zamawiający dopuszcza.

25. Dotyczy Pakietu Nr 4 - Czy Zamawiający w pakiecie 4 dopuści zamknięty system do inhalacji, nebulizacji, do nawilżania o pojemności 350ml zawierający sterylną wodę . Producent w instrukcji użytkowania nie określa czasu jego używania , produkt jest przeznaczony do nawilżania przepływającego tlenu podczas podawania tlenu pacjentowi i jest przeznaczony do stosowania u jednego pacjenta w terapii oddechowej , zaleca wylanie niewykorzystanej wody a po zakończeniu leczenia wyrzucić nieużytą część , pojemnika nie można używać ponownie ?

Zamawiający dopuszcza.

26. Dotyczy Pakietu Nr 10 - Czy Zamawiający dopuści cewnik czasowy do hemodializ dwuświatłowy 12F, wykonany z termoaktywnego poliuretanu, w dostępnych długościach 15,20,24cm, końcówki luer oznaczone kolorami, nasadka barierowa ograniczająca przenoszenie drobnoustrojów, poziom objętości wypełnienia oznaczony na zaciskach. O przepływach jak poniżej.

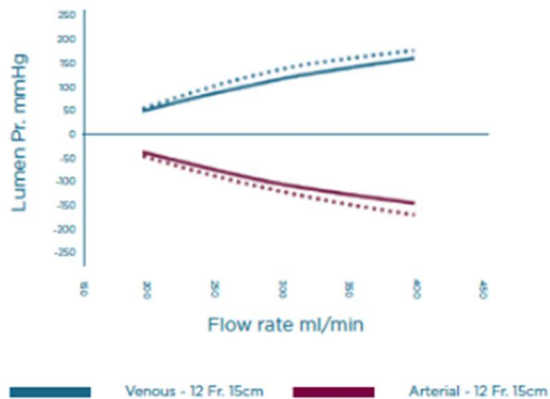

Zgodnie z zapisami SWZ.

Podpisał:
„Kutnowski Szpital Samorządowy” Sp. z o.o.
Prezes Zarządu
Artur Gur

Do wiadomości

Wyjaśnienia zostają umieszczone
na stronie internetowej prowadzonego postępowania
<https://platformazakupowa.pl/transakcja/898995>