



Dział Zamówień Publicznych
tel. 0-12 614 25 51
fax. 0-12 614 25 51
e-mail: przetargi@szpitaljp2.krakow.pl

DZ.271.54.644.2020

Kraków, dnia 20.08.2020 r.

Krakowski Szpital Specjalistyczny im. Jana Pawła II powiadamia zainteresowane strony, że wpłynęły pytania do postępowania nr DZ.271.54.2020 na dostawę odzieży medycznej jednorazowego użytku.

Pytanie nr 1

Pakiet 4

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie fartuchów o grubości 18 mikronów?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 2

Pakiet 4

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie fartuchów konfekcjonowanych jako tzw. zrywki, z możliwością zawieszenia i pojedynczego odrywania fartucha, opakowanie = 50 szt.?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 3 - dotyczy Pakietu nr 9 rozmiaru L oraz XL:

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie do zaoferowania w ww. pozycjach fartuchów chirurgicznych SMMMS, posiadających dziane poliestrowe mankiety. Szerokość fartucha dla rozmiaru L wynosi 167 cm z tolerancją +/- 2 cm, dla rozmiaru XL szerokość fartucha wynosi 171 cm z tolerancją +/- 2 cm. W opakowaniu 2 chłonne ręczniki 30x40cm. Na opakowaniu wskaźnik sterylizacji oraz 2 samoprzylepne naklejki transferowe zawierające nazwę dostawcy, numer referencyjny, numer serii i datę ważności. Pozostałe wymagania zgodnie z SIWZ.

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapis siwz.

Handwritten signatures in blue ink:
Kis, [unclear], [unclear], [unclear], [unclear], [unclear]



Pytanie nr 4 - dotyczy Pakietu nr 10:

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie do zaoferowania w ww. pozycji alternatywnych wysokiej jakości fartuchów niezawierających wiskozy ani celulozy, wykonanych z pięciowarstwowej włókniny SMMMS o minimalnej gramaturze 35 g/m², wzmacnianych wewnątrz z przodu i na ¾ rękawów laminatem mikroporowatego paroprzepuszczalnego polietylenu i polipropylenu o minimalnej gramaturze 40g/m². Odporność na przenikanie cieczy w obszarze krytycznym – min. 215 cm H₂O.

Wytrzymałość na wypychanie na mokro 140 kPA. Kolor całego fartucha – ciemnoniebieski, rękaw o kroju typu raglan, szwy wykonane techniką ultradźwiękową – czterościeżkowy szew ultradźwiękowy, ściągacze rękawów niezawierające bawełny o długości min. 7cm, oznaczenie rozmiaru w postaci wszywki, troki umiejscowione w kartoniku gwarantującym zachowanie sterylności podczas wiązania. Fartuch zawinięty w hydrofobową serwetę włókninową 60x60cm (w zależności od rozmiaru fartucha inny kolor owinięcia ułatwiający szybszą identyfikację rozmiaru), w opakowaniu 2 chłonne ręczniki 30x40cm. Na opakowaniu wskaźnik sterylizacji oraz 2 samoprzylepne naklejki transferowe zawierające nazwę dostawcy, numer referencyjny, numer serii i datę ważności.

Opakowanie zbiorcze (karton) zabezpieczone dodatkowo wewnątrz workiem z folii PE. Zgodność parametrów oferowanych sterylnych fartuchów z normami MDD 93/42, EN 13795, EN ISO 11135 -1 oraz EN 556 – 1:2001. Fartuchy dostępne w rozmiarach, jak niżej:

| ROZMIAR | DŁUGOŚĆ FARTUCHA | SZEROKOŚĆ FARTUCHA | DŁUGOŚĆ RĘKAWA |
|------------|------------------|--------------------|----------------|
| M | 120cm | 163cm | 65cm |
| L | 130cm | 167cm | 72cm |
| XL | 140cm | 171cm | 80cm |
| XXL | 150cm | 175cm | 86cm |
| XXXL | 160cm | 180cm | 90cm |
| Tolerancja | +/- 2cm | +/- 2cm | +/- 1,5cm |

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapis siwz.

Pytanie nr 5

PAKIET NR 8 Poz. nr 1 – czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania koszuli dla pacjenta w kolorze granatowym oraz wyposażonej w troki przy szyi o długości 32 cm każdy?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 6

ZAPISY SIWZ

PROJEKT UMOWY

1. § 7 wnosimy o zmianę zapisów umowy poprzez wprowadzenie nowego paragrafu regulującego skutki wystąpienia siły wyższej mającej wpływ na realizację obowiązków wynikających z łączącej strony umowy. Proponowane brzmienie:


Siła Wyższa

- a) Strony umowy zgodnie z postanawiają, że nie są odpowiedzialne za skutki wynikające z działania siły wyższej, w szczególności pożaru, powodzi, ataku terrorystycznego, klęsk żywiołowych, zagrożeń epidemiologicznych, a także innych zdarzeń, na które strony nie mają żadnego wpływu i których nie mogły uniknąć bądź przewidzieć w chwili podpisania umowy (siła wyższa).
- b) Strona umowy, u której wyniknęły utrudnienia w wykonaniu umowy wskutek działania siły wyższej, jest obowiązana do bezzwłocznego poinformowania drugiej strony o wystąpieniu i ustaniu działania siły wyższej. Zawiadomienie to określa rodzaj zdarzenia, jego skutki na wypełnianie zobowiązań wynikających z Umowy, zakres asortymentu, którego dotyczy, i środki przedsięwzięte, aby te konsekwencje złagodzić.
- c) Strona, która dokonała zawiadomienia o zaistnieniu działania siły wyższej, jest zobowiązana do kontynuowania wykonywania swoich zobowiązań wynikających z Umowy, w takim zakresie, w jakim jest to możliwe, jak również jest zobowiązana do podjęcia wszelkich działań zmierzających do wykonania przedmiotu umowy, a których nie wstrzymuje działanie siły wyższej.
- d) Obowiązki, których Strona nie jest w stanie wykonać na skutek działania siły wyższej, na czas działania siły wyższej ulegają zawieszeniu, tzn. w czasie działania siły wyższej ww. obowiązki nie są wykonywane, a terminy ich wykonania ulegają przedłużeniu o okres działania siły wyższej. W czasie istnienia utrudnień w wykonaniu umowy na skutek działania siły wyższej w szczególności nie nalicza się przewidzianych kar umownych ani nie obciąża się drugiej strony umowy kosztami zakupów interwencyjnych.
- e) W przypadku, gdy utrudnienia w wykonaniu umowy na skutek działania siły wyższej utrzymują się dłużej niż trzy miesiące od czasu stwierdzenia wystąpienia siły wyższej, każda ze stron może rozwiązać umowę ze skutkiem natychmiastowym w części objętej działaniem siły wyższej. Rozwiązanie umowy ze skutkiem natychmiastowym następuje w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

Wprowadzenie powyższej regulacji pozwoli na jednoznaczne określenie obowiązków stron w przypadku wystąpienia siły wyższej. Wskazać bowiem należy, iż siła wyższa traktowana jest jako jedna z przesłanek wyłączających odpowiedzialność na zasadzie ryzyka, a więc również umożliwiających wykonawcy uwolnienie się od ponoszenia odpowiedzialności za niewykonanie lub niewłaściwe wykonanie tej umowy, w tym za uchybienia terminowi wykonania zakontraktowanych prac czy dostaw. Jednakże w celu zapewnienia ochrony interesów obu stron umowy w przypadku wystąpienia siły wyższej wprowadzenie powyższych zapisów pozwoli na podjęcie działań mających na celu ograniczenie negatywnych skutków wynikających z tego stanu.

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapis siwz.

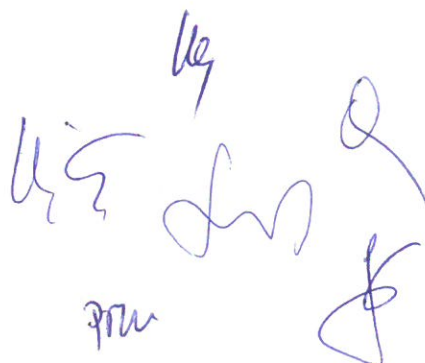

Pytanie nr 7

pakiet 1, poz.1

Czy zamawiający dopuści fartuch o długości ok. 127 cm , szerokości ok.160 cm i długości paska (trok w talii) min. 200 cm?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 8

pakiet 1, poz.1

Czy zamawiający dopuści fartuch z elastyczną gumką na zakończeniu rękawa?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapis siwz.

Pytanie nr 9

pakiet 4, poz.1

Czy zamawiający dopuści fartuch foliowy typu przedniak o wymiarach 68 cm x 108 cm, wykonany z folii polietylenowej o grubości 16 mikronów, długość troków- w pasie ok.55 cm ?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapis siwz.

Pytanie nr 10

Pakiet 2 – Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie fartucha wykonanego z włókniny polipropylenowej foliowanej (przód i rękawy) oraz włókniny polipropylenowej (tył)?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapis siwz.

Pytanie nr 11

Pakiet 2 – Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie fartucha o gramaturze 39g/m² (przód i rękawy) oraz 27g/m² (tył fartucha)?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapis siwz.

Pytanie nr 12

Pakiet 8 – Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie koszuli wykonanej z włókniny SMS?

Odpowiedź:


Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 13

Pakiet 9 - Czy Zamawiający odstąpi od owinięcia fartucha w papier krepowy lub włókninę?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapis siwz.

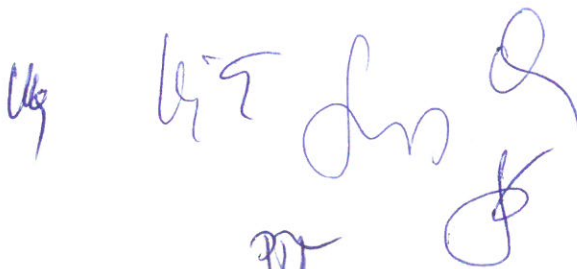

Pytanie nr 14

Pakiet 9 - Czy Zamawiający dopuści fartuch owinięty w papier krepowy lub włókninę z 2 ręcznikami chłonnymi?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 15

Pakiet 9 - Czy Zamawiający dopuści fartuch w rozmiarze L o obwodzie w okolicy klatki piersiowej 150 cm?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 16

Pakiet 10 - Czy Zamawiający dopuści fartuch w opakowaniu zawierającym kolorystyczny wskaźnik sterylizacji (zamiast pakowania próżniowego)?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapis siwz.

Pytanie nr 17

Pakiet 10 - Czy Zamawiający dopuści fartuch dostępny w rozmiarach:

M – długość rękawa 60 cm, obwód w klatce piersiowej 150 cm, długość całego fartucha 124 cm, długość wzmocnienia rękawa 32 cm, długość wzmocnienia przedniej części fartucha 92 cm

L – długość rękawa 61 cm, obwód w klatce piersiowej 150 cm, długość całego fartucha 128 cm, długość wzmocnienia rękawa 34 cm, długość wzmocnienia przedniej części fartucha 102 cm

XL - długość rękawa 62 cm, obwód w klatce piersiowej 160 cm, długość całego fartucha 138 cm, długość wzmocnienia rękawa 34, długość wzmocnienia przedniej części fartucha 113 cm

XXL - długość rękawa 61 cm, obwód w klatce piersiowej 160 cm, długość całego fartucha 157 cm, długość wzmocnienia rękawa 34, długość wzmocnienia przedniej części fartucha 132 cm

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapis siwz.

Pytanie nr 18

Pakiet 10, 11 - Czy Zamawiający dopuści fartuch chirurgiczny spełniający wymagania standardowe normy PN-EN 13795?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapis siwz.

Pytanie nr 19

Pakiet 11 - Czy Zamawiający dopuści fartuch dostępny w rozmiarach:

M – długość rękawa 60 cm, długość całego fartucha 124 cm,


L – długość rękawa 61 cm, długość całego fartucha 128 cm,

XL - długość rękawa 62 cm, długość całego fartucha 138 cm,

XXL - długość rękawa 61 cm, długość całego fartucha 157 cm,

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapis siwz.

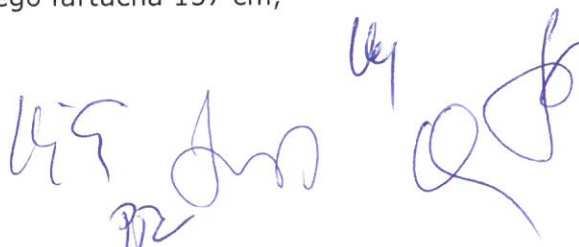

Pytanie nr 20

Pakiet 4, poz. 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dopuszczenie fartucha pielęgniarzkiego z rękawem zakończonym gumką? Pozostałe zgodnie z SIWZ?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapis siwz.

Pytanie nr 21

Pakiet 4, poz. 1

Czy Zamawiający może doprecyzować czy chodzi o wytrzymałość na rozdarcie w części nadgarstka?

Odpowiedź:

Zamawiający wyjaśnia, iż zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia w pakiecie 4 fartuch foliowy nie posiada rękawów.

Pytanie nr 22

Dotyczy Pakietu nr 9

Czy Zamawiający dopuści, jałowy, fartuch chirurgiczny rozm. L i XL, w którym długość rękawa (mierzona od barku w miejscu wszycia) wynosi min. 54 cm?

Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapis siwz.

Pytanie nr 23

Pakiet 1, poz. 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dopuszczenie fartucha pielęgniarzkiego z rękawem zakończonym gumką? Pozostałe zgodnie z SIWZ?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapis siwz.

Pytanie nr 24

Pakiet 1, poz. 1

Czy Zamawiający może doprecyzować czy chodzi o wytrzymałość na rozdarcie w części nadgarstka?

Odpowiedź:


Zamawiający wyjaśnia, iż wytrzymałość na rozdarcie jest parametrem jakościowym dotyczącym całego fartucha.

Pytanie nr 25

Dotyczy Pakietu nr 1, poz. 1 – czy Zamawiający dopuści fartuch zakończony gumką zamiast mankietu?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapis siwz.

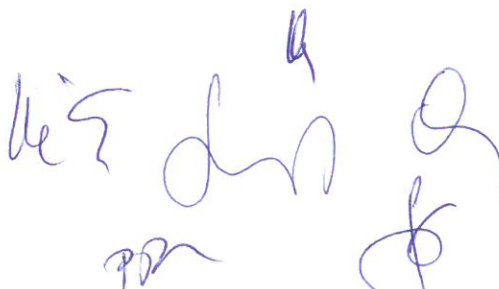

Pytanie nr 26

Wzór umowy - Wnosimy o dodanie do § projektu umowy ust. o treści:
„Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany ceny w przypadku zmiany cen producenta
lub w przypadku zmiany w czasie trwania umowy kursu dolara amerykańskiego oraz euro
w stosunku do złotego o co najmniej 3%. W takim przypadku zmiana umowy nastąpi w
formie aneksu.

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapis siwz.

Z poważaniem

ZASTĘPCA DYREKTORA
us. Finansowych i Administracji


mgr Lucyna Stanuch

