



SZPITAL IM. ŚW. JADWIGI ŚLĄSKIEJ W TRZEBNICY

ul. Prusicka 53-55, 55-100 Trzebnica

Tel. 71 312-09-20 Fax. 71 312-14-98

E-mail: sekretariat@szpital-trzebnica.pl

NIP: 915-15-23-806 REGON: 000308761 KRS: 0000033125

www.szpital-trzebnica.pl

Trzebnica, dnia 13.08.2020 r.

ODPOWIEDZI (3) na zapytania dotyczące treści SIWZ

Szpital im. Św. Jadwigi Śląskiej w Trzebnicy jako Zamawiający w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na sukcesywną dostawę białizny szpitalnej (Nr postępowania ZP/22/2020/PN) zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2019 r. poz. 1843), przekazuje treść zapytań wraz z udzielonymi odpowiedziami.

Pytanie nr 1 – dotyczy pakietu nr 14.

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie jednorazowej medycznej maski ochronnej z gumkami typu KN95 będącej wyrobem medycznym, technicznie zgodnym z wymaganiami Dyrektywy Rady o Wyrobach Medycznych 93/42/EWG. Wyrób klasy I typu IIR zgodnie z EN 14683 - posiada poziom filtracji BFE $\geq 98\%$ (testy wykonane zgodnie z EN149 z niezależnego, akredytowanego laboratorium badawczego potwierdzają zgodność z wymogami dla masek FFP2, a nawet wykazały zbliżone wartości przenikania materiału filtracyjnego z wymaganiami dla masek FFP3).

Odpowiedź: Tak, Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 2 – dotyczy pakietu nr 15.

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie w części nr 11 niżej opisanych kombinezonów?

Kombinezon ochrony chemicznej kategorii III w rozmiarze XL

Jednocześnieowy kombinezon z kapturem, zamkiem błyskawicznym z przodu zakryty listwą z taśmą klejącą, elastycznymi mankietami w nadgarstkach, kostkach, kapturze oraz ściągaczem w talii; szwy zgrzewane, kolor biały. bez ochraniaczy na obuwiu. Zgodny z wymaganiami zasadniczymi Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/425 dot. środków ochrony indywidualnej, w tym normy EN 14126:2003 dotyczącej odzieży, zapewniający ochronę przed czynnikami infekcyjnymi, według co najmniej wyszczególnionych warunków: **Poziomy wydajności**

EN 14605	Typ 4	Działanie ochronne przed rozpyleniem
EN ISO 13982-1	Typ 5	Ochrona przed cząstkami stałymi unoszącymi się w powietrzu
EN 13034	Typ 6	Ograniczona ochrona przed niewielkim rozpryskiem, płynnym aerozolem lub niskim ciśnieniem, rozpryskami o małej objętości

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 3 – dotyczy pakietu nr 1 pozycja 2.

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie rolki podfoliowanej?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający wyraża zgodę.

h.p.

Pytanie nr 4 – dotyczy pakietu nr 1 pozycja 4.

Ze względu na czasowy brak dostępności, prosimy o wydzielenie pozycji do oddzielnego pakietu.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 5 – dotyczy pakietu nr 4 pozycja 2.

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie pieluszek w rozmiarze 2-4 kg?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 6 – dotyczy pakietu nr 7 pozycja 8.

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie w/w pozycji do osobnego pakietu?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 7 – dotyczy pakietu nr 7 pozycja 1-3.

Czy zamawiający wyrazi zgodę na dopuszczenie fartuchów z gramatura 30g, wiązany na troki wokół szyi, 2 kieszenie wiązany w pasie na troki w kolorze niebieskim?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ w zakresie pakietu nr 7 poz. 1-3, Zamawiający wymagał zaoferowania:

Poz. 1. Ochraniacze na obuwiu - foliowe w op.100 szt.

Poz. 2. Czepek jednorazowy - damski.

Poz. 3. Czepek jednorazowy - męski – Furażerka.

Oferent w pytaniu nr 7 zapytał Zamawiającego o zgodę na dopuszczenie „fartuchów z gramatura 30g (...)”.

Pytanie to jest niezgodne z treścią SIWZ.

W związku z powyższym Zamawiający pozostawia je bez odpowiedzi.

Pytanie nr 8 – dotyczy pakietu nr 7 pozycja 1.

Czy zamawiający wyrazi zgodę na dopuszczenie fartuchów w rozmiarze uniwersalnym?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ w zakresie pakietu nr 7 poz. 1, Zamawiający wymagał zaoferowania:

Poz. 1. Ochraniacze na obuwiu - foliowe w op.100 szt.

Oferent w pytaniu nr 8 zapytał Zamawiającego o zgodę na dopuszczenie „fartuchów w rozmiarze uniwersalnym”. Pytanie to jest niezgodne z treścią SIWZ.

W związku z powyższym Zamawiający pozostawia je bez odpowiedzi.

Pytanie nr 9 – dotyczy pakietu nr 7 pozycja 1.

Czy zamawiający wyrazi zgodę na dopuszczenie kombinezonów zgodnych z normami:

EN ISO 13688:2013, EN 14605:2005+A1:2009, EN 13034:2005+A1:2009

EN ISO 13982-1:2004+A1:2010, EN 1073-2:2002, EN 14126:2003+AC:2004, EN 1149-5:2008?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ w zakresie pakietu nr 7 poz. 1, Zamawiający wymagał zaoferowania:

Poz. 1. Ochraniacze na obuwiu - foliowe w op.100 szt.

Oferent w pytaniu nr 9 zapytał Zamawiającego o zgodę na dopuszczenie „kombinezonów zgodnych z normami (...)”. Pytanie to jest niezgodne z treścią SIWZ.

W związku z powyższym Zamawiający pozostawia je bez odpowiedzi.

Pytanie nr 10 – dotyczy pakietu nr 2.

Czy Zamawiający dopuści zestaw składający się z:

- a) SERWETKA WŁÓKNINOWA 40G 80X60CM – 1 szt.
- b) SERWETKA WŁÓKNINOWA 40G 25X20CM - 6 szt.
- c) SERWETA DWUWARSTWOWA PP+PE 56 GR/M2 150X90CM - 1 szt.
- d) SERWETA DWUWARSTWOWA PP+PE 56 GR/M2 130X90CM - 1 szt.

e) PODKŁAD Z PULPĄ CELULOZOWĄ 60X60CM - 1 szt.

f) PODKŁAD Z PULPĄ CELULOZOWĄ 90X60CM - 1 szt.

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 11 – dotyczy pakietu nr 4 pozycja 1.

a) Czy Zamawiający wymaga pieluchomajtek posiadających osłonki boczne wzdłuż wkładu chłonnego skierowane na zewnątrz, co zmniejsza możliwość wycieków?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.

b) Czy Zamawiający wymaga pieluchomajtek posiadających dwa elastyczne ściągacze taliowe – zarówno w części przedniej jak i tylnej pieluchy, które pozwalają na optymalne dopasowanie pieluchomajtek do ciała pacjenta?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.

c) Czy Zamawiający wymaga pieluchomajtek oddychających na całej powierzchni, czyli wykonanych w całości z warstw przepuszczających powietrze?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.

Pytanie nr 12 – dotyczy pakietu nr 5 pozycja 1.

Czy Zamawiający dopuści serwetę o wymiarach: 60 x 50cm z samoprzylepnym otworem owalnym 8 x 6 cm?

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 13 – dotyczy pakietu nr 11.

Czy Zamawiający dopuści pokrowiec złożony harmonijkowo o wymiarach 15x250 i grubości folii 0,03mm?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 14 – dotyczy pakietu nr 12.

Czy Zamawiający dopuści pokrowiec o wymiarach 183x104 i grubości folii 0,03mm, z dwoma trokami i przylepcami na końcu, bez dodatkowej gumki?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 15 – dotyczy pakietu nr 11.

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w w/w pozycji osłony na przewody w rozmiarze 15 cm x 244 cm z pierścieniem ułatwiającym zakładanie i perforowaną końcówką. Dopuszczenie takiego rozwiązania pozwoli na złożenie ofert przez większą ilość wykonawców.

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 16 – dotyczy pakietu nr 12.

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w w/w pozycji sterylnej jednoczęściowej, uniwersalnej osłony na ramię C aparatu RTG wykonana z mocnej, wysokiej jakości folii polietylenowej w rozmiarze 104 cm x 230 cm, z rozcięciem o wymiarach 137 cm ułatwiającym zakładanie osłony i przylepcami do mocowania osłony. Produkt w opakowaniu po 20 sztuk. W celu odpowiedniego zabezpieczenia towaru podczas transportu i przechowywania produkt pakowany w dwa opakowania typu karton (zewnątrzny i wewnętrzny).

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 17 – dotyczy pakietu nr 11 i 12.

Prosimy o doprecyzowanie, czy Zamawiającego oczekuje, aby produkty zaoferowane w pakiecie nr 11 i 12 były wytwarzane zgodnie z ISO 13485 (kontrolowana jakość produkcji wyrobów medycznych)?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.

Pytanie nr 18 – dotyczy pakietu nr 1 pozycja 2.

a) Czy zamawiający dopuści rolki 60 cm x 79,8 mt, perforacja co 38 cm?

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuszcza.

b) Czy zamawiający dopuści rolki 60 cm x 65,36 mt, perforacja co 38 cm?

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuszcza.

c) Czy zamawiający dopuści podkład o wymiarach 50 cm x 45,9 mt, perforacja co 34 cm?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 19 – dotyczy pakietu nr 1 pozycja 1.

Czy zamawiający dopuści podkład o chłonności 550 ml?

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 20 – dotyczy pakietu nr 1 pozycja 2.

Czy zamawiający wydzieli poz.2 do osobnego pakietu, takie rozwiązanie pozwoli innym firmom , specjalizujący się w danym asortymencie, na złożenie konkurencyjnej oferty, a tym samym umożliwi Zamawiającemu na osiągnięcie oszczędności i wymiernych korzyści finansowych?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na wydzielenie ww. pozycji do osobnego pakietu.

Pytanie nr 21 – dotyczy pakietu nr 7 pozycja 4-6,12.

Czy zamawiający wydzieli poz.4-6,12 do osobnego pakietu, takie rozwiązanie pozwoli innym firmom , specjalizujący się w danym asortymencie, na złożenie konkurencyjnej oferty, a tym samym umożliwi Zamawiającemu na osiągnięcie oszczędności i wymiernych korzyści finansowych?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na wydzielenie ww. pozycji do osobnego pakietu.

Pytanie nr 22 – dotyczy pakietu nr 7 pozycja 4.

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie wyceny za najmniejsze opakowanie handlowe 20 szt. z przeliczeniem ilości z zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań.

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza. W tym przypadku należy zaoferować 250 opakowań.

Pytanie nr 23 – dotyczy pakietu nr 7 pozycja 5.

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie wyceny za najmniejsze opakowanie handlowe 100 szt. z przeliczeniem ilości z zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań.

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza. W tym przypadku należy zaoferować 150 opakowań.

Pytanie nr 24 – dotyczy pakietu nr 7 pozycja 6.

Czy zamawiający dopuści koc o wymiarze 160 cm x 210 cm?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 25 – dotyczy pakietu nr 7 pozycja 12.

a) Czy zamawiający dopuści rolki 60 cm x 79,8 mt, perforacja co 38 cm?

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuszcza.

b) Czy zamawiający dopuści rolki 60 cm x 65,36 mt, perforacja co 38 cm?

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuszcza.

c) Czy zamawiający dopuści podkład o wymiarach 50 cm x 45,9 mt, perforacja co 34 cm?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

h p

Pytanie nr 26 – dotyczy pakietu nr 1 pozycja 1.

Czy Zamawiający dopuści podkład o powierzchnia pokryta włókniną polipropylenową o gramaturze 15g/m². Część spodnia z folii o gramaturze 25g/m². Wkład chłonny z superabsorbentem o gramaturze 125g /m²?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 27 – dotyczy pakietu nr 1 pozycja 1.

Czy Zamawiający dopuści wycenę za opakowanie handlowe a'112szt, z przeliczeniem zamawianej ilości i zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza. W tym przypadku należy zaoferować 42 opakowania.

Pytanie nr 28 – dotyczy pakietu nr 1 pozycja 2.

Czy Zamawiający dopuści podkład o wymiarach 50 cm x 50 m?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 29 – dotyczy pakietu nr 1 pozycja 2.

Czy Zamawiający dopuści podkład o wymiarach 50 cm x 80 m?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 30 – dotyczy pakietu nr 1 pozycja 3.

Czy Zamawiający dopuści podkład chłonny w rozmiarze 60 x 180 cm, z wkładem chłonnym 60x90 cm, w całości wykonany z oddychającej włókniny, wyposażony w zakładki umożliwiające zawinięcie podkładu pod materac w celu trwałego umocowania produktu. Chłonność min. 1600 ml. Powierzchnia pokryta włókniną polipropylenową o gramaturze 15g/m². Część spodnia z włókniny polipropylenowej o gramaturze 37g/m². Wkład chłonny o gramaturze 125g /m²?

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 31 – dotyczy pakietu nr 1 pozycja 3.

Czy Zamawiający dopuści wycenę za opakowanie handlowe a'56szt, z przeliczeniem zamawianej ilości i zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza. W tym przypadku należy zaoferować 17 opakowań.

Pytanie nr 32 – dotyczy pakietu nr 1 pozycja 4.

Czy Zamawiający dopuści koc ogrzewający jednorazowego użytku; warstwy zewnętrzne wykonane z włókniny polipropylenowej 25 g/m² w kolorach zielonym i niebieskim, warstwa wewnętrzna z poliestru, z przesykami na całej powierzchni, zapobiegającymi przemieszczaniu się elementów poszczególnych warstw; szwy ultradźwiękowe; niepalny w rozmiarze 110 x 210 cm?

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 33 – dotyczy pakietu nr 1 pozycja 4.

Czy Zamawiający dopuści koc ogrzewający jednorazowego użytku; warstwy zewnętrzne wykonane z włókniny polipropylenowej 25 g/m² w kolorach zielonym i niebieskim, warstwa wewnętrzna z poliestru, z przesykami na całej powierzchni, zapobiegającymi przemieszczaniu się elementów poszczególnych warstw; szwy ultradźwiękowe; niepalny w rozmiarze 150 x 210 cm?

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 34 – dotyczy pakietu nr 1 pozycja 5.

Czy Zamawiający dopuści czepek chirurgiczny w kształcie furażerki z gumką w części tylnej?

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuszcza.

u p

Pytanie nr 35 – dotyczy pakietu nr 1 pozycja 6.

Czy Zamawiający dopuści spodenki do kolonoskopii wykonane z włókniny polipropylenowej?

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 36 – dotyczy pakietu nr 2 pozycja 1.

Czy Zamawiający dopuści zestaw porodowy o składzie:

- 2 x serweta bez przylepca o wymiarach 90 cm x 120 cm, wykonana z chłonnego i nieprzemakalnego laminatu dwuwarstwowego o gramaturze 56 g/m²
- 6 x ręcznik chłonny o wymiarach 30 cm x 30 cm
- 1 x serweta chłonna dla noworodka o wymiarach 75 cm x 80 cm
- 1 x podkład wysokochłonny wypełniony pulpą celulozową o wymiarach 60 cm x 90 cm
- 1 x fartuch foliowy przedni o wymiarach 80 cm x 130 cm
- 2 x zaciskacz do pępowiny

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 37 – dotyczy pakietu nr 3.

Czy Zamawiający dopuści koszulę o gramaturze 33g/m²?

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 38 – dotyczy pakietu nr 3.

Czy Zamawiający dopuści koszulę wykonaną z włókniny polipropylenowej o gramaturze 40 g/m² zakładaną przez głowę z wycięciem Y pod szyją?

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 39 – dotyczy pakietu nr 5 pozycja 1.

Czy Zamawiający dopuści serwetę w rozmiarze 45 x 75 cm z otworem przylepnym 6 x 8 cm?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 40 – dotyczy pakietu nr 6.

Czy Zamawiający dopuści ubranie operacyjne wykonane z włókniny SMS o gramaturze 35g/m², bluza z dekoltem w kształcie V (3 kieszenie), kolor niebieski, spodnie z trokami?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 41 – dotyczy pakietu nr 6.

Czy Zamawiający dopuści ubranie operacyjne wykonane z włókniny SMS o gramaturze 35g/m², bluza z dekoltem w kształcie V z 2 kieszeniami, kolor niebieski?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 42 – dotyczy pakietu nr 7 pozycja 2-5.

Czy Zamawiający dopuści wycenę za opak a'100 szt. z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 43 – dotyczy pakietu nr 7 pozycja 6.

Czy Zamawiający dopuści koc w rozmiarze 160cm x 210cm?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Handwritten mark

Pytanie nr 44 – dotyczy pakietu nr 7 pozycja 8.

Czy Zamawiający dopuści wycenę za op. a'50szt z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza. W tym przypadku należy zaoferować 422 opakowania.

Pytanie nr 45 – dotyczy pakietu nr 7 pozycja 10.

Czy Zamawiający dopuści serwetę w rozmiarze 100x150cm?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 46 – dotyczy pakietu nr 7 pozycja 11.

Czy Zamawiający dopuści podkład w rozmiarze 140x100cm?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 47 – dotyczy pakietu nr 8 pozycja 1-3.

Czy Zamawiający dopuści ubranie operacyjne o gramaturze 35g/m², spodnie z trokami, kolor niebieski?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 48 – dotyczy pakietu nr 8 pozycja 1-3.

Czy Zamawiający dopuści ubranie operacyjne o gramaturze 35g/m² z 2 kieszeniami, spodnie z gumkami, kolor niebieski?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.


Pytanie nr 49 – dotyczy pakietu nr 9 pozycja 1.

Czy Zamawiający dopuści zestaw do artroskopii kolana o składzie:

- 1 x serweta wzmocniona na stół instrumentalny (owinięcie zestawu) o wymiarach 150 cm x 190 cm.
- 2 x ręcznik chłonny o wymiarach 30 cm x 30 cm
- 1 x wzmocniona osłona (serweta) na stół Mayo o wymiarach 80 cm x 140 cm
- 1 x serweta elastyczna osłona na kończybę o wymiarach 30 cm x 60 cm
- 3 x taśma samoprzylepna o wymiarach 10 cm x 50 cm
- 1 x serweta samoprzylepna o wymiarach 200 cm x 320 cm z otworem samouszczelniającym się o wymiarach 6 cm x 8 cm, zintegrowana z organizatorami przewodów i torbą na płyny o wymiarach 60 cm x 100 cm z otworem samouszczelniającym
- 1 x osłona na przewody o wymiarach 14 cm x 250 cm

Obłożenie pacjenta wykonane z hydrofobowej włókniny trójwarstwowej typu SMS o gramaturze 50 g/m², w strefie krytycznej wyposażone we wzmocnienie wysokochłonne o gramaturze 80 g/m², zintegrowane z organizatorami przewodów. Odporność na rozerwania sucho/mokro w obszarze krytycznym 205.6/199.4 kPa. Wytrzymałość na rozciąganie na sucho/mokro w obszarze krytycznym 90/91.6N. Odporność na penetrację płynów w obszarze krytycznym 110 cm H₂O.

Opakowanie TYVEC wyposażone w informację o kierunku otwierania oraz 4 etykiety samoprzylepne typu TAG służące do archiwizacji danych.

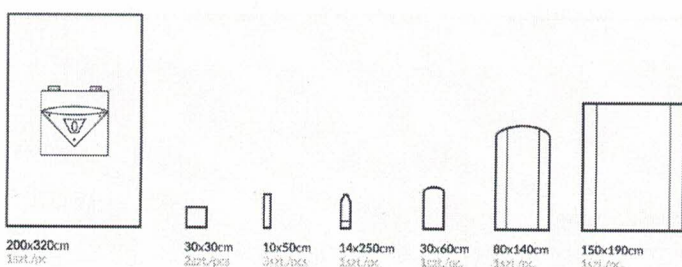

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuszcza.

u p

Pytanie nr 50 – dotyczy pakietu nr 9 pozycja 2.


Czy Zamawiający dopuści zestaw do chirurgii do stawu biodrowego o składzie:

- 1 x serweta wzmocniona na stół instrumentalny (owinięcie zestawu) o wymiarach 150 cm x 190 cm
- 4 x ręcznik chłonny o wymiarach 30,5 cm x 34 cm
- 1 x wzmocniona osłona (serweta) na stół Mayo o wymiarach 80 cm x 145 cm
- 3 x taśma samoprzylepna o wymiarach 10 cm x 50 cm
- 1 x serweta samoprzylepna o wymiarach 180 cm x 180 cm
- 1 x elastyczna osłona na kończyne o wymiarach 30 cm x 120 cm
- 1 x serweta samoprzylepna o wymiarach 150cm x 240cm
- 2 x serweta samoprzylepna o wymiarach 75cm x 90cm
- 1 x bandaż elastyczny o wymiarach 10cm x 450cm
- 1 x serweta samoprzylepna o wymiarach 230cmx260cm, z wycięciem "U" o wymiarach 20cm x 100cm

Obłożenie pacjenta wykonane z chłonnego i nieprzemakalnego laminatu dwuwarstwowego o gramaturze 60 g/m² w strefie krytycznej wyposażone we wzmocnienie wysokochłonne 80 g/m², zintegrowana z dwoma podwójnymi organizatorami przewodów. Łączna gramatura w strefie krytycznej 140 g/m². Odporność na rozerwania sucho/mokro w obszarze krytycznym 180/172 kPa. Wytrzymałość na rozciąganie na sucho/mokro w obszarze krytycznym 118/93 N. Odporność na penetrację płynów w obszarze krytycznym 197 cm H₂O. Współczynnik pylenia 3.4log10. Chłonność wzmocnienia min. 680%.

Spełnia wymagania wg normy EN 13795-1,2,3 na wysokim poziomie.

Opakowanie folia-papier wyposażone w informację o kierunku otwierania oraz 4 etykiety samoprzylepne typu TAG służące do archiwizacji danych.

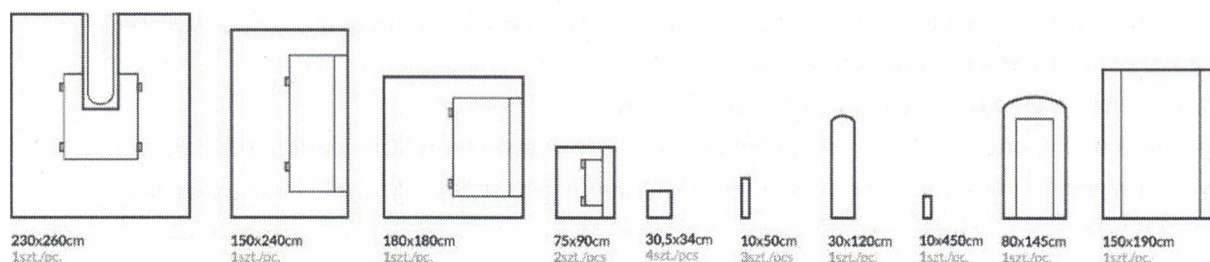

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 51 – dotyczy pakietu nr 9 pozycja 2, 3, 4, 5, 6.

Czy Zamawiający odstąpi od wymogu aby taśma mocująca w serwetach była pokryta klejem repozycjonowalnym?

Odpowiedź: Nie, Zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 52 – dotyczy pakietu nr 9 pozycja 3.


Czy Zamawiający dopuści zestaw do cesarskiego cięcia o składzie:

- 1 x serweta wzmocniona na stół instrumentalny (owinięcie zestawu) o wymiarach 150 cm x 190 cm
- 4 x ręcznik chłonny o wymiarach 30 cm x 30 cm

- 1 x wzmocniona osłona (serweta) na stolik Mayo o wymiarach 80 cm x 140 cm
- 1 x serweta chłonna dla noworodka o wymiarach 75 cm x 80 cm
- 1 x taśma samoprzylepna o wymiarach 10 cm x 50 cm
- 1 x serweta samoprzylepna o wymiarach 200 cm x 320 cm z otworem o wymiarach 25 cm x 30 cm wypełnionym folią chirurgiczną, zintegrowana z torbą do zbiórki płynów o wymiarach 75 cm x 85 cm

Obłożenie wykonane z hydrofobowej włókniny trójwarstwowej typu SMS o gramaturze 50 g/m². Odporność na rozerwanie sucho/mokro w obszarze krytycznym 205.6/199.4 kPa. Wytrzymałość na rozciąganie na sucho/mokro w obszarze krytycznym 90/91.6N. Odporność na penetrację płynów w obszarze krytycznym 41.7 cm H₂O. Współczynnik pylenia 1.4log10. Chłonność wzmocnienia min. 680%.

Opakowanie TYVEC wyposażone w informację o kierunku otwierania oraz 4 etykiety samoprzylepne typu TAG służące do archiwizacji danych. Zestaw sterylizowany radiacyjnie.

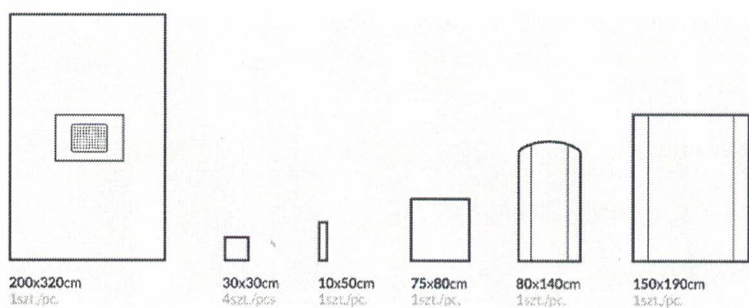

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuszcza.


Pytanie nr 53 – dotyczy pakietu nr 9 pozycja 4.

Czy Zamawiający dopuści zestaw do operacji kręgosłupa o składzie:

- 1 x serweta wzmocniona na stół instrumentalny (owinięcie zestawu) o wymiarach 150 cm x 190 cm
- 4 x ręcznik chłonny o wymiarach 30 cm x 30 cm
- 1 x wzmocniona osłona (serweta) na stolik Mayo o wymiarach 80 cm x 140 cm
- 2 x taśma samoprzylepna o wymiarach 10 cm x 50 cm
- 1 x elastyczna osłona na kończyne o wymiarach 35 cm x 120 cm
- 1 x serweta samoprzylepna 200 cm x 260 cm , z wycięciem "U" o wymiarach 8,5 cm x 85 cm, wzmocnienie o wymiarze 75cm x 100cm
- 1 x serweta samoprzylepna o wymiarach 170cm x 240cm wzmocnienie o wymiarze 30cm x 80cm

Serwety wykonane z hydrofobowej włókniny trójwarstwowej typu SMS o gramaturze 50 g/m², w strefie krytycznej wyposażone we wzmocnienie wysokochłonne o gramaturze 80 g/m², zintegrowane z organizatorami przewodów. Odporność na rozerwania sucho/mokro w obszarze krytycznym 205.6/199.4 kPa. Wytrzymałość na rozciąganie na sucho/mokro w obszarze krytycznym 90/91.6N. Odporność na penetrację płynów w obszarze krytycznym 110 cm H₂O. Współczynnik pylenia 1.4log10. Chłonność wzmocnienia min. 680%.

Opakowanie TYVEC wyposażone w informację o kierunku otwierania oraz 4 etykiety samoprzylepne typu TAG służące do archiwizacji danych. Zestaw sterylizowany radiacyjnie.

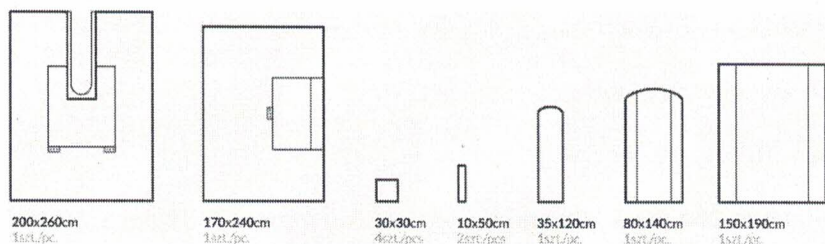

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.


Pytanie nr 54 – dotyczy pakietu nr 9 pozycja 5.

Czy Zamawiający dopuści zestaw do laparoskopii o składzie:

- 1 x serweta wzmocniona na stół instrumentalny (owinięcie zestawu) o wymiarach 150 cm x 190 cm
- 4 x ręcznik chłonny o wymiarach 30 cm x 30 cm
- 1 x wzmocniona osłona (serweta) na stół Mayo o wymiarach 80 cm x 140 cm
- 1 x taśma samoprzylepna o wymiarach 10 cm x 50 cm
- 1 x taśma samoprzylepna typu rzep 2 cm x 22 cm
- 1 x samoprzylepna kieszeń jednokomorowa o wymiarach 30 cm x 40 cm
- 1 x osłona na przewody o wymiarach 14 cm x 250 cm
- 1 x serweta 200/270 cm x 300 cm zintegrowana z osłonami na kończyny, z otworem samoprzylepnym o wymiarach 25 cm x 30 cm.

Obłożenie pacjenta wykonane z hydrofobowej włókniny trójwarstwowej typu SMS o gramaturze 50 g/m² w strefie krytycznej wyposażona we wzmocnienie wysokochłonne o gramaturze 80 g/m², zintegrowana z organizatorami przewodów. Odporność na rozerwania sucho/mokro w obszarze krytycznym 205.6/199.4 kPa. Wytrzymałość na rozciąganie na sucho/mokro w obszarze krytycznym 90/91.6N. Odporność na penetrację płynów w obszarze krytycznym 110 cm H₂O. Współczynnik pylenia 1.4log₁₀. Chłonność wzmocnienia min. 680%.

Opakowanie TYVEC wyposażone w informację o kierunku otwierania oraz 4 etykiety samoprzylepne typu TAG służące do archiwizacji danych. Zestaw sterylizowany radiacyjnie.

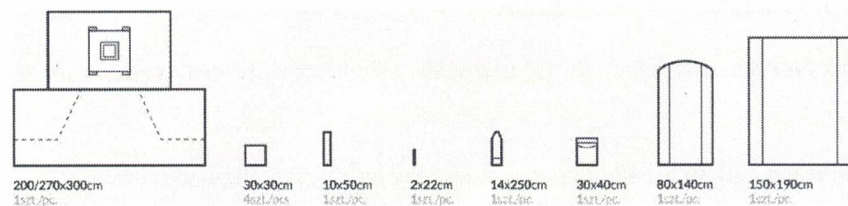

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 55 – dotyczy pakietu nr 9 pozycja 6.

Czy Zamawiający dopuści zestaw uniwersalny o składzie:

- 1 x serweta wzmocniona na stół instrumentalny (owinięcie zestawu) o wymiarach 150 cm x 190 cm
- 4 x ręcznik chłonny o wymiarach 30 cm x 30 cm
- 1 x wzmocniona osłona (serweta) na stół Mayo o wymiarach 80 cm x 140 cm
- 1 x taśma samoprzylepna o wymiarach 10 cm x 50 cm

- 2 x wysokochłonna serweta samoprzylepna o wymiarach 75cm x 90cm i gramaturze 96 g/m²
- 1 x serweta samoprzylepna o wymiarach 170cm x 180cm, wzmocnienie o wymiarach 50 cm x 80 cm
- 1 x serweta samoprzylepna o wymiarach 170cm x 240cm, wzmocnienie o wymiarach 30 cm x 80 cm

serweta posiada pasek samoprzylepny o szer. 5 cm, z fingerliftem szerokości 1 cm

Obłożenie pacjenta wykonane z hydrofobowej włókniny trójwarstwowej typu SMS o gramaturze 50 g/m², w strefie krytycznej wyposażone w wzmocnienie wysokochłonne o gramaturze 80 g/m², zintegrowane z organizatorami przewodów. Odporność na rozerwania sucho/mokro w obszarze krytycznym 205.6/199.4 kPa. Wytrzymałość na rozciąganie na sucho/mokro w obszarze krytycznym 90/91.6N. Odporność na penetrację płynów w obszarze krytycznym 110 cm H₂O. Współczynnik pylenia 1.4log₁₀. Chłonność wzmocnienia min. 680%.

Opakowanie TYVEC wyposażone w informację o kierunku otwierania oraz 4 etykiety samoprzylepne typu TAG służące do archiwizacji danych. Zestaw sterylizowany radiacyjnie.

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 56 – dotyczy pakietu nr 9 pozycja 6.

Czy Zamawiający dopuści zestaw uniwersalny o składzie:

- 1 x serweta wzmocniona na stół instrumentalny (owinięcie zestawu) o wymiarach 150 cm x 190 cm
- 4 x ręcznik chłonny o wymiarach 30 cm x 40 cm
- 1 x wzmocniona osłona (serweta) na stolik Mayo o wymiarach 80 cm x 145 cm
- 1 x taśma samoprzylepna o wymiarach 10 cm x 50 cm
- 2 x serweta samoprzylepna o wymiarach 75cm x 90cm
- 1 x serweta samoprzylepna o wymiarach 180cm x 180cm, z paskiem samoprzylepnym 95 cm
- 1 x serweta samoprzylepna o wymiarach 150cm x 240cm

serweta posiada pasek samoprzylepny o szer. 5 cm, z fingerliftem szerokości 1 cm

Obłożenie pacjenta wykonane z chłonnego i nieprzemakalnego laminatu dwuwarstwowego o gramaturze 56 g/m². Odporność na rozerwania sucho/mokro w obszarze krytycznym 150 kPa. Wytrzymałość na rozciąganie na sucho/mokro w obszarze krytycznym 75/80 N. Odporność na penetrację płynów w obszarze krytycznym >981 cm H₂O. Współczynnik pylenia 1.3log₁₀.

Opakowanie TYVEC wyposażone w informację o kierunku otwierania oraz 4 etykiety samoprzylepne typu TAG służące do archiwizacji danych. Zestaw pakowany do transportu podwójnie w karton wewnętrzny oraz karton zewnętrzny.

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 57 – dotyczy pakietu nr 9 pozycja 7.

Czy Zamawiający dopuści serwetę o gramaturze laminatu 60g/m², wytrzymałość na wypychanie na mokro 100 kPa, na sucho 110 kPa, odporność na przenikanie cieczy 120 cm H₂O, chłonność 600%. Opakowanie posiada 4 etykiety typu TAG do archiwizacji danych. Serwety pakowane do transportu w dwa mniejsze kartony wewnętrzne oraz karton zewnętrzny.

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuszcza

Pytanie nr 58 – dotyczy pakietu nr 9 pozycja 8.

Czy Zamawiający dopuści fartuch z włókniny typu SMS o gramaturze 35g/m². Parametry lepsze od oczekiwanych: wytrzymałość na sucho 200 kPa, na mokro 179,3 kPa, odporność na przenikanie cieczy 50,47 cm H₂O?

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuszcza

Pytanie nr 59 – dotyczy pakietu nr 9 pozycja 8.

Czy Zamawiający dopuści fartuch dostępny w rozmiarach M-XXL z oznaczeniem rozmiaru w postaci nadruku na fartuchu, pozwalający na identyfikację przed rozłożeniem?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 60 – dotyczy pakietu nr 9 pozycja 8.

Czy Zamawiający dopuści fartuch z owinięciem w serwetę włókninową?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 61 – dotyczy pakietu nr 9 pozycja 8.

Czy Zamawiający dopuści fartuch w opakowaniu z 4 etykietami samoprzylepnymi do archiwizacji danych?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 62 – dotyczy pakietu nr 9 pozycja 9.

Czy Zamawiający dopuści osłonę na kończyne o wymiarach 35 x 120 cm z jedną taśmą samoprzylepną 10 x 50 cm w zestawie?

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 63 – dotyczy pakietu nr 9 pozycja 9.

Czy Zamawiający dopuści osłonę na kończyne w opakowaniu z 4 etykietami samoprzylepnymi do archiwizacji danych, opakowanie jednostkowe typu folia – papier, pakowane do transportu w torbę foliową oraz karton zewnętrzny?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 64 – dotyczy pakietu nr 9 pozycja 10.

Czy Zamawiający dopuści serwetę o gramaturze laminatu 60g/m² i wymiarach 90 x 120 cm z otworem samoprzylepnym o średnicy 8 cm, w opakowaniu jednostkowym zawierającym 4 etykiety do archiwizacji danych?

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 65 – dotyczy pakietu nr 9 pozycja 10.

Czy Zamawiający odstąpi od wymogu aby klej był repozycjonowalny?

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 66 – dotyczy pakietu nr 10 pozycja 1.

Czy Zamawiający dopuści serwetę o gramaturze laminatu 60g/m² i wymiarach 90 x 120 cm z otworem samoprzylepnym o średnicy 8 cm, w opakowaniu jednostkowym zawierającym 4 etykiety do archiwizacji danych?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 67 – dotyczy pakietu nr 12 pozycja 1.

Czy Zamawiający dopuści trzyczęściowy zestaw na ramię C zawierający:

- osłonę górną w rozmiarze 100 x 160cm
- osłonę dolną w rozmiarze 80 x 150cm
- 2 szt taśmy samoprzylepnej w rozmiarze 3 x 100cm?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 68 – dotyczy pakietu nr 13.

Czy Zamawiający dopuści jednorazowy komplet chirurgiczny wykonany z włókniny SMS o gramaturze 35g/m²?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 69 – dotyczy pakietu nr 13.

Czy Zamawiający dopuści jednorazowy komplet chirurgiczny tylko w kolorze niebieskim?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 70 – dotyczy pakietu nr 15.

Czy Zamawiający odstąpi od normy EN 13795, która odnosi się do obłożeń operacyjnych, fartuchów chirurgicznych oraz odzieży operacyjnej?

Odpowiedź: Nie.

Pytanie nr 71 – dotyczy pakietu nr 15.

Czy Zamawiający wymaga, aby kombinezon ochronny był zarejestrowany jako środek ochrony indywidualnej kat. III?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający wymaga.

Pytanie nr 72 – dotyczy pakietu nr 1 pozycja 4.

Czy zamawiający dopuści jako produkt równoważny koc ogrzewający niebieski wykonany z włókniny polipropylenowej (gramatura 30 gsm), wewnątrz biały poliester (gramatura 60 gsm), łącznie 300 g o wymiarze 110x220 cm?

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuszcza

Pytanie nr 73 – dotyczy pakietu nr 1 pozycja 4.

Czy zamawiający wydzieli pozycję nr 4 (koce do okrycia pacjenta) do osobnego pakietu, tak aby móc złożyć ofertę tylko na ten produkt?

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuszcza

Pytanie nr 74 – dotyczy pakietu nr 15 pozycja 1.

Czy zamawiający dopuści kombinezon ochronny zgodny z następującymi normami:

Ochrona zgodna z kategorią III odzieży ochronnej:

- Typ 5 - EN ISO 13982-1:2004 +A1:2010

- Typ 6 - EN 13034:2005 +A1 2009 (EN ISO 17491-4:2008) -

Ochrona biologiczna: zgodnie z normą EN 14126

Własności antystatyczne: zgodnie z normą EN 1149-5

Ochrona przeciwko skażeniu radioaktywnemu: zgodnie z normą EN 1073-2, pozostałe parametry zgodne z SIWZ?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 75 – dotyczy pakietu nr 13 pozycja 1.

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie jednorazowego kompletu chirurgicznego z wycięciem w serek bez

obszycia lamówką, rozmiary S-2XL, pozostałość zgodnie z SIWZ.

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 76 – dotyczy pakietu nr 4 pozycja 1.

Czy Zamawiający wymaga w przedmiocie zamówienia (pakiet nr 4, pozycja: 1): przedłożenia kart produktowych / kart technicznych, wystawionych przez producenta, które będą jawne dla Zamawiającego oraz innych ewentualnych wykonawców i staną się potwierdzeniem wymogów zawartych w SIWZ? Należy nadmienić, że karta produktowa / techniczna stwierdza obecność wszystkich elementów składowych produktu, jak również posiada zapis mówiący o poziomie chłonności produktu, zbadany według standardów normy ISO 11948.

Odpowiedź: Zamawiający nie wymaga.

Pytanie nr 77 – dotyczy pakietu nr 4 pozycja 1.

Czy Zamawiający wymaga w przedmiocie zamówienia (pakiet nr 4, pozycja: 1): pieluchomajtek dla dorosłych posiadających co najmniej jeden ściągacz taliowy i ustanowi to jako wymóg minimalny? Zastosowanie w pieluchomajtkę minimum jednego ściągacza taliowego, pozwala na idealne dopasowanie produktu do ciała pacjenta, co wpływa na komfort osoby potrzebującej pomocy. Dopasowanie produktu przekłada się na brak wycieków zawartości pieluchomajtki, co przekłada się na komfort pracy personelu: zmniejszenie czasu pracy przy jednym pacjencie, zmniejszenie ilości zmian produktu na NTM oraz pozwala zaoszczędzić koszty związane z usługami prania pościeli. Mamy informację, że w ostatnim czasie na rynku pojawiły się produkty chłonne, które są rekomendowane dla osób z ciężkim NTM, a w praktyce są to tylko odpowiedniki imitujące produkty o najwyższych standardach (obniżony poziom chłonności, brak ściągacza taliowego, brak wyraźnego wskaźnika chłonności). Posiadamy również informację z Instytucji, które zgodziły się na dostawę tego rodzaju produktów, że produkty te w żaden sposób nie sprawdzają się w warunkach szpitalnych. Brak odpowiedniego poziomu chłonności oraz podstawowych systemów zabezpieczeń uniemożliwia skuteczne zabezpieczenie chorego.

Odpowiedź: Zamawiający wymaga aby pieluchomajtki dla dorosłych posiadały co najmniej jeden ściągacz taliowy.

Pytanie nr 78 – dotyczy pakietu nr 4 pozycja 1.

Czy Zamawiający dopuści w przedmiocie zamówienia (pakiet nr 4, pozycja: 1): pieluchomajtki dla dorosłych posiadające podwójne, elastyczne przylepcorzepy wielokrotnego użytku ale o tej samej szerokości? Produkty, które chcemy zaproponować Państwu wyposażone są w elastyczne przylepcorzepy oraz w elastyczne boki produktu. Połączenie tych dwóch cech umożliwia idealne dopasowanie produktu co przekłada się na komfort pacjenta oraz komfort pracy personelu. Należy również nadmienić, że rozwiązanie, które zawarte jest w SIWZ „Elastyczne przylepcorzepy z dwiema parami różnej szerokości;” stosowane jest tylko i wyłącznie przez jednego producenta pieluchomajtek na rynku polskim. Utrzymanie takiego wymogu przeczy zasadom uczciwej konkurencji, gdyż wskazuje konkretnego, jednego wykonawcę. Dopuszczenie do postępowania tylko i wyłącznie jednego wykonawcy działa na szkodę szpitala – brak konkurencyjnych ofert, negatywnie przekłada się na kondycję finansową Zamawiającego.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.

Pytanie nr 79 – dotyczy pakietu nr 4 pozycja 1.

Czy Zamawiający wymaga w przedmiocie zamówienia (pakiet nr 4, pozycja: 1): pieluchomajtek posiadających system szybkiego wchłaniania, który umożliwi maksymalnie szybkie wchłanianie moczu do środka produktu oraz utrzymuje wilgoć z dala od skóry pacjenta? Należy podkreślić, że powyższe rozwiązanie technologiczne charakteryzują produkty o wysokich standardach jakościowych i zapewniają pacjentom maksymalną ochronę. Dodatkowo korzystnie wpływają na finanse Zamawiającego, gdyż ograniczają zużycie produktów chłonnych jak również ilość prania pościeli.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.

Pytanie nr 80 – dotyczy pakietu nr 4 pozycja 1.

Czy Zamawiający wymaga w przedmiocie zamówienia (pakiet nr 4, pozycja: 1): pieluchomajtek o poziomie chłonności co najmniej 2700g wg normy ISO 11948-1?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.

Pytanie nr 81 – dotyczy pakietu nr 4 pozycja 1.

Czy Zamawiający wymaga w przedmiocie zamówienia (pakiet nr 4, pozycja: 1): pieluchomajtek dla dorosłych posiadających wskaźnik chłonności w postaci minimum jednego żółtego paska, usytuowanego w centralnej części wkładu chłonnego, który pod wpływem napełnienia produktu moczem zmienia kolor?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.

Pytanie nr 82 – dotyczy pakietu nr 4 pozycja 2,3.

Czy Zamawiający wymaga w przedmiocie zamówienia (pakiet nr 4, pozycje: 2,3): przedstawienia dokumentów potwierdzających jakość produktów dla dzieci – wystawionych przez producenta - które są równoznaczne z dokumentami typu: PZH, IMiD?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.


Pytanie nr 83 – dotyczy pakietu nr 4 pozycja 2.

Czy Zamawiający wymaga w przedmiocie zamówienia (pakiet nr 4, pozycja: 2): pieluchomajtek dla noworodka w rozmiarze 2-5kg, ze specjalnym miejscem na pępowinę?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.

W przypadku, gdy Wykonawca zaoferuje przedmiot zamówienia dopuszczony przez Zamawiającego niniejszymi odpowiedziami, należy zamieścić odpowiednią adnotację pod formularzem asortymentowo-cenowym danego pakietu. Niniejsze pismo stanowi integralną część SIWZ i dotyczy wszystkich Wykonawców biorących udział w przedmiotowym postępowaniu. Wykonawca zobowiązany jest złożyć ofertę z uwzględnieniem udzielonych przez Zamawiającego odpowiedzi.

Z poważaniem,


SPZOZ Szpital im. Św. Jadwigi Śląskiej
w Trzebnicy
p.o. dyrektor
Mariusz Misiuna