



SPECJALISTYCZNY SZPITAL
im. dra Alfreda Sokołowskiego
w Wałbrzychu



ISO 9001



Wałbrzych, dnia 14.08.2019r.

DZPZ-530-Zp/39/PN-37/19

Wykonawcy – wszyscy

Dotyczy: Dostawy materiałów medycznych dla potrzeb Pracowni Hemodynamiki - Zp/39/PN-37/19.

Specjalistyczny Szpital im. dra Alfreda Sokołowskiego w Wałbrzychu zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2 ustawy Pzp odpowiada na pytania Wykonawcy w przedmiotowym postępowaniu.

Pytanie 1, dot. pakietu nr 3

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania elektrody do defibrylacji, kardiowersji i stymulacji Quik Combo lub Quik Combo Redi Pak o parametrach niegorszych niż wymagane:

- elektroda jednorazowego użytku, dla pacjentów powyżej 25 kg masy ciała
- powierzchnia aktywna 115 cm²
- przewód odprowadzeniowy o długości 60 cm schowany w opakowaniu (Quik Combo) lub wystający z opakowania dł. 105,2 cm (Redi Pak) (elektrody używane z defibrylatorami LIFEPACK są podłączane do przewodu terapeutycznego o długości ok. 2,5 m., więc różnica w wymaganej długości przewodu nie ma istotnego znaczenia użytkowego)
- system EDGE umożliwiający równomierną dystrybucję ciepła, co zmniejsza ryzyko oparzeń u pacjentów
- elektrody przetestowane do użycia z defibrylatorami LIFEPACK, zgodnie z instrukcją obsługi oraz zaleceniami producenta. Producent defibrylatorów LIFEPACK nie ponosi odpowiedzialności za incydenty medyczne lub nieskuteczność terapii wynikające z użycia elektrod niewymienionych w CE defibrylatora lub instrukcji obsługi defibrylatora.

Odp. Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 2, dot. pakietu nr 2

Czy Zamawiający wymaga aby koszula jednorazowa i majtki były zapakowane razem jako komplet? Pozostałe wymagania zgodne z SIWZ.

Odp. Zamawiający nie wymaga aby koszula jednorazowa i majtki były zapakowane razem jako komplet.

Pytanie 3, dot. treści SIWZ

Czy Zamawiający uzna za spełniony wymóg art. 24 ust. 1 pkt. 23 ustawy PZP, jeżeli Wykonawca, który nie należy do żadnej grupy kapitałowej, przedstawi stosowne oświadczenie wraz z ofertą?

Odp. Tak.

Pytanie 4, dot. pakietu nr 3 poz. 1

Czy zamawiający dopuści elektrody do defibrylacji, zsynchronizowanej kardiowersji i stymulacji zewnętrznej jednorazowego użytku kompatybilne z defibrylatorem LIFEPACK, CARDIOAID. Elektrody standardowego użytkownika u pacjentów powyżej 25 kg masy ciała, o powierzchni całkowitej około 162,75cm² (wymiary: 105mm x 155mm), oraz powierzchni



Specjalistyczny Szpital im. dra Alfreda Sokołowskiego
ul. Alfreda Sokołowskiego 4
58-309 Wałbrzych
www.zdrowe.walbrzych.pl
szpitalsokolowski@zdrowie.walbrzych.pl

sekretariat 74 64 89 600
faks 74 64 89 746
centrala 74 64 89 742



SPECJALISTYCZNY SZPITAL
im. dra Alfreda Sokołowskiego
w Wałbrzychu



ISO 9001

aktywnej 83cm². Elektrody pakowane parami z kablem jednorazowego użytku o długości 120-130 cm, dostępne również wersje z kablami na zewnątrz opakowania umożliwiające wcześniejsze podłączenie do defibrylatora. Szerokość pierścienia około 1,5 cm?

Odp. Tak, Zamawiający dopuszcza.


Pytanie 5, dot. pakietu nr 1

Czy Zamawiający dopuści szczotkę do czyszczenia rąk z polietylenowym włosiem i poliuretanową gąbką?

Odp. Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 6, dot. pakietu nr 2

Czy Zamawiający dopuści koszulę wiążaną na białe troki w talii oraz przy szyi z tyłu?

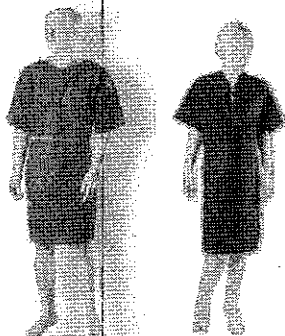

Odp. Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 7, dot. pakietu nr 2

Czy Zamawiający dopuści koszulę wiążaną na troki w talii oraz przy szyi z przodu?

Odp. Tak, Zamawiający dopuszcza

Pytanie 8, dot. pakietu nr 8 poz. 1 i 5

Prosimy Zamawiającego o wydzielenie pozycji do osobnego pakietu. Państwa zgoda zwiększy konkurencyjność postępowania i umożliwi Państwu lepszy wybór spośród większej liczby złożonych ofert.

Odp. Zamawiający nie wydzieli pozycji do osobnego pakietu.

Pytanie 9, dot. pakietu nr 8 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści podkład z możliwością przenoszenia pacjenta do 150 kg, z wkładem chłonnym zawierającym superabsorbent, umożliwiający trwałe zatrzymanie płynu w rdzeniu, w rozmiarze 210x80 cm (wkład chłonny 200x60), w kolorze białym; przyjazny dla skóry, z gładkim wkładem chłonnym, pokryty włókniną PP, wzmocniony co umożliwia przenoszenie pacjenta do 150 kg. Chłonność 1,5l/m². Zapewnia trwałe zatrzymanie bakterii, w tym MRSA, E.Coli, redukuje zapach. Op.20 szt., Pokryty hydrofilną włókniną o gramaturze 15g/m² na całej powierzchni. Wkład chłonny o gramaturze 126g/m² z superabsorbentem. Warstwa spodnia o gramaturze 70g/m² wykonana z



Specjalistyczny Szpital im. dra Alfreda Sokołowskiego
ul. Alfreda Sokołowskiego 4
58-309 Wałbrzych
www.zdrowe.walbrzych.pl
szpitalsokolowski@zdrowie.walbrzych.pl

sekretariat 74 64 89 600
faks 74 64 89 746
centrala 74 64 89 742



SPECJALISTYCZNY SZPITAL
im. dra Alfreda Sokółowskiego
w Wałbrzychu



ISO 9001

włókniny polipropylenowej wzmocnionej foli. Waga podkładu 295 g., chłonność 1,5 l/m² WVTR 3500 g/m²/24 godz ?

Odp. Zamawiający nie dopuszcza, Zamawiający wymaga podkład w rozmiarze 100 (+/-1cm) x225 cm (+/-4cm).

Pytanie 10, dot. pakietu nr 8 poz. 2

Czy Zamawiający dopuści osłonę na podłokietnik w rozmiarze 35 x 75cm, bez opaski, zintegrowana z taśmą przylepną, pakowaną a'2szt z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości?

Odp. Zamawiający nie dopuszcza, Zamawiający wymaga osłony na podłokietnik o długości 75-76cm, szerokości 33cm.

Pytanie 11, dot. pakietu nr 8 poz. 3

Czy Zamawiający dopuści wycenę za opakowanie handlowe a'10szt z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości?

Odp. Zamawiający nie dopuszcza, Zamawiający wymaga 3000szt.

Pytanie 12, dot. pakietu nr 8 poz. 4

Czy Zamawiający dopuści wycenę za serwetę pakowaną a'25szt z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości?

Odp. Zamawiający nie dopuszcza, Zamawiający wymaga 3000szt

Pytanie 13, dot. pakietu nr 8 poz. 6

Czy Zamawiający dopuści fartuchy wykonane z włókniny wielowarstwowej typu SMS?

Odp. Zamawiający nie dopuszcza, Zamawiający wymaga fartuchy wykonane z włókniny SMMS.

Pytanie 14, dot. pakietu nr 8 poz. 3 i 6

Czy zamawiający wydzieli poz.3, poz. 6 do osobnego pakietu, takie rozwiązanie pozwoli innym firmom , specjalizujący się w danym asortymencie, na złożenie konkurencyjnej oferty, a tym samym umożliwi Zamawiającemu na osiągnięcie oszczędności i wymiernych korzyści finansowych?

Odp. Zamawiający nie wydzieli poz.3, poz. 6 do osobnego pakietu.

Pytanie 15, dot. pakietu nr 8 poz. 3

Prosimy Zamawiającego dopuszczenie wyceny za najmniejsze opakowanie handlowe 10 szt. z przeliczeniem ilości z zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań.

Odp. Zamawiający nie dopuszcza, Zamawiający wymaga 3000szt.

Pytanie 16, dot. pakietu nr 8 poz. 3

Czy zamawiający dopuści prześcieradło o wymiarze 130 cm x 210 cm?

Odp. Zamawiający nie dopuszcza, Zamawiający wymaga prześcieradło o wymiarze 140 cm x 200 cm



Specjalistyczny Szpital im. dra Alfreda Sokółowskiego
ul. Alfreda Sokółowskiego 4
58-309 Wałbrzych
www.zdrowe.walbrzych.pl
szpitalsokolowski@zdrowie.walbrzych.pl

sekretariat 74 64 89 600
faks 74 64 89 746
centrala 74 64 89 742



SPECJALISTYCZNY SZPITAL
im. dra Alfreda Sokołowskiego
w Wałbrzychu



ISO 9001



Pytanie 17, dot. pakietu nr 8 poz. 6

Czy zamawiający dopuści fartuch w rozmiarze uniwersalnym?

Odp. Zamawiający nie dopuszcza, Zamawiający wymaga fartuchy w rozmiarze M-XXL.

Pytanie 18, dot. pakietu nr 8 poz. 6

Czy zamawiający dopuści fartuch w rozmiarze L i XL?

Odp. Zamawiający nie dopuszcza, Zamawiający wymaga fartuchy w rozmiarze M-XXL.

Pytanie 19, dot. pakietu nr 8 poz. 6

Czy zamawiający dopuści fartuch w rozmiarze uniwersalnym o wymiarach 112 cm x 140 cm?

Odp. Zamawiający nie dopuszcza, Zamawiający wymaga fartuchy w rozmiarze M-XXL.

Pytanie 20, dot. pakietu nr 8 poz. 6

Czy zamawiający dopuści fartuch w rozmiarze uniwersalnym o wymiarach 120 cm x 145 cm?

Odp. Zamawiający nie dopuszcza, Zamawiający wymaga fartuchy w rozmiarze M-XXL.

Pytanie 21, dot. pakietu nr 8 poz. 6

Prosimy Zamawiającego opuszczenie wyceny za najmniejsze opakowanie handlowe 10 szt. z przeliczeniem ilości z zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań.

Odp. Zamawiający nie dopuszcza, Zamawiający wymaga 3500szt.

Pytanie 22, dot. pakietu nr 8 poz. 6

Czy zamawiający dopuści fartuch włókninowy, z rozcięciem w tylnej części, poły do zakładania z tyłu na plecach, wiązany w talii, w kolorze zielonym, o gramaturze 20 g/m², długi rękaw, zakończony mankietem z bawełnianym ściągaczem o długości 5,5 cm, wiązany z tyłu w talii, niesterylny?

Odp. Zamawiający nie dopuszcza, Zamawiający wymaga fartuch o gramaturze włókniny 35 g/m².

Pytanie 23, dot. pakietu nr 8 poz. 6

Czy zamawiający wymaga fartuch włókninowy z długim rękawem zakończonym mankietem z bawełnianym ściągaczem?

Odp. Tak.

Pytanie 24, dot. pakietu nr 8 poz. 6

Czy zamawiający dopuści fartuch wysokobarierowy?

Odp. Tak, Zamawiający dopuszcza.

Zastępca Dyrektora
dz. Administracyjno-Exploatacyjnych
mgr inż. Andrzej Sztęca



Specjalistyczny Szpital im. dra Alfreda Sokołowskiego
ul. Alfreda Sokołowskiego 4
58-309 Wałbrzych
www.zdrowe.walbrzych.pl
szpitalsokolowski@zdrowie.walbrzych.pl

sekretariat 74 64 89 600
faks 74 64 89 746
centrala 74 64 89 742